Paciente: **BASTO BASTO, ANA MARIA**

FDN: **09-feb.-1939**


Sexo: **Femenino**


ID: **11862**

CLINICA MEDYTEC
Calle 54 364-L x 33-A y 35 Col Centro
999-9268619


OS Análisis de campo único — Central 24-2 Prueba de umbral


Monitor de fijación:	Mancha ciega	Estímulo:	III, Blanco	Fecha:	06-dic.-2025
Objetivo de fijación:	Central	Fondo:	31,5 asb	Hora:	9:28
Pérdidas de fijación:	3/14 XX	Estrategia:	SITA Fast	Edad:	86
Errores falsos pos.:	12%	Diámetro de pupila:			
Errores falsos neg.:	0%	Agudeza visual:			
Duración:	07:31	Rx:	+3,25 DS		
Foveal:	29 dB ■				

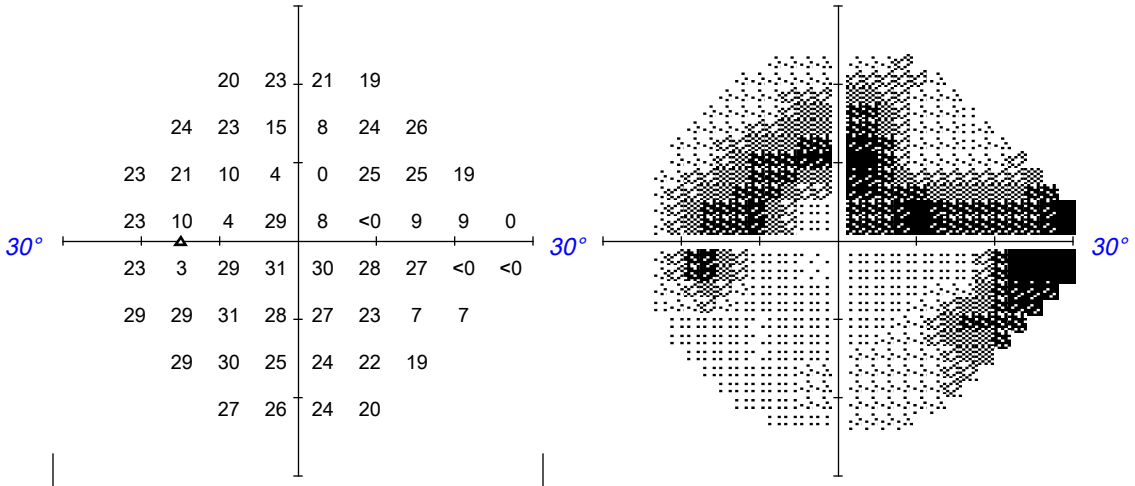

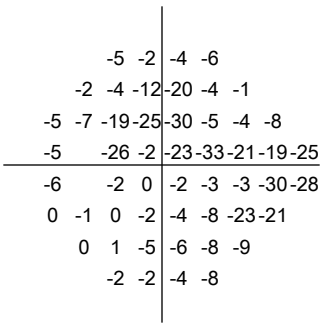


Desviación total

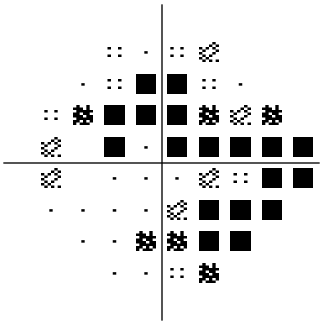

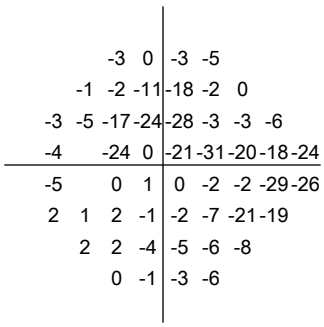

Desviación del modelo

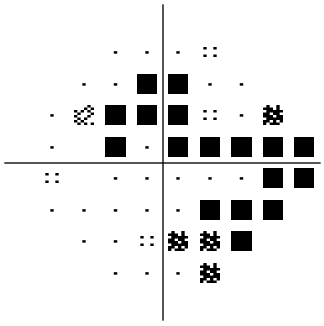

PHG: Fuera de límites normales

VFI: 72%
MD24-2: -10,06 dB P < 0,5%
PSD24-2: 10,44 dB P < 0,5%

*** Fiabilidad de la prueba baja ***

:: P < 5%
P < 2%
P < 1%
■ P < 0.5%

Comentarios

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.