
Paciente: **HERNANDEZ ASCENCIO, CESAR MANUEL**
FDN: **23-ago.-1970**
Sexo: **Masculino**
ID: **19600**

OD Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral


Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

20-ago.-2025 SITA Fast
*** Fiabilidad de la prueba baja ***
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 33 dB :: FL: 3/14 XX
VFI24-2: 57%
FN: 0% FP: 1%
6,0 mm *

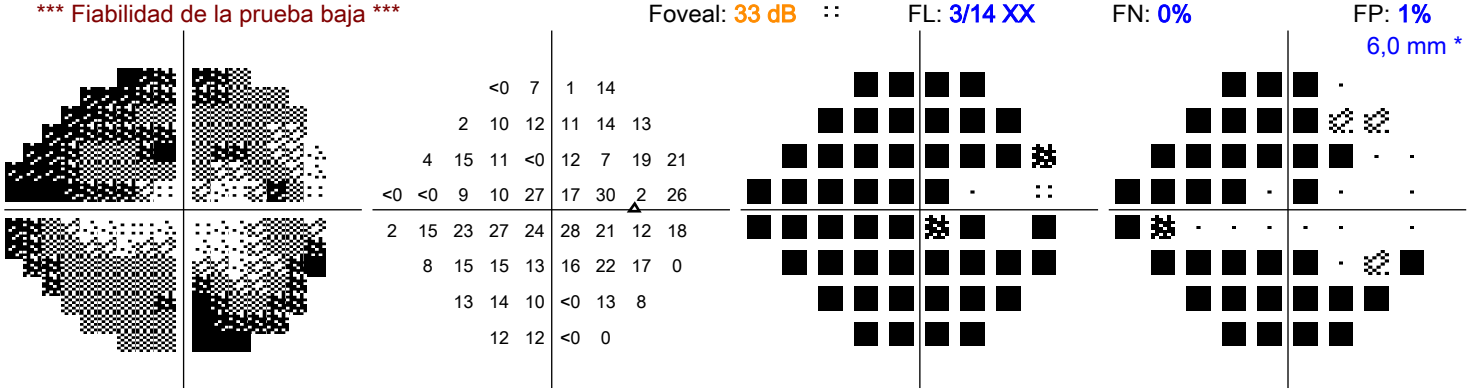

MD24-2: -17,92 dB P < 0,5% PSD24-2: 8,40 dB P < 0,5%


20-ago.-2025 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 34 dB FL: 0/16
VFI24-2: 31%
FN: 9% FP: 0%

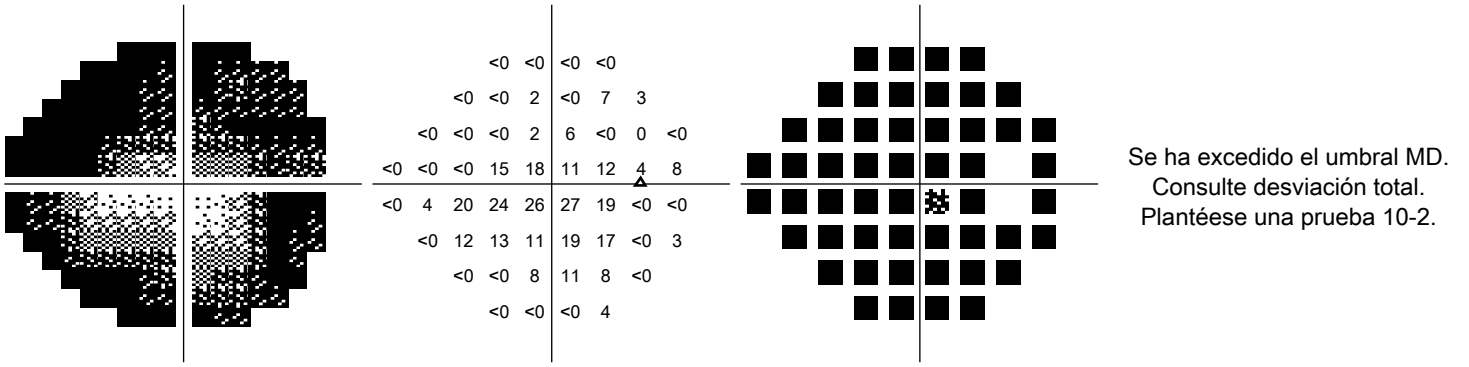

Se ha excedido el umbral MD. Consulte desviación total. Plantéese una prueba 10-2.

MD24-2: -24,41 dB P < 0,5% PSD24-2: 8,52 dB P < 0,5%

03-dic.-2025 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 35 dB FL: 0/14
VFI24-2: 63%
FN: 33% FP: 0%

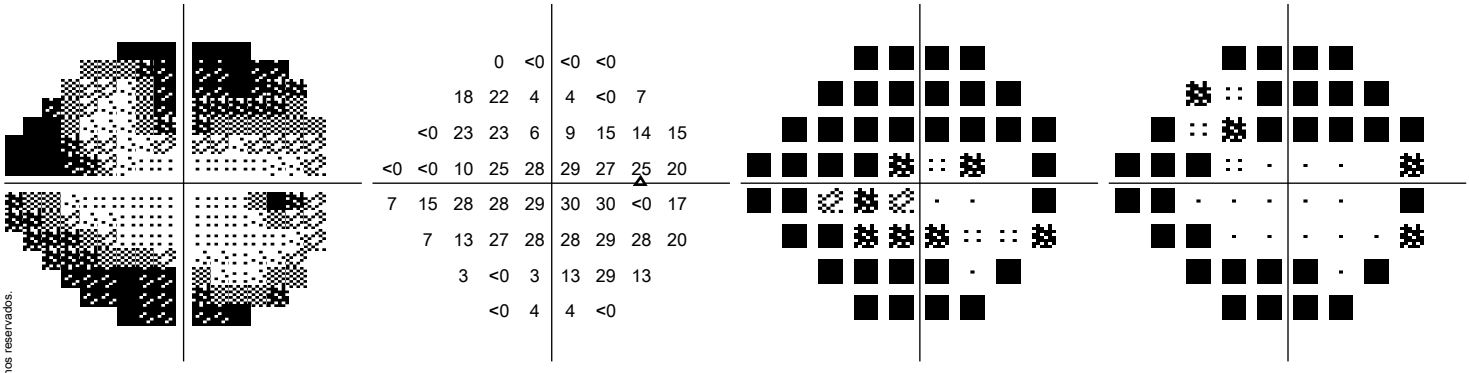

MD24-2: -15,68 dB P < 0,5% PSD24-2: 10,94 dB P < 0,5%

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **HERNANDEZ ASCENCIO, CESAR MANUEL**

FDN: **23-ago.-1970**


Sexo: **Masculino**

ID: **19600**

OD Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos grises

08-abr.-2026 SITA Fast

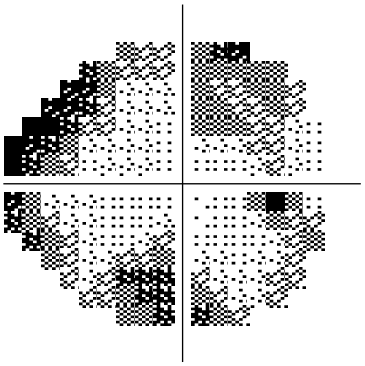

Umbral (dB)


PHG: Fuera de límites normales

Foveal: **34 dB**

			14	18	12	5		
		4	24	22	15	17	13	
	<0	17	23	26	15	14	18	27
<0	14	26	23	26	30	29	18	29
4	21	25	28	30	31	29	<0	27
	12	24	28	18	30	29	24	12
		22	9	8	18	25	19	
			15	7	7	18		

Desviación total

FL: **0/13**

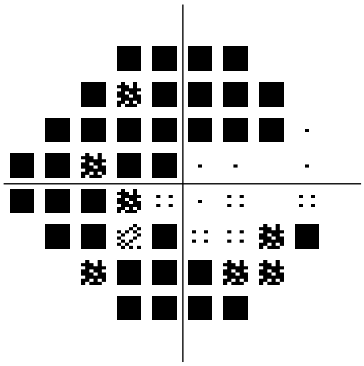


Desviación del modelo

VFI24-2: **74%**

FN: **0%** FP: **2%**

5,5 mm *

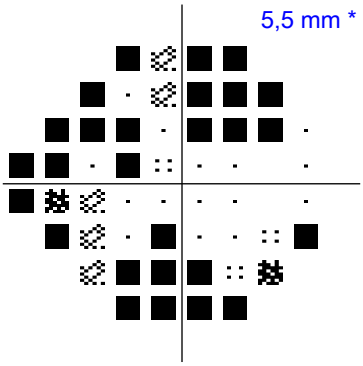

MD24-2: **-10,84 dB P < 0,5%**

PSD24-2: **7,79 dB P < 0,5%**

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.