
Paciente: **HERNANDEZ ASCENCIO, CESAR MANUEL**
FDN: **23-ago.-1970**
Sexo: **Masculino**
ID: **19600**

OD Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral


Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

20-ago.-2025 SITA Fast
*** Fiabilidad de la prueba baja ***
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 33 dB
FL: 3/14 XX
VFI24-2: 57%
FN: 0%
FP: 1%
6,0 mm *

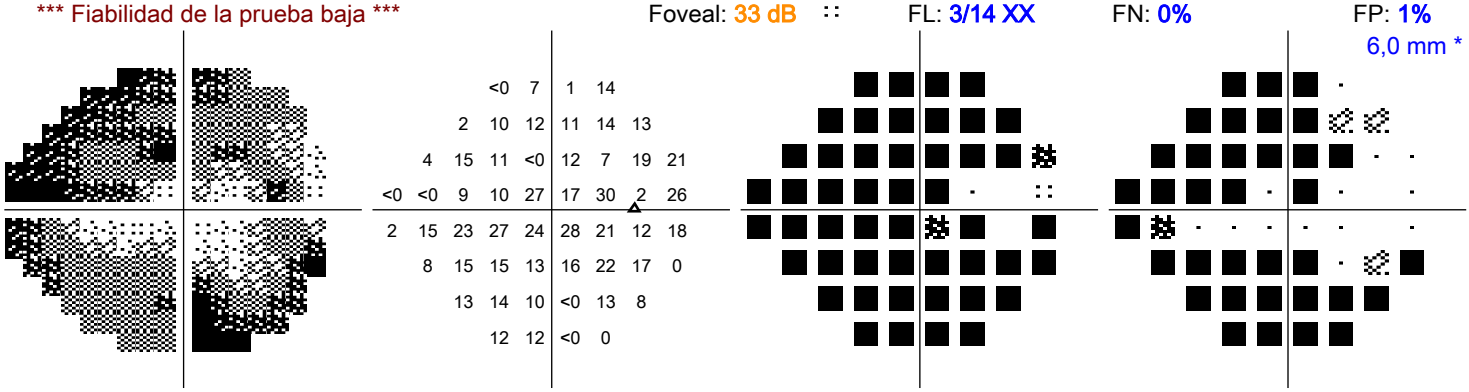

MD24-2: -17,92 dB P < 0,5%
PSD24-2: 8,40 dB P < 0,5%


20-ago.-2025 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 34 dB
FL: 0/16
VFI24-2: 31%
FN: 9%
FP: 0%

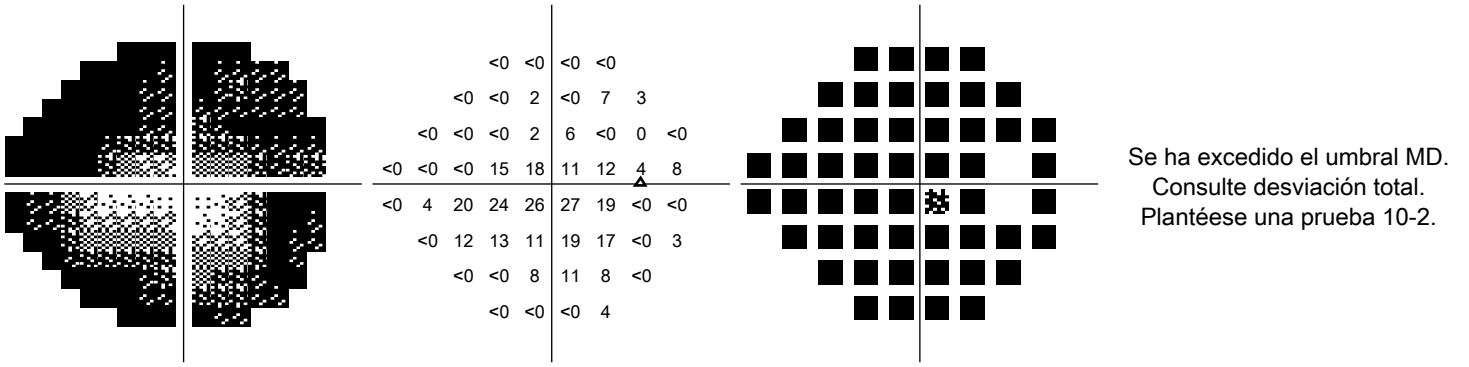

Se ha excedido el umbral MD. Consulte desviación total. Plantéese una prueba 10-2.

MD24-2: -24,41 dB P < 0,5%
PSD24-2: 8,52 dB P < 0,5%

03-dic.-2025 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 35 dB
FL: 0/14
VFI24-2: 63%
FN: 33%
FP: 0%

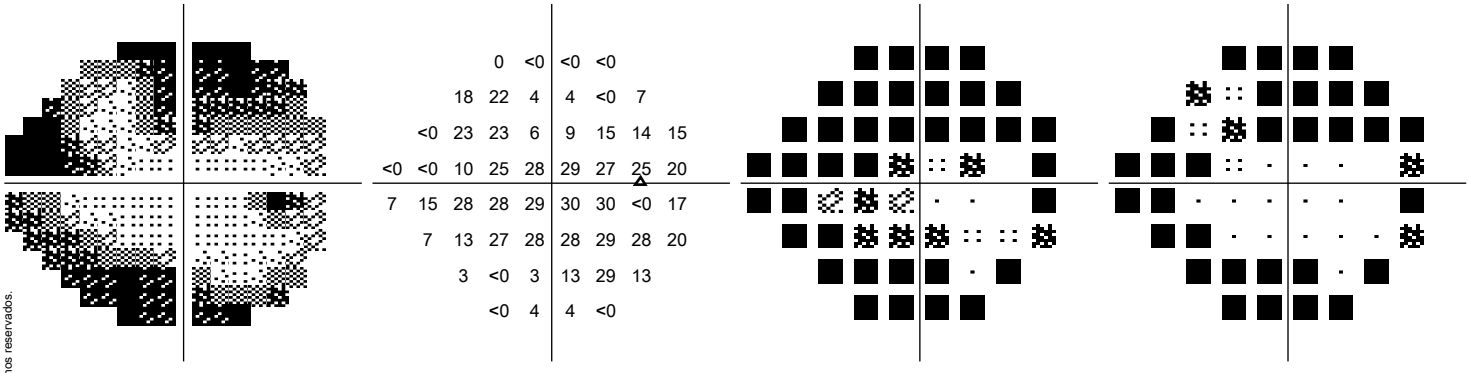

MD24-2: -15,68 dB P < 0,5%
PSD24-2: 10,94 dB P < 0,5%

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.


Paciente: **HERNANDEZ ASCENCIO, CESAR MANUEL**
FDN: **23-ago.-1970**
Sexo: **Masculino**
ID: **19600**

OD Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

08-abr.-2026 SITA Fast


PHG: **Fuera de límites normales**
Foveal: **34 dB** FL: **0/13** FN: **0%** VFI24-2: **74%** FP: **2%**
5,5 mm *

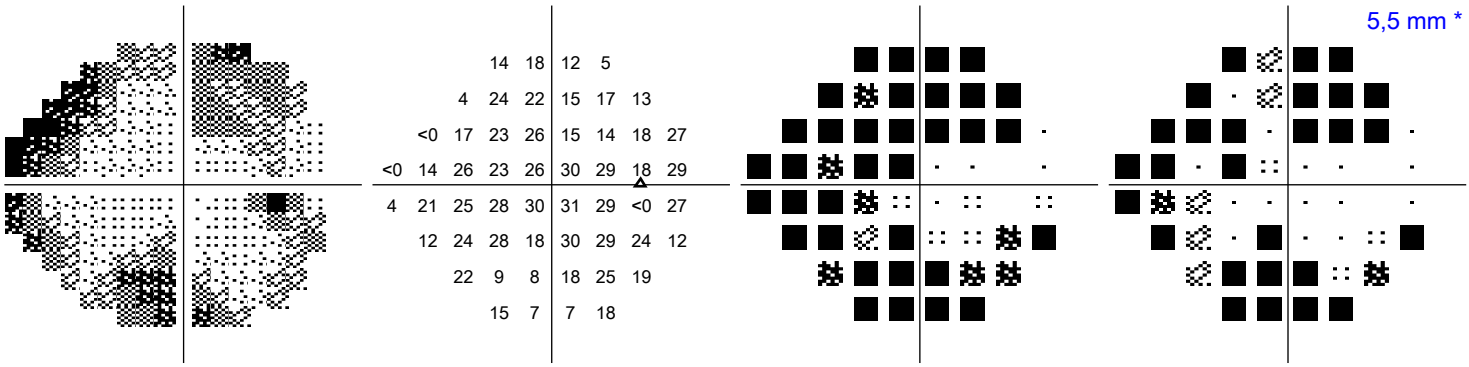

MD24-2: **-10,84 dB P < 0,5%** PSD24-2: **7,79 dB P < 0,5%**

07-oct.-2026 SITA Fast

PHG: **Fuera de límites normales**
Foveal: **36 dB** FL: **0/14** FN: **10%** VFI24-2: **73%** FP: **1%**
5,6 mm *

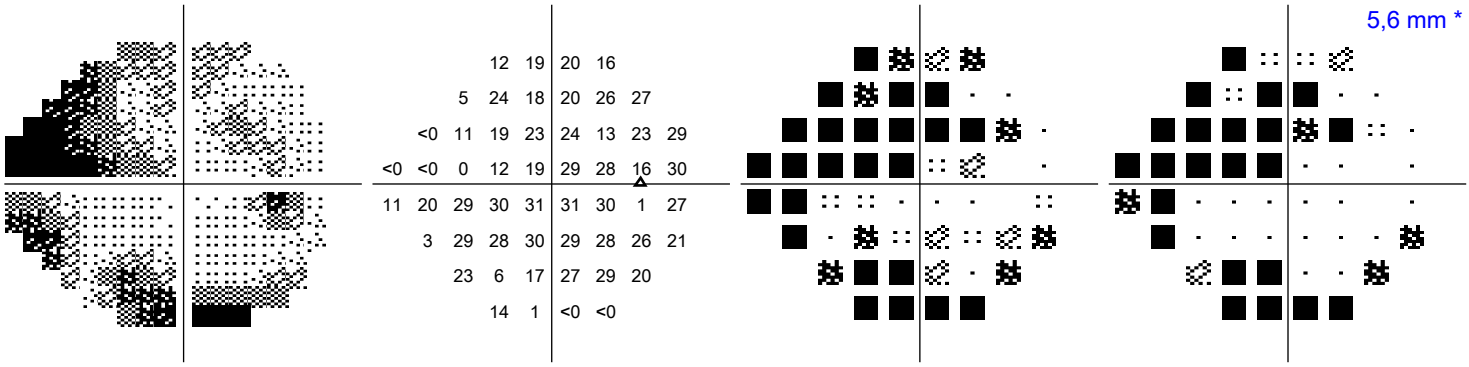

MD24-2: **-11,61 dB P < 0,5%** PSD24-2: **10,54 dB P < 0,5%**

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.