CÁLCULO DE IOL

Paciente	**CAMARA VALLADARES, ENRIQUE**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	11/sep./1950		
Sexo	Masculino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20143		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **08/ene./2026** Fecha verif. calibración: **08/ene./2026**de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho						OS izquierdo					
LS	Fáquica		LVC	No tratado		LS	Fáquica		LVC	No tratado	
VS	Humor vítreo		Modo LVC	-		VS	Humor vítreo		Modo LVC	-	
Refr. dest.	**+0.00 D**		SIA	0.35 D	Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**		SIA	0.35 D	Inc 135°

(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

AL	**23.70 mm**		WTW	11.8 mm		**AL**	**23.86 mm**		WTW	11.8 mm	
ACD	2.72 mm		Pupila	2.5 mm		ACD	2.80 mm		Pupila	3.0 mm	
LT	4.88 mm		Ix / Iy	+0.6 mm	/+0.0 mm	LT	4.89 mm		Ix / Iy	-0.6 mm	/+0.2 mm
CCT	575 µm		Kappa	0.2 mm	@ 186°	CCT	571 µm		Kappa	0.3 mm	@ 298°
Ast. K	**-0.45 D**	**@ 104°**	**Ast. TK**	**-0.89 D**	**@ 96°**	**Ast. K**	**-0.53 D**	**@ 128°**	**Ast. TK**	**-0.72 D**	**@ 110°**
Avg. K	42.33 D		Avg. TK	42.30 D		Avg. K	42.93 D		Avg. TK	42.89 D	
K1	42.10 D	@ 104°	TK1	41.86 D	@ 96°	K1	42.67 D	@ 128°	TK1	42.53 D	@ 110°
K2	42.56 D	@ 14°	TK2	42.75 D	@ 6°	K2	43.20 D	@ 38°	TK2	43.25 D	@ 20°

CÁLCULO DE IOL

⟅ ⟆ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.93
+21.50	-0.55
+21.00	**-0.17**
+20.50	+0.21
+20.78	0.00

a0 -0.626 a1 +0.212 a2 +0.181

AT LISA tri 839MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.72
+22.50	-0.35
+22.00	**+0.01**
+21.50	+0.36
+22.01	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.94
+21.50	-0.56
+21.00	**-0.18**
+20.50	+0.20
+20.77	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT ASPHINA 509MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.72
+20.00	-0.34
+19.50	**+0.04**
+19.00	+0.41
+19.55	0.00

a0 -0.626 a1 +0.212 a2 +0.181

AT LISA tri 839MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.57
+21.00	-0.20
+20.50	**+0.15**
+20.00	+0.51
+20.71	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.75
+20.00	-0.37
+19.50	**+0.01**
+19.00	+0.38
+19.52	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.58
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+23.16	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 621P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.58
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+23.16	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.70
+22.50	-0.33
+22.00	**+0.03**
+21.50	+0.39
+22.04	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 621P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.82
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.12**
+21.50	+0.22
+21.82	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 621P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.82
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.12**
+21.50	+0.22
+21.82	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.90
+21.50	-0.54
+21.00	**-0.18**
+20.50	+0.18
+20.75	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SN60WF

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.54
+22.50	-0.18
+22.00	**+0.18**
+21.50	+0.53
+22.25	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

Clareon PanOptix CNW TT0

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.81
+22.50	-0.44
+22.00	**-0.08**
+21.50	+0.28
+21.89	0.00

a0 +1.375 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.74
+23.00	-0.38
+22.50	**-0.03**
+22.00	+0.33
+22.46	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

AcrySof SN60WF

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.75
+21.50	-0.39
+21.00	**-0.03**
+20.50	+0.32
+20.95	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

Clareon PanOptix CNW TT0

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.64
+21.00	-0.28
+20.50	**+0.08**
+20.00	+0.43
+20.61	0.00

a0 +1.375 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.60
+21.50	-0.24
+21.00	**+0.11**
+20.50	+0.46
+21.16	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**CAMARA VALLADARES, ENRIQUE**
Fecha de nacimie...	11/sep./1950
Sexo	Masculino
ID paciente	20143
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **08/ene./2026** Fecha verif. calibración: **08/ene./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.83
+22.50	-0.46
+22.00	**-0.10**
+21.50	+0.26
+21.86	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.85
+22.50	-0.48
+22.00	**-0.11**
+21.50	+0.25
+21.85	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.68
+23.00	-0.32
+22.50	**+0.03**
+22.00	+0.38
+22.55	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.66
+21.00	-0.30
+20.50	**+0.06**
+20.00	+0.41
+20.58	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.68
+21.00	-0.31
+20.50	**+0.05**
+20.00	+0.40
+20.57	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.55
+21.50	-0.19
+21.00	**+0.16**
+20.50	+0.50
+21.23	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**CAMARA VALLADARES, ENRIQUE**
Fecha de nacimie...	11/sep./1950
Sexo	Masculino
ID paciente	20143
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **08/ene./2026** Fecha verif. calibración: **08/ene./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

!

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.70 mm**	SD 5 µm	WTW	11.8 mm	**AL**	**23.86 mm**	SD 5 µm	WTW	11.8 mm
ACD	2.72 mm	SD 4 µm	Pupila	2.5 mm	ACD	2.80 mm	SD 8 µm	Pupila	3.0 mm
LT	4.88 mm	SD 10 µm	Ix / Iy	+0.6 mm / +0.0 mm	LT	4.89 mm	SD 17 µm	Ix / Iy	-0.6 mm / +0.2 mm
CCT	575 µm	SD 4 µm	Kappa	0.2 mm @ 186 °	CCT	571 µm	SD 4 µm	Kappa	0.3 mm @ 298 °


OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-0.45 D**	**@ 104°**		**Ast. K**	**-0.53 D**	**@ 128°**	
Avg. K	42.33 D		SD 0.03 D	Avg. K	42.93 D		SD 0.01 D
K1	42.10 D	@ 104°	SD 0.03 D	K1	42.67 D	@ 128°	SD 0.03 D
K2	42.56 D	@ 14°	SD 0.03 D	K2	43.20 D	@ 38°	SD 0.04 D
Ast. TK	**-0.89 D**	**@ 96°**		**Ast. TK**	**-0.72 D**	**@ 110°**	
Avg. TK	42.30 D		SD 0.03 D	Avg. TK	42.89 D		SD 0.05 D
TK1	41.86 D	@ 96°	SD 0.04 D	TK1	42.53 D	@ 110°	SD 0.10 D
TK2	42.75 D	@ 6°	SD 0.04 D	TK2	43.25 D	@ 20°	SD 0.03 D

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

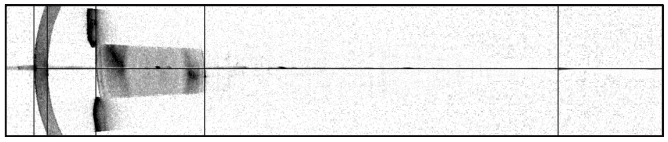


TOTAL AXIAL POWER

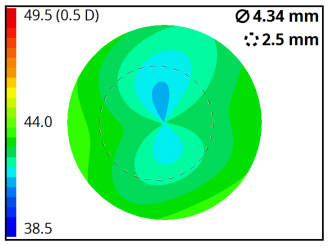


Ast. TK
-0.89 D @ 96°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

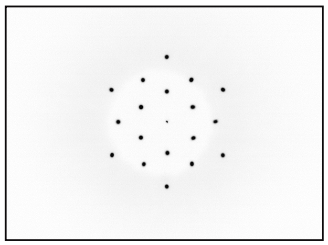


BLANCO-A-BLANCO

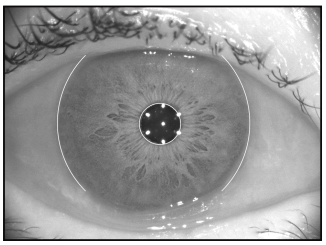

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

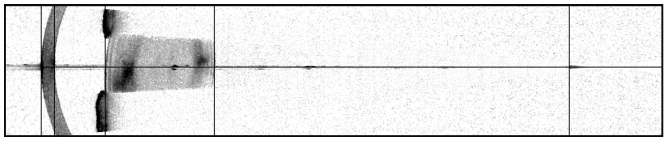


TOTAL AXIAL POWER

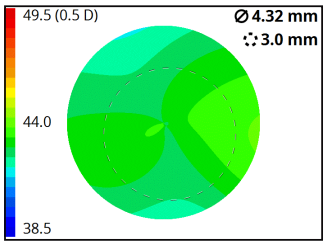


Ast. TK
-0.72 D @ 110°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

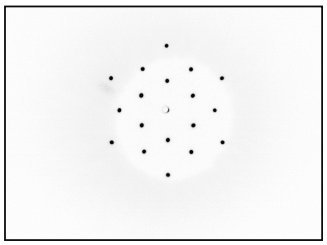

BLANCO-A-BLANCO

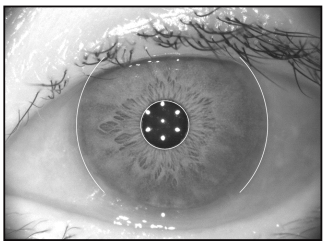

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD				OS			
LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---	Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-	LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°	Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD						OS					
AL:	23.70 mm	SD:	5 µm			AL:	23.86 mm	SD:	5 µm		
ACD:	2.72 mm	SD:	4 µm			ACD:	2.80 mm	SD:	8 µm		
LT:	4.88 mm	SD:	10 µm			LT:	4.89 mm	SD:	17 µm		
WTW:	11.8 mm					WTW:	11.8 mm				
SE:	42.33 D	SD:	0.03 D	K1:	42.10 D @104°	SE:	42.93 D	SD:	0.01 D	K1:	42.67 D @128°
ΔK:	-0.45 D	@104°		K2:	42.56 D @ 14°	ΔK:	-0.53 D	@128°		K2:	43.20 D @ 38°
TSE:	42.30 D	SD:	0.03 D	TK1:	41.86 D @ 96°	TSE:	42.89 D	SD:	0.05 D	TK1:	42.53 D @110°
ΔTK:	-0.89 D	@ 96°		TK2:	42.75 D @ 6°	ΔTK:	-0.72 D	@110°		TK2:	43.25 D @ 20°

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Haigis -
a0: -0.626 a1: +0.212 a2: +0.181

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.93
+21.50	-0.55
+21.00	**-0.17**
+20.50	+0.21
+20.00	+0.58
+20.78	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.72
+22.50	-0.35
+22.00	**+0.01**
+21.50	+0.36
+21.00	+0.72
+22.01	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Haigis -
a0: -0.626 a1: +0.212 a2: +0.181

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.72
+20.00	-0.34
+19.50	**+0.04**
+19.00	+0.41
+18.50	+0.78
+19.55	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.57
+21.00	-0.20
+20.50	**+0.15**
+20.00	+0.51
+19.50	+0.85
+20.71	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.94
+21.50	-0.56
+21.00	**-0.18**
+20.50	+0.20
+20.00	+0.57
+20.77	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.58
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+22.00	+0.79
+23.16	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.75
+20.00	-0.37
+19.50	**+0.01**
+19.00	+0.38
+18.50	+0.75
+19.52	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.82
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.12**
+21.50	+0.22
+21.00	+0.56
+21.82	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD				OS			
LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---	Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-	LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°	Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD						OS					
AL:	23.70 mm	SD:	5 µm			AL:	23.86 mm	SD:	5 µm		
ACD:	2.72 mm	SD:	4 µm			ACD:	2.80 mm	SD:	8 µm		
LT:	4.88 mm	SD:	10 µm			LT:	4.89 mm	SD:	17 µm		
WTW:	11.8 mm					WTW:	11.8 mm				
SE:	42.33 D	SD:	0.03 D	K1:	42.10 D @104°	SE:	42.93 D	SD:	0.01 D	K1:	42.67 D @128°
ΔK:	-0.45 D	@104°		K2:	42.56 D @ 14°	ΔK:	-0.53 D	@128°		K2:	43.20 D @ 38°
TSE:	42.30 D	SD:	0.03 D	TK1:	41.86 D @ 96°	TSE:	42.89 D	SD:	0.05 D	TK1:	42.53 D @110°
ΔTK:	-0.89 D	@ 96°		TK2:	42.75 D @ 6°	ΔTK:	-0.72 D	@110°		TK2:	43.25 D @ 20°

TK ZEISS CT LUCIA 202 — OD

- Haigis - a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.70
+22.50	-0.33
+22.00	**+0.03**
+21.50	+0.39
+21.00	+0.74
+22.04	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF — OD

- Haigis - a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.54
+22.50	-0.18
+22.00	**+0.18**
+21.50	+0.53
+21.00	+0.88
+22.25	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 202 — OS

- Haigis - a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.90
+21.50	-0.54
+21.00	**-0.18**
+20.50	+0.18
+20.00	+0.53
+20.75	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF — OS

- Haigis - a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.75
+21.50	-0.39
+21.00	**-0.03**
+20.50	+0.32
+20.00	+0.67
+20.95	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OD

- Haigis - a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.58
+23.50	-0.23
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.45
+22.00	+0.79
+23.16	Emetropía

TK Alcon Clareon PanOptix CNW TT0 — OD

- Haigis - a0: +1.375 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.81
+22.50	-0.44
+22.00	**-0.08**
+21.50	+0.28
+21.00	+0.64
+21.89	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OS

- Haigis - a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.82
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.12**
+21.50	+0.22
+21.00	+0.56
+21.82	Emetropía

TK Alcon Clareon PanOptix CNW TT0 — OS

- Haigis - a0: +1.375 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.64
+21.00	-0.28
+20.50	**+0.08**
+20.00	+0.43
+19.50	+0.78
+20.61	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD				OS			
LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---	Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-	LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°	Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD						OS					
AL:	23.70 mm	SD:	5 µm			AL:	23.86 mm	SD:	5 µm		
ACD:	2.72 mm	SD:	4 µm			ACD:	2.80 mm	SD:	8 µm		
LT:	4.88 mm	SD:	10 µm			LT:	4.89 mm	SD:	17 µm		
WTW:	11.8 mm					WTW:	11.8 mm				
SE:	42.33 D	SD:	0.03 D	K1:	42.10 D @104°	SE:	42.93 D	SD:	0.01 D	K1:	42.67 D @128°
ΔK:	-0.45 D	@104°		K2:	42.56 D @ 14°	ΔK:	-0.53 D	@128°		K2:	43.20 D @ 38°
TSE:	42.30 D	SD:	0.03 D	TK1:	41.86 D @ 96°	TSE:	42.89 D	SD:	0.05 D	TK1:	42.53 D @110°
ΔTK:	-0.89 D	@ 96°		TK2:	42.75 D @ 6°	ΔTK:	-0.72 D	@110°		TK2:	43.25 D @ 20°

TK Bausch + Lomb enVista — OD

- Haigis - a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.74
+23.00	-0.38
+22.50	**-0.03**
+22.00	+0.33
+21.50	+0.67
+22.46	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OD

- Haigis - a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.83
+22.50	-0.46
+22.00	**-0.10**
+21.50	+0.26
+21.00	+0.62
+21.86	Emetropía

TK Bausch + Lomb enVista — OS

- Haigis - a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.60
+21.50	-0.24
+21.00	**+0.11**
+20.50	+0.46
+20.00	+0.80
+21.16	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OS

- Haigis - a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.66
+21.00	-0.30
+20.50	**+0.06**
+20.00	+0.41
+19.50	+0.77
+20.58	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OD

- Haigis - a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.85
+22.50	-0.48
+22.00	**-0.11**
+21.50	+0.25
+21.00	+0.61
+21.85	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OD

- Haigis - a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.68
+23.00	-0.32
+22.50	**+0.03**
+22.00	+0.38
+21.50	+0.73
+22.55	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OS

- Haigis - a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.68
+21.00	-0.31
+20.50	**+0.05**
+20.00	+0.40
+19.50	+0.76
+20.57	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OS

- Haigis - a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.55
+21.50	-0.19
+21.00	**+0.16**
+20.50	+0.50
+20.00	+0.84
+21.23	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.70 mm	SD:	5 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	+0.6 mm
CCT:	575 µm	SD:	4 µm	P:	2.5 mm	Iy:	+0.0 mm
ACD:	2.72 mm	SD:	4 µm			CW-chord:	0.2 mm @ 186°
LT:	4.88 mm	SD:	10 µm				


SE:	42.33 D		SD:	0.03 D	TSE:	42.30 D		SD: 0.03 D
K1:	42.10 D	@ 104°	SD:	0.03 D	TK1:	41.86 D	@ 96°	SD: 0.04 D
K2:	42.56 D	@ 14°	SD:	0.03 D	TK2:	42.75 D	@ 6°	SD: 0.04 D
ΔK:	-0.45 D	@ 104°			ΔTK:	-0.89 D	@ 96°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power

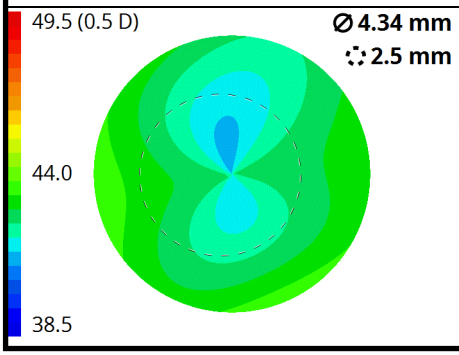

Queratometría

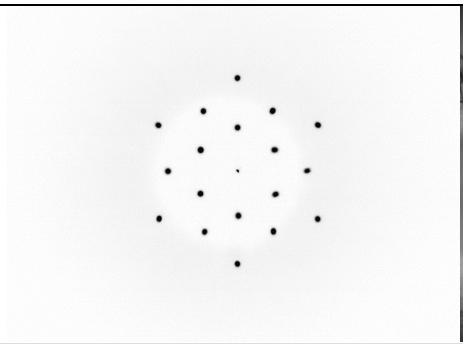

Blanco a blanco

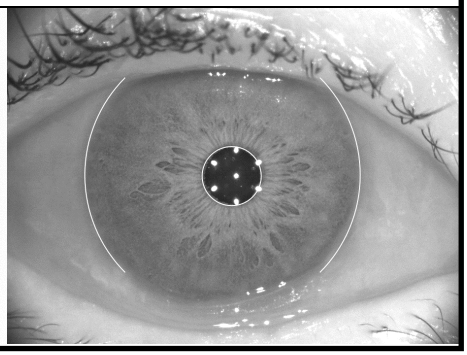

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.86 mm	SD:	5 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.6 mm
CCT:	571 µm	SD:	4 µm	P:	3.0 mm	Iy:	+0.2 mm
ACD:	2.80 mm	SD:	8 µm			CW-chord:	0.3 mm @ 298°
LT:	4.89 mm	SD:	17 µm				


SE:	42.93 D		SD:	0.01 D	TSE:	42.89 D		SD: 0.05 D
K1:	42.67 D	@ 128°	SD:	0.03 D	TK1:	42.53 D	@ 110°	SD: 0.10 D
K2:	43.20 D	@ 38°	SD:	0.04 D	TK2:	43.25 D	@ 20°	SD: 0.03 D
ΔK:	-0.53 D	@ 128°			ΔTK:	-0.72 D	@ 110°	

Scan B

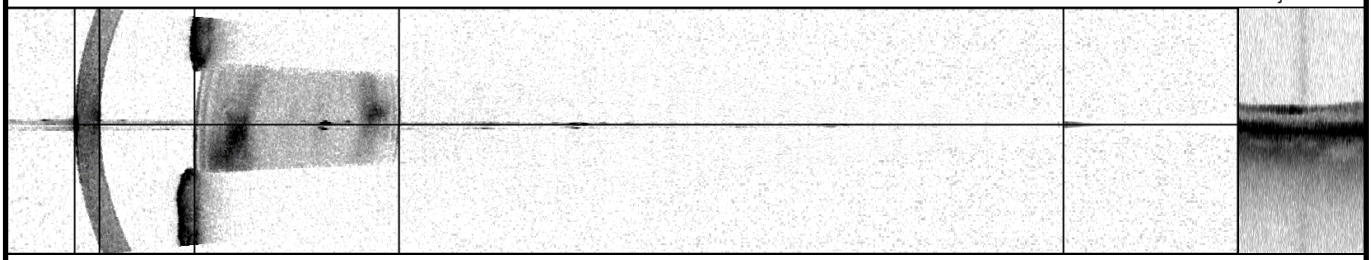


Fijación


Total Axial Power

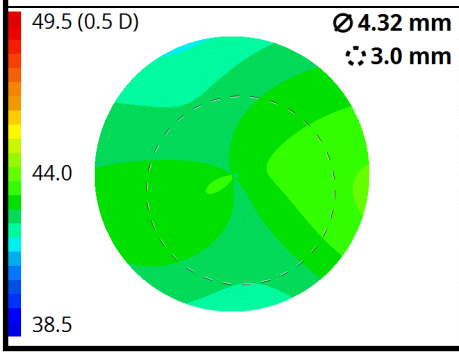

Queratometría

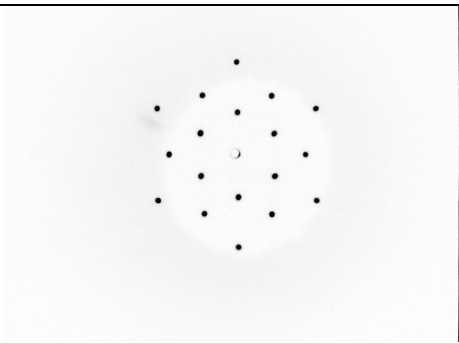

Blanco a blanco

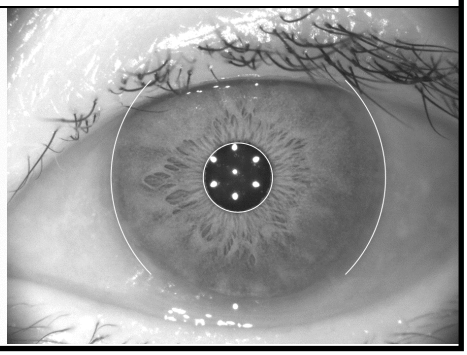

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo

Estatus del ojo

OD	OS
LS: Fáquica VS: Humor vítreo	LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado

Valores biométricos

OD		OS	
AL: **23.70** mm	SD: 5 µm	AL: **23.86** mm	SD: 5 µm
CCT: **575** µm	SD: 4 µm	CCT: **571** µm	SD: 4 µm
ACD: **2.72** mm	SD: 4 µm	ACD: **2.80** mm	SD: 8 µm
LT: **4.88** mm	SD: 10 µm	LT: **4.89** mm	SD: 17 µm

OD AL	OD CCT	OD ACD	OD LT	OS AL	OS CCT	OS ACD	OS LT
23.71 mm	574 µm	2.72 mm	4.88 mm	23.86 mm	572 µm	2.81 mm	4.87 mm
23.70 mm	571 µm	2.71 mm	4.88 mm	23.85 mm	568 µm	2.80 mm	4.89 mm
23.70 mm	575 µm	2.72 mm	4.88 mm	23.86 mm	568 µm	2.80 mm	4.90 mm
23.71 mm	574 µm	2.72 mm	4.87 mm	23.86 mm	570 µm	2.79 mm	4.89 mm
23.70 mm	575 µm	2.72 mm	4.88 mm	23.86 mm	572 µm	2.79 mm	4.89 mm
23.71 mm	579 µm	2.72 mm	4.89 mm	23.86 mm	572 µm	2.80 mm	4.89 mm

Valores de la córnea

OD			OS		
SE: **42.33** D		SD: 0.03 D	SE: **42.93** D		SD: 0.01 D
K1: **42.10** D	@ **104**°	SD: 0.03 D	K1: **42.67** D	@ **128**°	SD: 0.03 D
K2: **42.56** D	@ **14**°	SD: 0.03 D	K2: **43.20** D	@ **38**°	SD: 0.04 D
ΔK: **-0.45** D	@ **104**°		ΔK: **-0.53** D	@ **128**°	

OD			OS		
SE: 42.35 D	ΔK: -0.46 D	@ 109°	SE: 42.93 D	ΔK: -0.45 D	@ 129°
SE: 42.33 D	ΔK: -0.46 D	@ 103°	SE: 42.93 D	ΔK: -0.53 D	@ 128°
SE: 42.30 D	ΔK: -0.45 D	@ 101°	SE: 42.94 D	ΔK: -0.61 D	@ 128°

OD			OS		
TSE: **42.30** D		SD: 0.03 D	TSE: **42.89** D		SD: 0.05 D
TK1: **41.86** D	@ **96**°	SD: 0.04 D	TK1: **42.53** D	@ **110**°	SD: 0.10 D
TK2: **42.75** D	@ **6**°	SD: 0.04 D	TK2: **43.25** D	@ **20**°	SD: 0.03 D
ΔTK: **-0.89** D	@ **96**°		ΔTK: **-0.72** D	@ **110**°	

OD			OS		
TSE: 42.33 D	ΔTK: -0.94 D	@ 98°	TSE: 42.94 D	ΔTK: -0.59 D	@ 110°
TSE: 42.27 D	ΔTK: -0.90 D	@ 95°	TSE: 42.85 D	ΔTK: -0.74 D	@ 111°
TSE: 42.31 D	ΔTK: -0.82 D	@ 94°	TSE: 42.88 D	ΔTK: -0.82 D	@ 110°

Valores de blanco a blanco y de pupila

OD			OS		
WTW: 11.8 mm	lx: +0.6 mm	ly: +0.0 mm	WTW: 11.8 mm	lx: -0.6 mm	ly: +0.2 mm
P: 2.5 mm	CW-chord: 0.2 mm @ 186°		P: 3.0 mm	CW-chord: 0.3 mm @ 298°	

Se ha guardado la imagen	Reference Image	Se ha guardado la imagen

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.70 mm			SE:	42.33 D		
ACD:	2.72 mm			K1:	42.10 D	@	104°
LT:	4.88 mm			K2:	42.56 D	@	14°
WTW:	11.8 mm	Ix:	+0.6 mm	ΔK:	-0.45 D	@	104°
P:	2.5 mm	Iy:	+0.0 mm				
		CW-chord:	0.2 mm @ 186°				

TSE:	42.30 D				
TK1:	41.86 D	@	96°		
TK2:	42.75 D	@	6°		
ΔTK:	-0.89 D	@	96°		

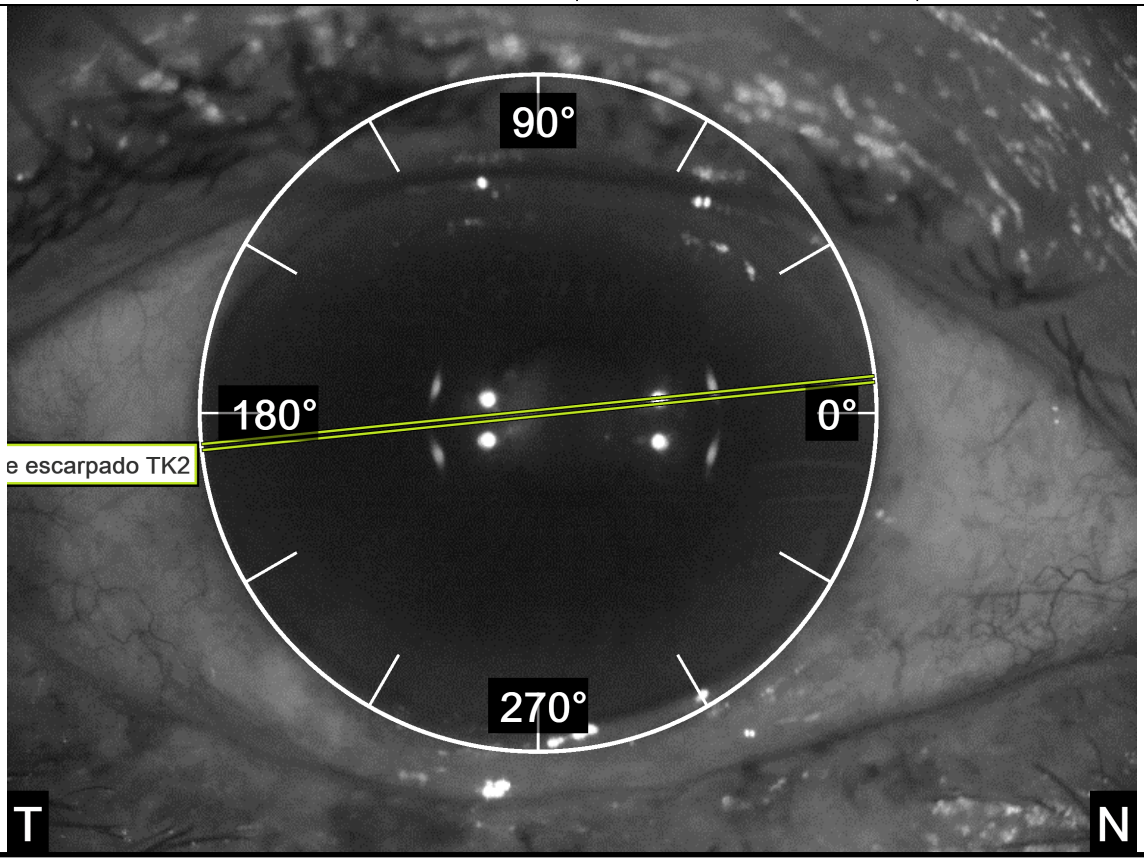

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CAMARA VALLADARES, ENRIQUE		
Fecha de nacim.	11/sep./1950	Sexo	Masculino
ID del paciente	20143		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	08/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	08/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.86 mm			SE:	42.93 D		
ACD:	2.80 mm			K1:	42.67 D	@	128°
LT:	4.89 mm			K2:	43.20 D	@	38°
WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.6 mm Iy: +0.2 mm	ΔK:	-0.53 D	@	128°
P:	3.0 mm	CW-chord:	0.3 mm @ 298°				

TSE:	42.89 D		
TK1:	42.53 D	@	110°
TK2:	43.25 D	@	20°
ΔTK:	-0.72 D	@	110°

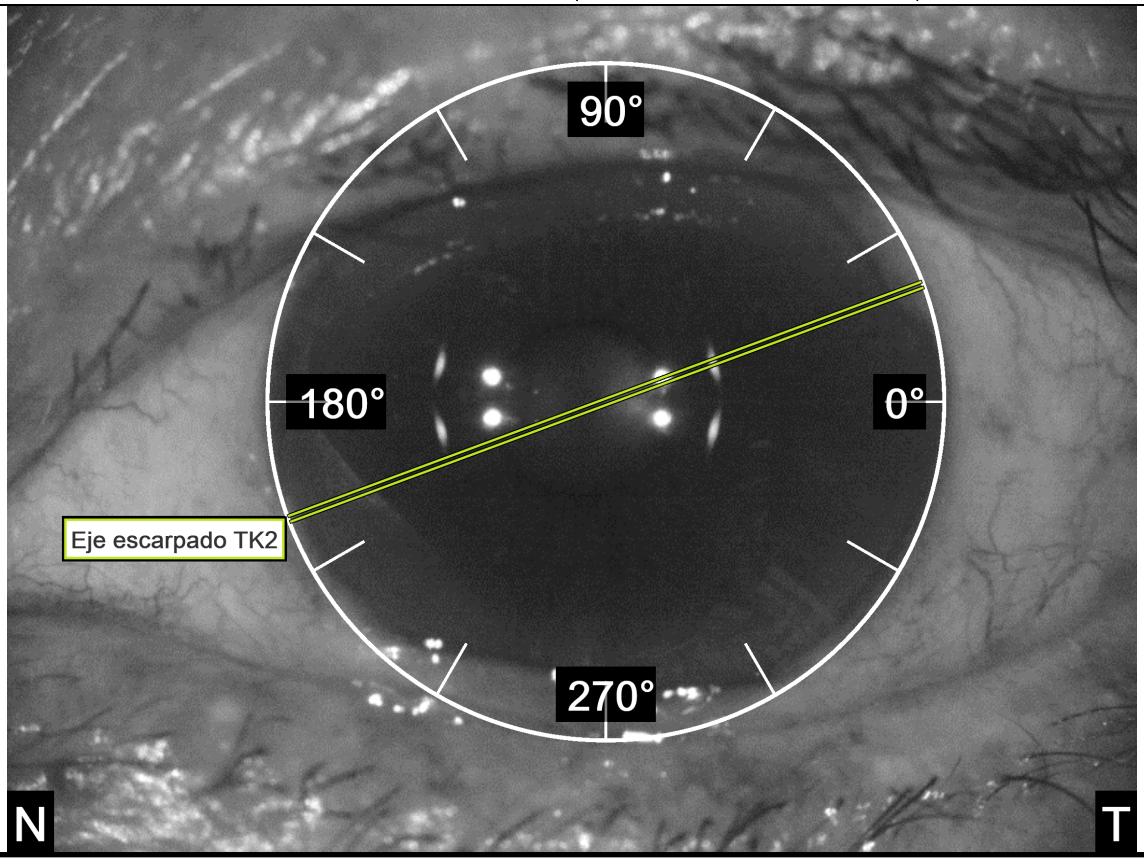

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CALCULO DE LIO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved