CÁLCULO DE IOL

Paciente	**DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	28/jul./1979		
Sexo	Femenino		
ID paciente	20065		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **30/mar./2026** Fecha verif. calibración: **30/mar./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Seudofáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

VALORES BIOMÉTRICOS

(n=1.3375) — ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**24.00 mm**		WTW	11.8 mm		**AL**	**23.91 mm**		WTW	11.7 mm	
ACD	2.67 mm		Pupila	5.5 mm		ACD	---		Pupila	5.0 mm	
LT	5.03 mm		Ix / Iy	+0.5 mm	/+0.3 mm	LT	---		Ix / Iy	-0.5 mm	/+0.2 mm
CCT	521 µm		Kappa	0.3 mm	@ 210°	CCT	507 µm		Kappa	0.3 mm	@ 303°
Ast. K	**-0.63 D**	**@ 110°**	**Ast. TK**	**-0.99 D**	**@ 102°**	**Ast. K**	**-0.64 D**	**@ 25°**	**Ast. TK**	**-0.47 D**	**@ 36°**
Avg. K	43.66 D		Avg. TK	43.41 D		Avg. K	43.21 D		Avg. TK	42.99 D	
K1	43.35 D	@ 110°	TK1	42.92 D	@ 102°	K1	42.89 D	@ 25°	TK1	42.75 D	@ 36°
K2	43.97 D	@ 20°	TK2	43.91 D	@ 12°	K2	43.53 D	@ 115°	TK2	43.22 D	@ 126°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT LUCIA 221P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.61
+20.50	-0.26
+20.00	**+0.09**
+19.50	+0.43
+20.12	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.61
+20.50	-0.26
+20.00	**+0.09**
+19.50	+0.43
+20.12	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.71
+20.00	-0.35
+19.50	**+0.01**
+19.00	+0.36
+19.51	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+19.00	-0.57
+18.50	-0.19
+18.00	**+0.18**
+17.50	+0.55
+18.25	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.70
+21.00	-0.35
+20.50	**-0.01**
+20.00	+0.33
+20.48	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.77
+20.00	-0.41
+19.50	**-0.05**
+19.00	+0.30
+19.42	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

Clareon SY60WF

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.72
+20.50	-0.37
+20.00	**-0.02**
+19.50	+0.33
+19.97	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

Akreos Adapt

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+19.50	-0.68
+19.00	-0.30
+18.50	**+0.07**
+18.00	+0.43
+18.59	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis — TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.82
+20.50	-0.46
+20.00	**-0.11**
+19.50	+0.24
+19.84	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	28/jul./1979		
Sexo	Femenino		
ID paciente	20065		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **30/mar./2026** Fecha verif. calibración: **30/mar./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.89
+20.00	-0.53
+19.50	**-0.17**
+19.00	+0.19
+19.27	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.87
+20.00	-0.50
+19.50	**-0.14**
+19.00	+0.22
+19.31	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.80
+20.50	-0.44
+20.00	**-0.09**
+19.50	+0.26
+19.87	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH**
Fecha de nacimie...	28/jul./1979
Sexo	Femenino
ID paciente	20065
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **30/mar./2026** Fecha verif. calibración: **30/mar./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho				Estatus del ojo				**izquierdo OS**
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Seudofáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

AL	**24.00 mm**	SD	9 µm	WTW	11.8 mm	**AL**	**23.91 mm**	SD	8 µm	WTW	11.7 mm
ACD	2.67 mm	SD	6 µm	Pupila	5.5 mm	ACD	---			Pupila	5.0 mm
LT	5.03 mm	SD	28 µm	Ix / Iy	+0.5 mm / +0.3 mm	LT	---			Ix / Iy	-0.5 mm / +0.2 mm
CCT	521 µm	SD	4 µm	Kappa	0.3 mm @ 210 °	CCT	507 µm	SD	4 µm	Kappa	0.3 mm @ 303 °


Ast. K	**-0.63 D**	**@**	**110°**			**Ast. K**	**-0.64 D**	**@**	**25°**		
Avg. K	43.66 D			SD 0.03 D		Avg. K	43.21 D			SD 0.01 D	
K1	43.35 D	@	110°	SD 0.02 D		K1	42.89 D	@	25°	SD 0.01 D	
K2	43.97 D	@	20°	SD 0.04 D		K2	43.53 D	@	115°	SD 0.02 D	
Ast. TK	**-0.99 D**	**@**	**102°**			**Ast. TK**	**-0.47 D**	**@**	**36°**		
Avg. TK	43.41 D			SD 0.04 D		Avg. TK	42.99 D			SD 0.02 D	
TK1	42.92 D	@	102°	SD 0.04 D		TK1	42.75 D	@	36°	SD 0.05 D	
TK2	43.91 D	@	12°	SD 0.05 D		TK2	43.22 D	@	126°	SD 0.02 D	

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

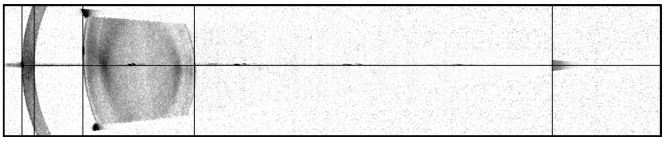

TOTAL AXIAL POWER

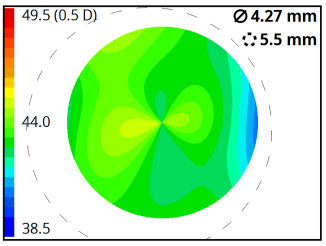


Ast. TK
-0.99 D @ 102°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

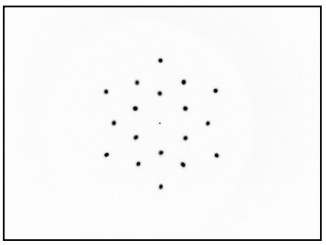


BLANCO-A-BLANCO

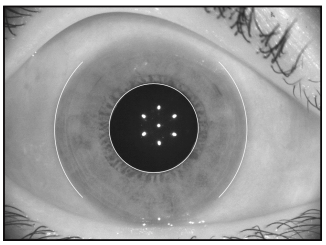

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

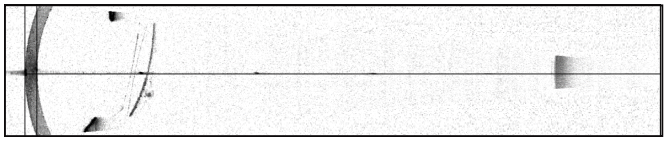


TOTAL AXIAL POWER

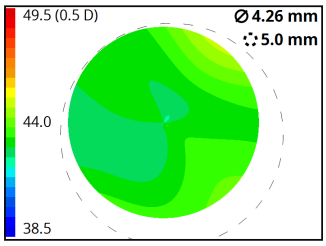


Ast. TK
-0.47 D @ 36°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

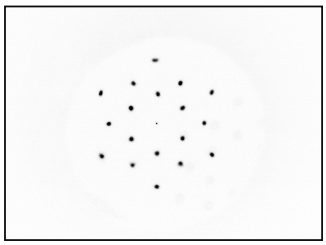

BLANCO-A-BLANCO

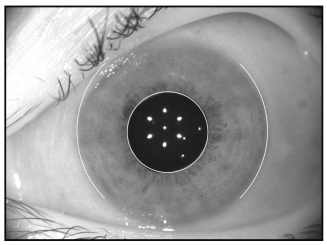

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Seudofáquico	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: No tratado	Modo LVC: -	LVC: No tratado	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD			OS	
AL:	24.00 mm	SD:	9 µm	AL: 23.91 mm	SD: 8 µm
ACD:	2.67 mm	SD:	6 µm	ACD: ---	
LT:	5.03 mm	SD:	28 µm	LT: ---	
WTW:	11.8 mm			WTW: 11.7 mm	
SE:	43.66 D	SD:	0.03 D	SE: 43.21 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-0.63 D	@110°		ΔK: -0.64 D	@ 25°
TSE:	43.41 D	SD:	0.04 D	TSE: 42.99 D	SD: 0.02 D
ΔTK:	-0.99 D	@102°		ΔTK: -0.47 D	@ 36°

OD				OS			
K1:	43.35 D	@110°		K1:	42.89 D	@ 25°	
K2:	43.97 D	@ 20°		K2:	43.53 D	@115°	
TK1:	42.92 D	@102°		TK1:	42.75 D	@ 36°	
TK2:	43.91 D	@ 12°		TK2:	43.22 D	@126°	

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.61
+20.50	-0.26
+20.00	**+0.09**
+19.50	+0.43
+19.00	+0.77
+20.12	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.71
+20.00	-0.35
+19.50	**+0.01**
+19.00	+0.36
+18.50	+0.71
+19.51	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+19.00	-0.57
+18.50	-0.19
+18.00	**+0.18**
+17.50	+0.55
+17.00	+0.92
+18.25	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.70
+21.00	-0.35
+20.50	**-0.01**
+20.00	+0.33
+19.50	+0.66
+20.48	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Seudofáquico	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: No tratado	Modo LVC: -	LVC: No tratado	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD			OS		
AL:	24.00 mm	SD:	9 µm	AL:	23.91 mm	SD: 8 µm
ACD:	2.67 mm	SD:	6 µm	ACD:	---	
LT:	5.03 mm	SD:	28 µm	LT:	---	
WTW:	11.8 mm			WTW:	11.7 mm	
SE:	43.66 D	SD:	0.03 D	SE:	43.21 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-0.63 D	@110°		ΔK:	-0.64 D	@ 25°
TSE:	43.41 D	SD:	0.04 D	TSE:	42.99 D	SD: 0.02 D
ΔTK:	-0.99 D	@102°		ΔTK:	-0.47 D	@ 36°

OD				OS			
K1:	43.35 D	@110°		K1:	42.89 D	@ 25°	
K2:	43.97 D	@ 20°		K2:	43.53 D	@115°	
TK1:	42.92 D	@102°		TK1:	42.75 D	@ 36°	
TK2:	43.91 D	@ 12°		TK2:	43.22 D	@126°	

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.77
+20.00	-0.41
+19.50	**-0.05**
+19.00	+0.30
+18.50	+0.65
+19.42	Emetropía

TK Alcon Clareon SY60WF

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.72
+20.50	-0.37
+20.00	**-0.02**
+19.50	+0.33
+19.00	+0.67
+19.97	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.61
+20.50	-0.26
+20.00	**+0.09**
+19.50	+0.43
+19.00	+0.77
+20.12	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+19.50	-0.68
+19.00	-0.30
+18.50	**+0.07**
+18.00	+0.43
+17.50	+0.80
+18.59	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Seudofáquico	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: No tratado	Modo LVC: -	LVC: No tratado	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD			OS	
AL:	24.00 mm	SD:	9 µm	AL: 23.91 mm	SD: 8 µm
ACD:	2.67 mm	SD:	6 µm	ACD: ---	
LT:	5.03 mm	SD:	28 µm	LT: ---	
WTW:	11.8 mm			WTW: 11.7 mm	
SE:	43.66 D	SD: 0.03 D		SE: 43.21 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-0.63 D	@110°		ΔK: -0.64 D	@ 25°
TSE:	43.41 D	SD: 0.04 D		TSE: 42.99 D	SD: 0.02 D
ΔTK:	-0.99 D	@102°		ΔTK: -0.47 D	@ 36°

OD			OS		
K1:	43.35 D	@110°	K1:	42.89 D	@ 25°
K2:	43.97 D	@ 20°	K2:	43.53 D	@115°
TK1:	42.92 D	@102°	TK1:	42.75 D	@ 36°
TK2:	43.91 D	@ 12°	TK2:	43.22 D	@126°

TK Bausch + Lomb enVista

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.82
+20.50	-0.46
+20.00	**-0.11**
+19.50	+0.24
+19.00	+0.58
+19.84	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.89
+20.00	-0.53
+19.50	**-0.17**
+19.00	+0.19
+18.50	+0.54
+19.27	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.87
+20.00	-0.50
+19.50	**-0.14**
+19.00	+0.22
+18.50	+0.57
+19.31	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.80
+20.50	-0.44
+20.00	**-0.09**
+19.50	+0.26
+19.00	+0.60
+19.87	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho — Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	24.00 mm	SD:	9 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	+0.5 mm
CCT:	521 µm	SD:	4 µm	P:	5.5 mm	Iy:	+0.3 mm
ACD:	2.67 mm	SD:	6 µm			CW-chord:	0.3 mm @ 210°
LT:	5.03 mm	SD:	28 µm				

SE:	43.66 D		SD:	0.03 D	TSE:	43.41 D		SD: 0.04 D
K1:	43.35 D	@ 110°	SD:	0.02 D	TK1:	42.92 D	@ 102°	SD: 0.04 D
K2:	43.97 D	@ 20°	SD:	0.04 D	TK2:	43.91 D	@ 12°	SD: 0.05 D
ΔK:	-0.63 D	@ 110°			ΔTK:	-0.99 D	@ 102°	

Scan B — Fijación

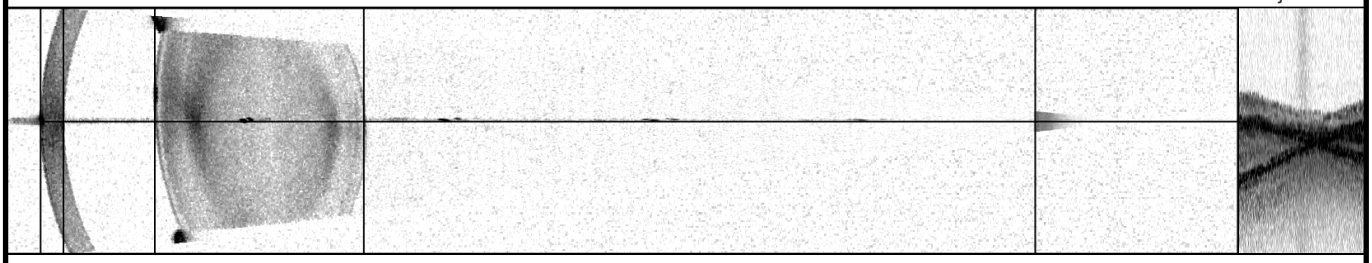

Total Axial Power — Queratometría — Blanco a blanco

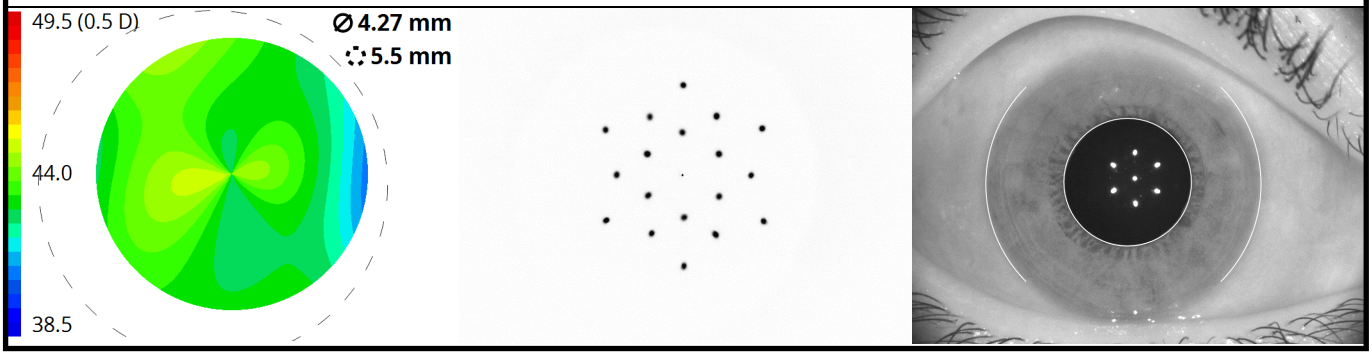

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.91 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.7 mm	Ix:	-0.5 mm
CCT:	507 µm	SD:	4 µm	P:	5.0 mm	Iy:	+0.2 mm
ACD:	---					CW-chord:	0.3 mm @ 303°
LT:	---						

SE:	43.21 D			SD:	0.01 D	TSE:	42.99 D		SD: 0.02 D
K1:	42.89 D	@	25°	SD:	0.01 D	TK1:	42.75 D	@ 36°	SD: 0.05 D
K2:	43.53 D	@	115°	SD:	0.02 D	TK2:	43.22 D	@ 126°	SD: 0.02 D
ΔK:	-0.64 D	@	25°			ΔTK:	-0.47 D	@ 36°	


Scan B

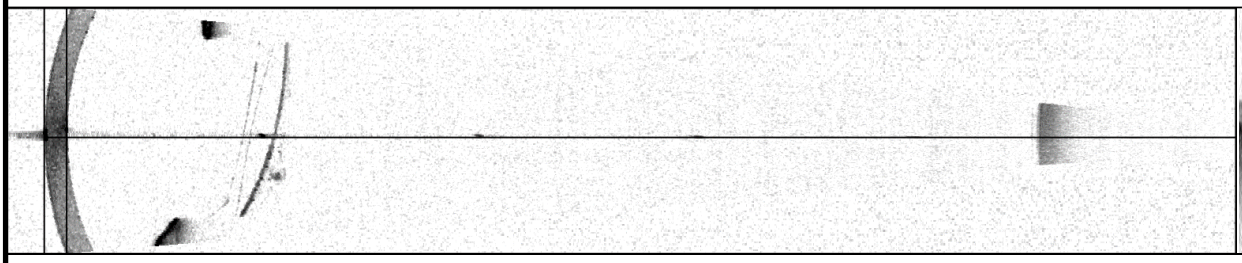


Fijación




Total Axial Power

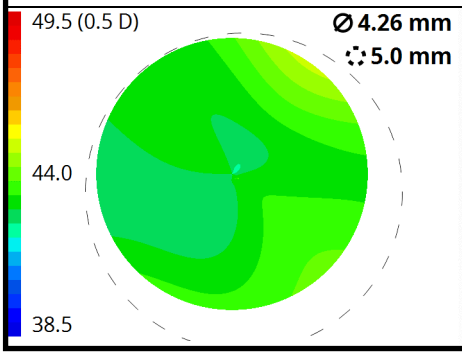

Queratometría

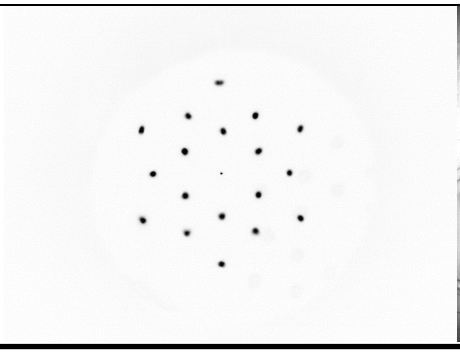

Blanco a blanco

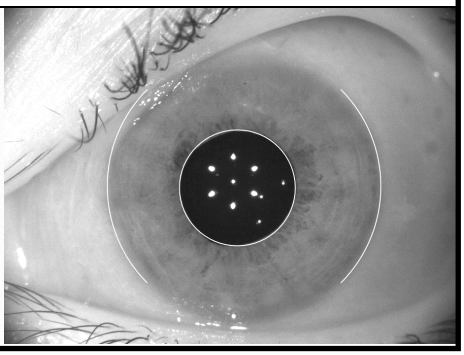

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **24.00** mm SD: 9 µm
CCT: **521** µm SD: 4 µm
ACD: **2.67** mm SD: 6 µm
LT: **5.03** mm SD: 28 µm

AL	CCT	ACD	LT
24.00 mm	521 µm	2.67 mm	5.00 mm
24.00 mm	522 µm	2.66 mm	5.04 mm
24.00 mm	517 µm	2.67 mm	5.04 mm
24.00 mm	521 µm	2.68 mm	5.03 mm
24.01 mm	522 µm	2.67 mm	5.04 mm
24.01 mm	522 µm	2.67 mm	5.04 mm

Valores de la córnea

SE: **43.66** D SD: 0.03 D
K1: **43.35** D @ **110**° SD: 0.02 D
K2: **43.97** D @ **20**° SD: 0.04 D
ΔK: **-0.63** D @ **110**°

SE: 43.63 D	ΔK: -0.62 D	@ 108°
SE: 43.67 D	ΔK: -0.63 D	@ 110°
SE: 43.67 D	ΔK: -0.63 D	@ 111°

TSE: **43.41** D SD: 0.04 D
TK1: **42.92** D @ **102**° SD: 0.04 D
TK2: **43.91** D @ **12**° SD: 0.05 D
ΔTK: **-0.99** D @ **102**°

TSE: 43.36 D	ΔTK: -0.98 D	@ 101°
TSE: 43.44 D	ΔTK: -0.97 D	@ 102°
TSE: 43.43 D	ΔTK: -1.02 D	@ 101°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.8 mm Ix: +0.5 mm Iy: +0.3 mm
P: 5.5 mm CW-chord: 0.3 mm @ 210°

Se ha guardado la imagen

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **23.91** mm SD: 8 µm
CCT: **507** µm SD: 4 µm
ACD: **---**
LT: **---**

AL	CCT	ACD	LT
23.91 mm	507 µm	---	---
23.90 mm	507 µm	---	---
23.90 mm	504 µm	---	---
23.90 mm	505 µm	---	---
23.91 mm	508 µm	---	---
23.91 mm	509 µm	---	---

Valores de la córnea

SE: **43.21** D SD: 0.01 D
K1: **42.89** D @ **25**° SD: 0.01 D
K2: **43.53** D @ **115**° SD: 0.02 D
ΔK: **-0.64** D @ **25**°

SE: 43.21 D	ΔK: -0.62 D	@ 26°
SE: 43.21 D	ΔK: -0.65 D	@ 25°
SE: 43.21 D	ΔK: -0.66 D	@ 24°

TSE: **42.99** D SD: 0.02 D
TK1: **42.75** D @ **36**° SD: 0.05 D
TK2: **43.22** D @ **126**° SD: 0.02 D
ΔTK: **-0.47** D @ **36**°

TSE: 42.98 D	ΔTK: -0.55 D	@ 34°
TSE: 43.01 D	ΔTK: -0.40 D	@ 28°
TSE: 42.97 D	ΔTK: -0.50 D	@ 43°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.7 mm Ix: -0.5 mm Iy: +0.2 mm
P: 5.0 mm CW-chord: 0.3 mm @ 303°

Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	24.00 mm			SE:	43.66 D		
ACD:	2.67 mm			K1:	43.35 D	@	110°
LT:	5.03 mm			K2:	43.97 D	@	20°
WTW:	11.8 mm	Ix:	+0.5 mm	ΔK:	-0.63 D	@	110°
P:	5.5 mm	Iy:	+0.3 mm				
		CW-chord:	0.3 mm @ 210°				

TSE:	43.41 D				
TK1:	42.92 D	@	102°		
TK2:	43.91 D	@	12°		
ΔTK:	-0.99 D	@	102°		

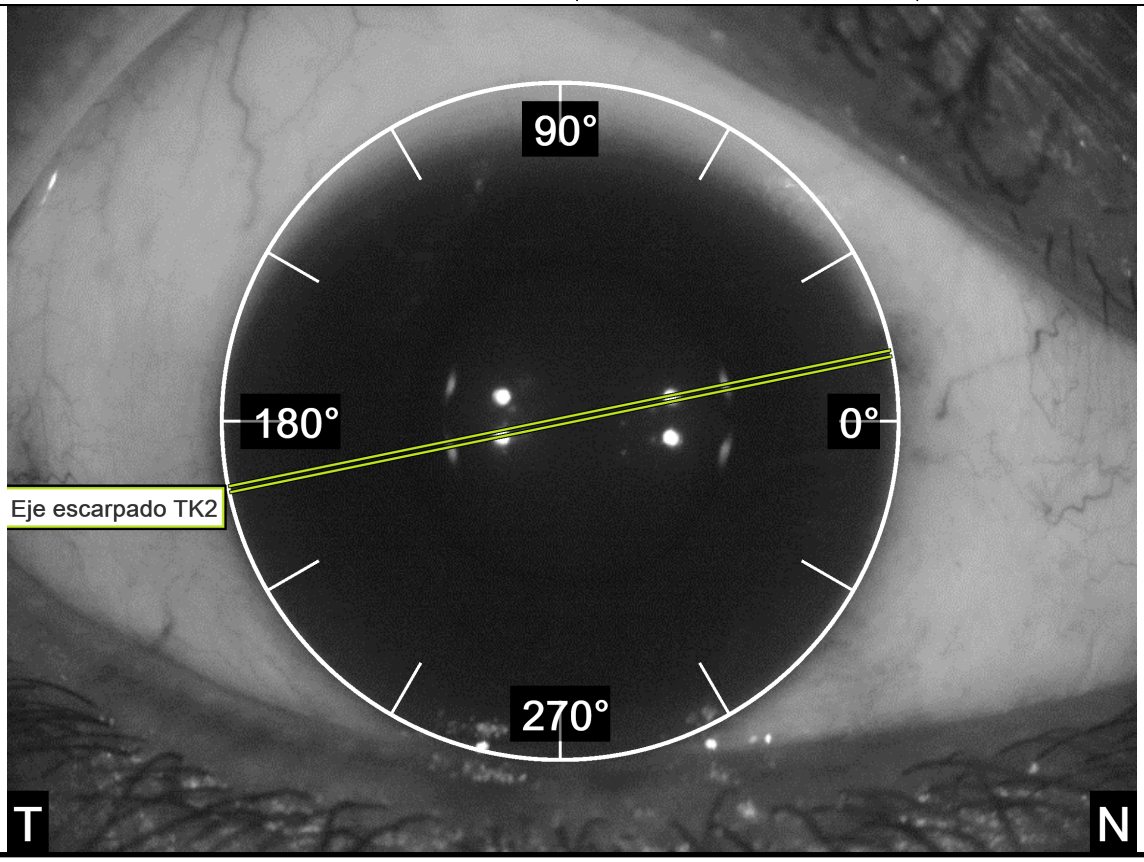

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	DIAZ BARRAGAN, GABRIELLA ELIZETH		
Fecha de nacim.	28/jul./1979	Sexo	Femenino
ID del paciente	20065		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	30/mar./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	30/mar./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.91 mm			SE:	43.21 D		
ACD:	---			K1:	42.89 D	@	25°
LT:	---			K2:	43.53 D	@	115°
WTW:	11.7 mm	Ix:	-0.5 mm	ΔK:	-0.64 D	@	25°
P:	5.0 mm	CW-chord:	0.3 mm @ 303°				

TSE:	42.99 D		
TK1:	42.75 D	@	36°
TK2:	43.22 D	@	126°
ΔTK:	-0.47 D	@	36°

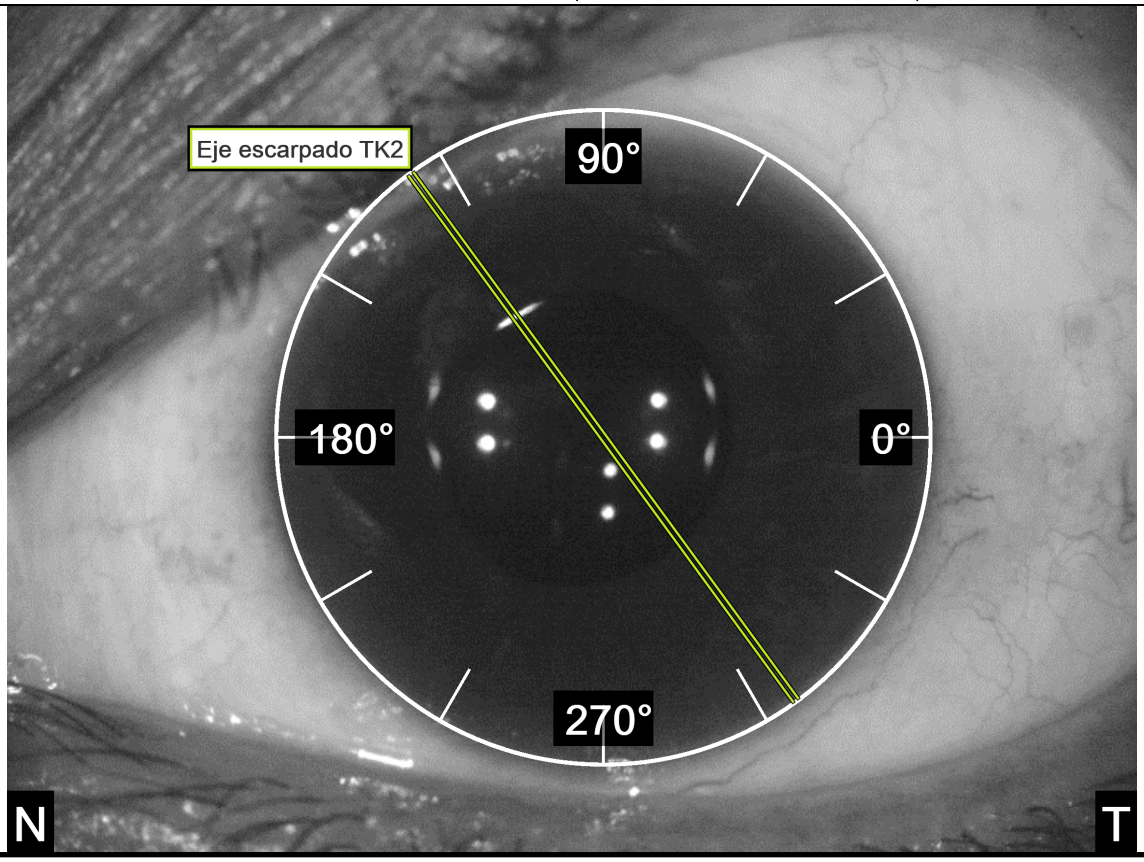

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,PSEUDOFAQUIA OI,FC AO,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved