CÁLCULO DE IOL

Paciente	**POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI**
Fecha de nacimie...	18/jun./1992
Sexo	Femenino
ID paciente	20179
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **14/ene./2026** Fecha verif. calibración: **14/ene./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**23.83 mm**		WTW	13.4 mm		**AL**	**23.84 mm**		WTW	13.3 mm	(!)
ACD	3.64 mm		Pupila	3.8 mm		ACD	3.72 mm		Pupila	5.4 mm	
LT	3.78 mm		Ix / Iy	+0.4 mm / -0.1 mm		LT	3.74 mm		Ix / Iy	-0.4 mm / -0.4 mm	
CCT	488 µm		Kappa	0.2 mm	@ 166°	CCT	494 µm		Kappa	0.3 mm	@ 63°
Ast. K	**-1.91 D**	**@ 178°**	**Ast. TK**	**-1.82 D**	**@ 177°**	**Ast. K**	**-2.03 D**	**@ 4°**	**Ast. TK**	**-1.96 D**	**@ 5°**
Avg. K	43.64 D		Avg. TK	43.72 D		Avg. K	43.84 D		Avg. TK	43.97 D	
K1	42.71 D	@ 178°	TK1	42.83 D	@ 177°	K1	42.85 D	@ 4°	TK1	43.01 D	@ 5°
K2	44.62 D	@ 88°	TK2	44.65 D	@ 87°	K2	44.88 D	@ 94°	TK2	44.97 D	@ 95°

CÁLCULO DE IOL

Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.00	-0.67
+19.50	-0.31
+19.00	**+0.06**
+18.50	+0.42
+19.08	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.66
+20.50	-0.30
+20.00	**+0.05**
+19.50	+0.40
+20.07	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.59
+20.50	-0.23
+20.00	**+0.11**
+19.50	+0.46
+20.17	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.00	-0.90
+19.50	-0.53
+19.00	**-0.17**
+18.50	+0.19
+18.77	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.53
+20.00	-0.18
+19.50	**+0.17**
+19.00	+0.51
+19.75	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.82
+20.50	-0.46
+20.00	**-0.11**
+19.50	+0.23
+19.84	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.76
+21.50	-0.42
+21.00	**-0.08**
+20.50	+0.26
+20.88	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.69
+21.00	-0.34
+20.50	**+0.00**
+20.00	+0.34
+20.50	0.00

LF +2.06 DF +5.0

enVista enhanced (MX60E)

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.86
+21.00	-0.51
+20.50	**-0.16**
+20.00	+0.19
+20.27	0.00

LF +1.94 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.65
+21.00	-0.30
+20.50	**+0.03**
+20.00	+0.37
+20.55	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.57
+20.50	-0.23
+20.00	**+0.12**
+19.50	+0.45
+20.17	0.00

LF +2.06 DF +5.0

enVista enhanced (MX60E)

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.73
+20.50	-0.38
+20.00	**-0.04**
+19.50	+0.31
+19.95	0.00

LF +1.94 DF +5.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.72
+20.50	-0.37
+20.00	**-0.01**
+19.50	+0.33
+19.98	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.58
+20.00	-0.22
+19.50	**+0.14**
+19.00	+0.49
+19.70	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.65
+21.00	-0.30
+20.50	**+0.04**
+20.00	+0.38
+20.56	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.59
+20.00	-0.24
+19.50	**+0.11**
+19.00	+0.45
+19.66	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.81
+20.00	-0.45
+19.50	**-0.09**
+19.00	+0.26
+19.37	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.53
+20.50	-0.19
+20.00	**+0.15**
+19.50	+0.49
+20.23	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	18/jun./1992		
Sexo	Femenino		
ID paciente	20179		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **14/ene./2026** Fecha verif. calibración: **14/ene./2026**de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

AcrySof IQ Vivity DFT0 15

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.87
+21.00	-0.52
+20.50	**-0.17**
+20.00	+0.18
+20.26	0.00

LF +1.93 DF +5.0

AcrySof IQ Vivity DFT0 15

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.75
+20.50	-0.40
+20.00	**-0.05**
+19.50	+0.29
+19.93	0.00

LF +1.93 DF +5.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+20.00	-0.76	135° 81° T N	1.50	-0.34 @ 171°
+19.50	-0.40			
+19.00	**-0.04**			
+18.50	+0.31			
---	0.00	81°	1.94	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+20.00	-0.99	135° 90° N T	1.50	-0.38 @ 0°
+19.50	-0.63			
+19.00	**-0.27**			
+18.50	+0.08			
---	0.00	90°	1.99	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+20.00	-0.76	135° 81° T N	1.50	-0.34 @ 171°
+19.50	-0.40			
+19.00	**-0.04**			
+18.50	+0.31			
---	0.00	81°	1.94	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+20.00	-0.99	135° 90° N T	1.50	-0.38 @ 0°
+19.50	-0.63			
+19.00	**-0.27**			
+18.50	+0.08			
---	0.00	90°	1.99	0.00

LF +1.62 DF +0.0

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI**
Fecha de nacimie...	18/jun./1992
Sexo	Femenino
ID paciente	20179
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **14/ene./2026** Fecha verif. calibración: **14/ene./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

!

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.83 mm**	SD 7 µm	WTW	13.4 mm	**AL**	**23.84 mm**	SD 7 µm	WTW	13.3 mm (!)
ACD	3.64 mm	SD 7 µm	Pupila	3.8 mm	ACD	3.72 mm	SD 7 µm	Pupila	5.4 mm
LT	3.78 mm	SD 11 µm	Ix / Iy	+0.4 mm / -0.1 mm	LT	3.74 mm	SD 10 µm	Ix / Iy	-0.4 mm / -0.4 mm
CCT	488 µm	SD 5 µm	Kappa	0.2 mm @ 166 °	CCT	494 µm	SD 4 µm	Kappa	0.3 mm @ 63 °


OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-1.91 D**	**@ 178°**		**Ast. K**	**-2.03 D**	**@ 4°**	
Avg. K	43.64 D		SD 0.01 D	Avg. K	43.84 D		SD 0.01 D
K1	42.71 D	@ 178°	SD 0.01 D	K1	42.85 D	@ 4°	SD 0.01 D
K2	44.62 D	@ 88°	SD 0.01 D	K2	44.88 D	@ 94°	SD 0.02 D
Ast. TK	**-1.82 D**	**@ 177°**		**Ast. TK**	**-1.96 D**	**@ 5°**	
Avg. TK	43.72 D		SD 0.06 D	Avg. TK	43.97 D		SD 0.03 D
TK1	42.83 D	@ 177°	SD 0.06 D	TK1	43.01 D	@ 5°	SD 0.05 D
TK2	44.65 D	@ 87°	SD 0.09 D	TK2	44.97 D	@ 95°	SD 0.03 D

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

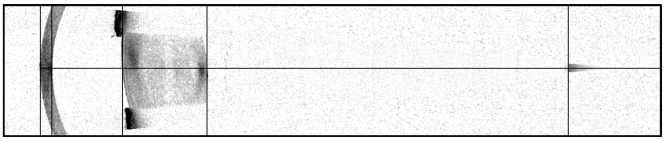


TOTAL AXIAL POWER

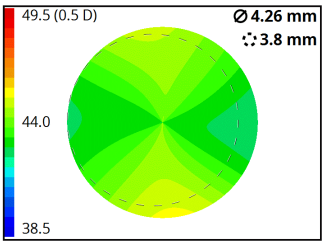


Ast. TK
-1.82 D @ 177°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

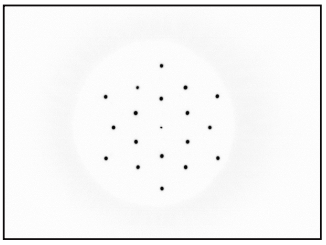


BLANCO-A-BLANCO

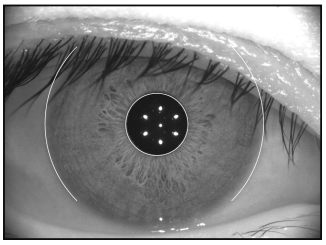

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

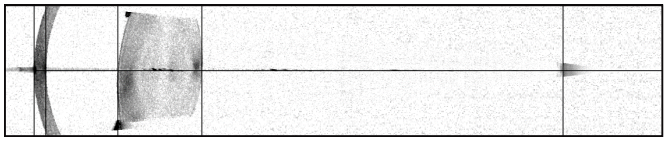


TOTAL AXIAL POWER

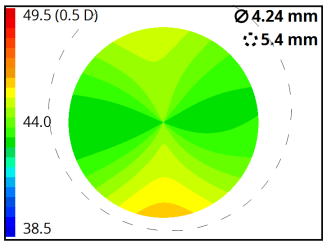


Ast. TK
-1.96 D @ 5°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

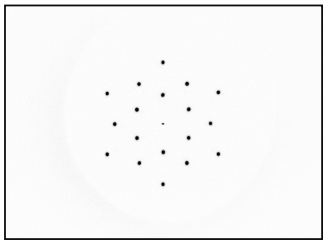

BLANCO-A-BLANCO

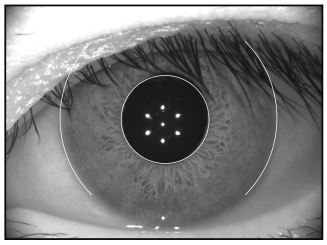

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.83 mm	SD: 7 µm	AL:	23.84 mm	SD: 7 µm
ACD:	3.64 mm	SD: 7 µm	ACD:	3.72 mm	SD: 7 µm
LT:	3.78 mm	SD: 11 µm	LT:	3.74 mm	SD: 10 µm
WTW:	13.4 mm		WTW:	13.3 mm (!)	
SE:	43.64 D	SD: 0.01 D	SE:	43.84 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-1.91 D	@178°	ΔK:	-2.03 D	@ 4°
TSE:	43.72 D	SD: 0.06 D	TSE:	43.97 D	SD: 0.03 D
ΔTK:	-1.82 D	@177°	ΔTK:	-1.96 D	@ 5°

OD			OS		
K1:	42.71 D	@178°	K1:	42.85 D	@ 4°
K2:	44.62 D	@ 88°	K2:	44.88 D	@ 94°
TK1:	42.83 D	@177°	TK1:	43.01 D	@ 5°
TK2:	44.65 D	@ 87°	TK2:	44.97 D	@ 95°

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.00	-0.67
+19.50	-0.31
+19.00	**+0.06**
+18.50	+0.42
+18.00	+0.78
+19.08	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.66
+20.50	-0.30
+20.00	**+0.05**
+19.50	+0.40
+19.00	+0.74
+20.07	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.00	-0.90
+19.50	-0.53
+19.00	**-0.17**
+18.50	+0.19
+18.00	+0.55
+18.77	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.53
+20.00	-0.18
+19.50	**+0.17**
+19.00	+0.51
+18.50	+0.85
+19.75	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.59
+20.50	-0.23
+20.00	**+0.11**
+19.50	+0.46
+19.00	+0.80
+20.17	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.76
+21.50	-0.42
+21.00	**-0.08**
+20.50	+0.26
+20.00	+0.59
+20.88	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.82
+20.50	-0.46
+20.00	**-0.11**
+19.50	+0.23
+19.00	+0.57
+19.84	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.65
+21.00	-0.30
+20.50	**+0.03**
+20.00	+0.37
+19.50	+0.69
+20.55	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.83 mm	SD: 7 µm	AL:	23.84 mm	SD: 7 µm
ACD:	3.64 mm	SD: 7 µm	ACD:	3.72 mm	SD: 7 µm
LT:	3.78 mm	SD: 11 µm	LT:	3.74 mm	SD: 10 µm
WTW:	13.4 mm		WTW:	13.3 mm (!)	
SE:	43.64 D	SD: 0.01 D	SE:	43.84 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-1.91 D	@178°	ΔK:	-2.03 D	@ 4°
TSE:	43.72 D	SD: 0.06 D	TSE:	43.97 D	SD: 0.03 D
ΔTK:	-1.82 D	@177°	ΔTK:	-1.96 D	@ 5°

OD				OS			
K1:	42.71 D	@178°		K1:	42.85 D	@	4°
K2:	44.62 D	@ 88°		K2:	44.88 D	@	94°
TK1:	42.83 D	@177°		TK1:	43.01 D	@	5°
TK2:	44.65 D	@ 87°		TK2:	44.97 D	@	95°

TK Alcon Clareon CNA0T0 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.69
+21.00	-0.34
+20.50	**+0.00**
+20.00	+0.34
+19.50	+0.68
+20.50	Emetropía

TK Bausch + Lomb enVista enhanced (MX60E) — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.94 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.86
+21.00	-0.51
+20.50	**-0.16**
+20.00	+0.19
+19.50	+0.53
+20.27	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.57
+20.50	-0.23
+20.00	**+0.12**
+19.50	+0.45
+19.00	+0.79
+20.17	Emetropía

TK Bausch + Lomb enVista enhanced (MX60E) — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.94 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.73
+20.50	-0.38
+20.00	**-0.04**
+19.50	+0.31
+19.00	+0.64
+19.95	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.72
+20.50	-0.37
+20.00	**-0.01**
+19.50	+0.33
+19.00	+0.68
+19.98	Emetropía

TK HOYA 250 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.58
+20.00	-0.22
+19.50	**+0.14**
+19.00	+0.49
+18.50	+0.83
+19.70	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.59
+20.00	-0.24
+19.50	**+0.11**
+19.00	+0.45
+18.50	+0.79
+19.66	Emetropía

TK HOYA 250 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.81
+20.00	-0.45
+19.50	**-0.09**
+19.00	+0.26
+18.50	+0.61
+19.37	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.83 mm	SD: 7 µm	AL:	23.84 mm	SD: 7 µm
ACD:	3.64 mm	SD: 7 µm	ACD:	3.72 mm	SD: 7 µm
LT:	3.78 mm	SD: 11 µm	LT:	3.74 mm	SD: 10 µm
WTW:	13.4 mm		WTW:	13.3 mm (!)	
SE:	43.64 D	SD: 0.01 D	SE:	43.84 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-1.91 D	@178°	ΔK:	-2.03 D	@ 4°
TSE:	43.72 D	SD: 0.06 D	TSE:	43.97 D	SD: 0.03 D
ΔTK:	-1.82 D	@177°	ΔTK:	-1.96 D	@ 5°

OD			OS		
K1:	42.71 D	@178°	K1:	42.85 D	@ 4°
K2:	44.62 D	@ 88°	K2:	44.88 D	@ 94°
TK1:	42.83 D	@177°	TK1:	43.01 D	@ 5°
TK2:	44.65 D	@ 87°	TK2:	44.97 D	@ 95°

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.65
+21.00	-0.30
+20.50	**+0.04**
+20.00	+0.38
+19.50	+0.71
+20.56	Emetropía

TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT015 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.87
+21.00	-0.52
+20.50	**-0.17**
+20.00	+0.18
+19.50	+0.52
+20.26	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.53
+20.50	-0.19
+20.00	**+0.15**
+19.50	+0.49
+19.00	+0.82
+20.23	Emetropía

TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT015 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.75
+20.50	-0.40
+20.00	**-0.05**
+19.50	+0.29
+19.00	+0.63
+19.93	Emetropía

TK ZEISS AT TORBI 709MP — OD

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+20.75	+1.50	81°	-0.76	-0.59	-0.34	171°
+20.25	+1.50	81°	-0.40	-0.23	-0.34	171°
+19.75	**+1.50**	**81°**	**-0.04**	**+0.13**	**-0.34**	**171°**
+19.25	+1.50	81°	+0.31	+0.48	-0.34	171°
+18.75	+1.50	81°	+0.66	+0.83	-0.35	171°
---	+1.94	81°	Emetropía			

TK ZEISS AT TORBI 709MP — OS

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+20.75	+1.50	90°	-0.99	-0.80	-0.38	0°
+20.25	+1.50	90°	-0.63	-0.44	-0.38	0°
+19.75	**+1.50**	**90°**	**-0.27**	**-0.08**	**-0.38**	**0°**
+19.25	+1.50	90°	+0.08	+0.27	-0.38	0°
+18.75	+1.50	90°	+0.43	+0.62	-0.38	0°
---	+1.99	90°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.83 mm	SD:	7 µm				
ACD:	3.64 mm	SD:	7 µm				
LT:	3.78 mm	SD:	11 µm				
WTW:	13.4 mm						
SE:	43.64 D	SD:	0.01 D	K1:	42.71 D	@	178°
ΔK:	-1.91 D	@	178°	K2:	44.62 D	@	88°
TSE:	43.72 D	SD:	0.06 D	TK1:	42.83 D	@	177°
ΔTK:	-1.82 D	@	177°	TK2:	44.65 D	@	87°

TK **ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP**

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+20.75	+1.50	81°	-0.76	-0.59	-0.34	171°
+20.25	+1.50	81°	-0.40	-0.23	-0.34	171°
+19.75	**+1.50**	**81°**	**-0.04**	**+0.13**	**-0.34**	**171°**
+19.25	+1.50	81°	+0.31	+0.48	-0.34	171°
+18.75	+1.50	81°	+0.66	+0.83	-0.35	171°
---	+1.94	81°	Emetropía			

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.84 mm	SD:	7 µm				
ACD:	3.72 mm	SD:	7 µm				
LT:	3.74 mm	SD:	10 µm				
WTW:	13.3 mm (!)						
SE:	43.84 D	SD:	0.01 D	K1:	42.85 D	@	4°
ΔK:	-2.03 D	@	4°	K2:	44.88 D	@	94°
TSE:	43.97 D	SD:	0.03 D	TK1:	43.01 D	@	5°
ΔTK:	-1.96 D	@	5°	TK2:	44.97 D	@	95°

TK **ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP**

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+20.75	+1.50	90°	-0.99	-0.80	-0.38	0°
+20.25	+1.50	90°	-0.63	-0.44	-0.38	0°
+19.75	**+1.50**	**90°**	**-0.27**	**-0.08**	**-0.38**	**0°**
+19.25	+1.50	90°	+0.08	+0.27	-0.38	0°
+18.75	+1.50	90°	+0.43	+0.62	-0.38	0°
---	+1.99	90°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.83 mm	SD:	7 µm	WTW:	13.4 mm	Ix:	+0.4 mm
CCT:	488 µm	SD:	5 µm	P:	3.8 mm	Iy:	-0.1 mm
ACD:	3.64 mm	SD:	7 µm	CW-chord:	0.2 mm @ 166°		
LT:	3.78 mm	SD:	11 µm				


SE:	43.64 D		SD: 0.01 D	TSE:	43.72 D		SD:	0.06 D
K1:	42.71 D	@ 178°	SD: 0.01 D	TK1:	42.83 D	@ 177°	SD:	0.06 D
K2:	44.62 D	@ 88°	SD: 0.01 D	TK2:	44.65 D	@ 87°	SD:	0.09 D
ΔK:	-1.91 D	@ 178°		ΔTK:	-1.82 D	@ 177°		

Scan B

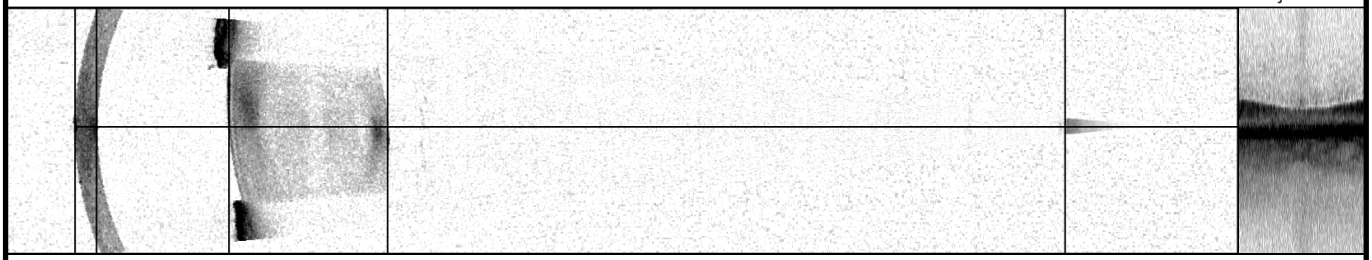


Fijación


Total Axial Power

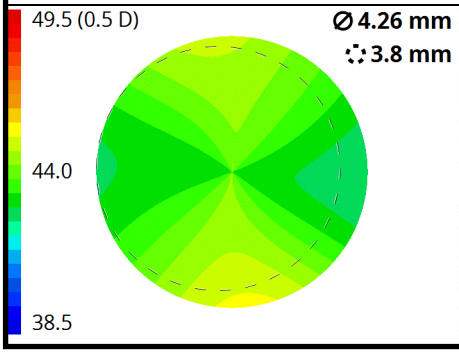

Queratometría

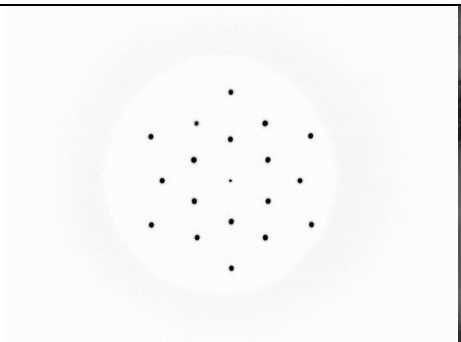

Blanco a blanco

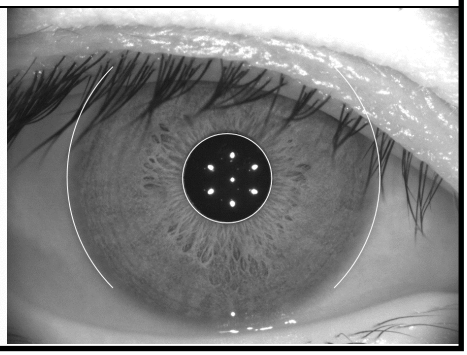

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.84 mm	SD:	7 µm	WTW:	13.3 mm (!)	Ix:	-0.4 mm
CCT:	494 µm	SD:	4 µm	P:	5.4 mm	Iy:	-0.4 mm
ACD:	3.72 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.3 mm @ 63°
LT:	3.74 mm	SD:	10 µm				

SE:	43.84 D			SD:	0.01 D	TSE:	43.97 D			SD:	0.03 D
K1:	42.85 D	@	4°	SD:	0.01 D	TK1:	43.01 D	@	5°	SD:	0.05 D
K2:	44.88 D	@	94°	SD:	0.02 D	TK2:	44.97 D	@	95°	SD:	0.03 D
ΔK:	-2.03 D	@	4°			ΔTK:	-1.96 D	@	5°		


Scan B

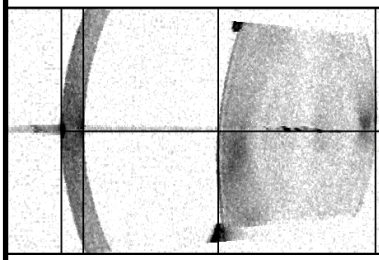


Fijación




Total Axial Power

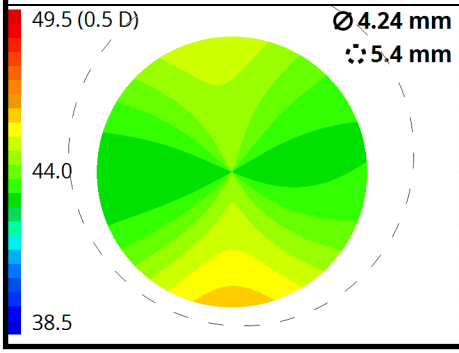

Queratometría

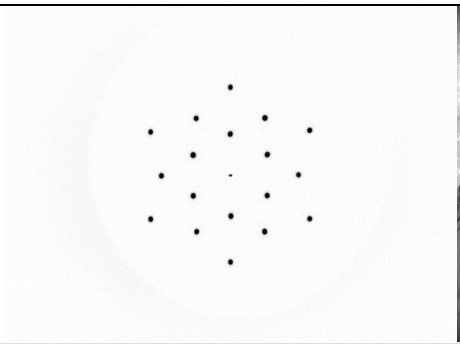

Blanco a blanco

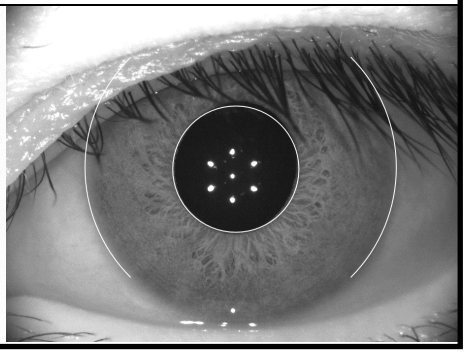

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **23.83** mm SD: 7 µm
CCT: **488** µm SD: 5 µm
ACD: **3.64** mm SD: 7 µm
LT: **3.78** mm SD: 11 µm

AL	CCT	ACD	LT
23.84 mm	489 µm	3.63 mm	3.78 mm
23.83 mm	488 µm	3.64 mm	3.79 mm
23.83 mm	486 µm	3.64 mm	3.78 mm
23.83 mm	484 µm	3.64 mm	3.78 mm
23.83 mm	487 µm	3.63 mm	3.78 mm
23.83 mm	494 µm	3.63 mm	3.78 mm

Valores de la córnea

SE: **43.64** D SD: 0.01 D
K1: **42.71** D @ **178**° SD: 0.01 D
K2: **44.62** D @ **88**° SD: 0.01 D
ΔK: **-1.91** D @ **178**°

SE: 43.64 D ΔK: -1.92 D @ 178°
SE: 43.64 D ΔK: -1.91 D @ 178°
SE: 43.65 D ΔK: -1.92 D @ 178°

TSE: **43.72** D SD: 0.06 D
TK1: **42.83** D @ **177**° SD: 0.06 D
TK2: **44.65** D @ **87**° SD: 0.09 D
ΔTK: **-1.82** D @ **177**°

TSE: 43.68 D ΔTK: -1.88 D @ 177°
TSE: 43.69 D ΔTK: -1.71 D @ 178°
TSE: 43.79 D ΔTK: -1.87 D @ 177°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 13.4 mm lx: +0.4 mm ly: -0.1 mm
P: 3.8 mm CW-chord: 0.2 mm @ 166°

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **23.84** mm SD: 7 µm
CCT: **494** µm SD: 4 µm
ACD: **3.72** mm SD: 7 µm
LT: **3.74** mm SD: 10 µm

AL	CCT	ACD	LT
23.84 mm	493 µm	3.71 mm	3.75 mm
23.85 mm	493 µm	3.71 mm	3.74 mm
23.85 mm	493 µm	3.72 mm	3.74 mm
23.85 mm	494 µm	3.72 mm	3.74 mm
23.85 mm	499 µm	3.72 mm	3.74 mm
23.85 mm	490 µm	3.71 mm	3.74 mm

Valores de la córnea

SE: **43.84** D SD: 0.01 D
K1: **42.85** D @ **4**° SD: 0.01 D
K2: **44.88** D @ **94**° SD: 0.02 D
ΔK: **-2.03** D @ **4**°

SE: 43.84 D ΔK: -2.05 D @ 4°
SE: 43.84 D ΔK: -2.01 D @ 4°
SE: 43.85 D ΔK: -2.05 D @ 4°

TSE: **43.97** D SD: 0.03 D
TK1: **43.01** D @ **5**° SD: 0.05 D
TK2: **44.97** D @ **95**° SD: 0.03 D
ΔTK: **-1.96** D @ **5**°

TSE: 43.94 D ΔTK: -1.95 D @ 5°
TSE: 43.96 D ΔTK: -2.02 D @ 4°
TSE: 44.00 D ΔTK: -1.92 D @ 6°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 13.3 mm (!) lx: -0.4 mm ly: -0.4 mm
P: 5.4 mm CW-chord: 0.3 mm @ 63°

Reference Image — Se ha guardado la imagen

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	POOT CAAMAL, LETICIA NOEMI		
Fecha de nacim.	18/jun./1992	Sexo	Femenino
ID del paciente	20179		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image


OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.84 mm			SE:	43.84 D		TSE:	43.97 D	
ACD:	3.72 mm			K1:	42.85 D @ 4°		TK1:	43.01 D @ 5°
LT:	3.74 mm			K2:	44.88 D @ 94°		TK2:	44.97 D @ 95°
WTW:	13.3 mm	(!)	Ix: -0.4 mm Iy: -0.4 mm	ΔK:	-2.03 D @ 4°		ΔTK:	-1.96 D @ 5°
P:	5.4 mm		CW-chord: 0.3 mm @ 63°					

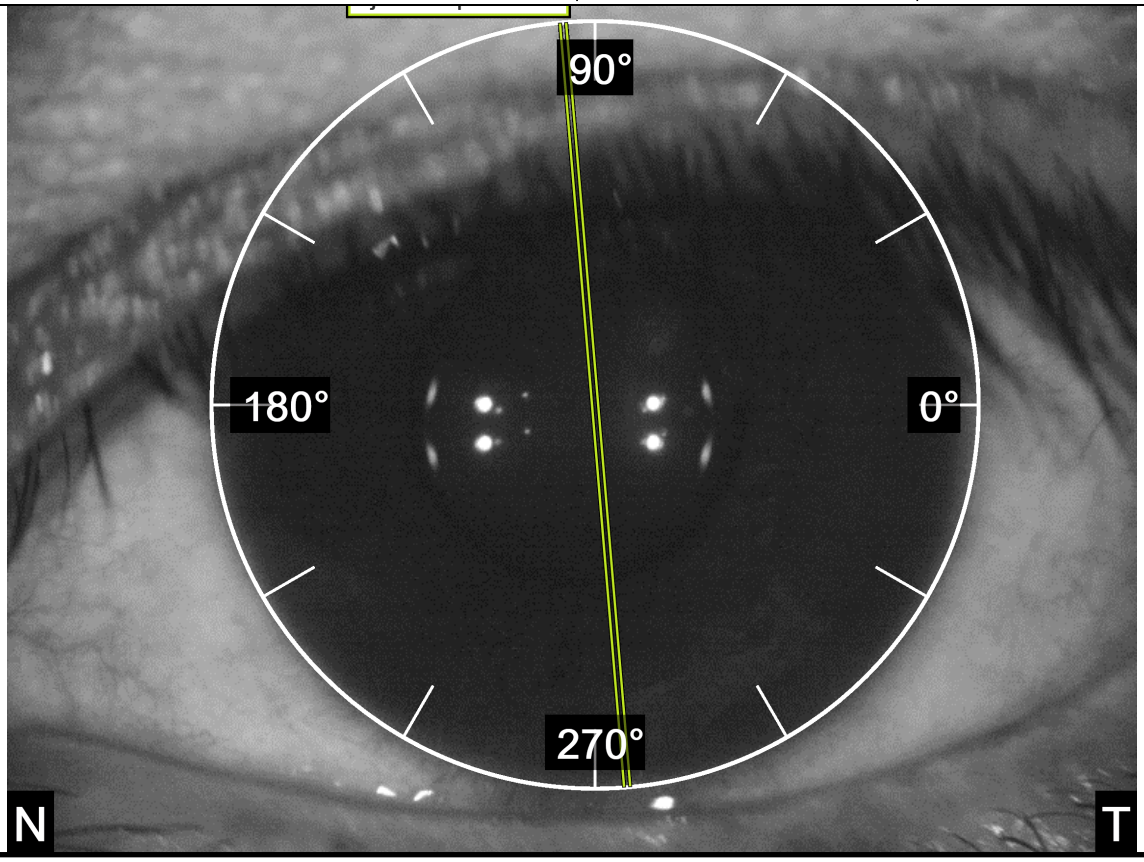

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.USG MODO AB.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved