CÁLCULO DE IOL

Paciente	**REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN**
Fecha de nacimie...	19/may./1969
Sexo	Masculino
ID paciente	20288
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **05/feb./2026** Fecha verif. calibración: **05/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD				OS	
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD				OS			
AL	**25.67 mm**	WTW	12.2 mm	**AL**	**25.41 mm**	WTW	12.6 mm
ACD	3.74 mm	Pupila	2.9 mm	ACD	3.80 mm	Pupila	3.4 mm
LT	3.80 mm	Ix / Iy	+0.6 mm /+0.1 mm	LT	3.75 mm	Ix / Iy	-0.3 mm /+0.0 mm
CCT	520 µm	Kappa	0.4 mm @ 240°	CCT	525 µm	Kappa	0.3 mm @ 292°
Ast. K	**-0.28 D @ 25°**	**Ast. TK**	**-0.30 D @ 58°**	**Ast. K**	**-0.80 D @ 169°**	**Ast. TK**	**-0.77 D @ 169°**
Avg. K	42.39 D	Avg. TK	42.52 D	Avg. K	42.30 D	Avg. TK	42.43 D
K1	42.25 D @ 25°	TK1	42.37 D @ 58°	K1	41.90 D @ 169°	TK1	42.05 D @ 169°
K2	42.53 D @ 115°	TK2	42.67 D @ 148°	K2	42.70 D @ 79°	TK2	42.82 D @ 79°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+16.00	-0.74
+15.50	-0.38
+15.00	**-0.02**
+14.50	+0.34
+14.98	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.54
+16.00	-0.20
+15.50	**+0.15**
+15.00	+0.49
+15.72	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.85
+16.50	-0.50
+16.00	**-0.15**
+15.50	+0.19
+15.78	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.84
+16.50	-0.47
+16.00	**-0.11**
+15.50	+0.25
+15.85	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.60
+17.00	-0.25
+16.50	**+0.09**
+16.00	+0.44
+16.64	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.55
+17.00	-0.20
+16.50	**+0.14**
+16.00	+0.48
+16.71	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.80
+17.00	-0.46
+16.50	**-0.12**
+16.00	+0.21
+16.32	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.66
+16.50	-0.32
+16.00	**+0.02**
+15.50	+0.36
+16.03	0.00

LF +2.06 DF +5.0

Akreos Adapt

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.81
+16.00	-0.45
+15.50	**-0.09**
+15.00	+0.25
+15.37	0.00

LF +1.57 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+18.50	-0.83
+18.00	-0.49
+17.50	**-0.15**
+17.00	+0.19
+17.28	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+18.00	-0.70
+17.50	-0.36
+17.00	**-0.02**
+16.50	+0.32
+16.98	0.00

LF +2.06 DF +5.0

Akreos Adapt

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.88
+17.00	-0.52
+16.50	**-0.17**
+16.00	+0.19
+16.27	0.00

LF +1.57 DF +5.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.59
+16.00	-0.24
+15.50	**+0.10**
+15.00	+0.44
+15.65	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.76
+16.00	-0.40
+15.50	**-0.05**
+15.00	+0.30
+15.43	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.63
+16.50	-0.29
+16.00	**+0.05**
+15.50	+0.38
+16.08	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.66
+17.00	-0.30
+16.50	**+0.04**
+16.00	+0.39
+16.57	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.83
+17.00	-0.47
+16.50	**-0.12**
+16.00	+0.23
+16.34	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+18.00	-0.67
+17.50	-0.33
+17.00	**+0.01**
+16.50	+0.35
+17.02	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	19/may./1969		
Sexo	Masculino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20288		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **05/feb./2026** Fecha verif. calibración: **05/feb./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — CÁLCULO DE IOL — izquierdo OS

AcrySof IQ Vivity DFT0
15

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.79
+16.50	-0.45
+16.00	**-0.10**
+15.50	+0.24
+15.85	0.00

LF +1.93 DF +5.0

AcrySof IQ Vivity DFT0
15

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+18.00	-0.85
+17.50	-0.50
+17.00	**-0.15**
+16.50	+0.19
+16.78	0.00

LF +1.93 DF +5.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
n/a		135°		
n/a		---	n/a	
n/a		T N		
n/a				
---	0.00	3°	0.61	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
n/a		135°		
n/a		---	n/a	
n/a		N T		
n/a				
---	0.00	62°	0.88	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
n/a		135°		
n/a		---	n/a	
n/a		T N		
n/a				
---	0.00	3°	0.61	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
n/a		135°		
n/a		---	n/a	
n/a		N T		
n/a				
---	0.00	62°	0.88	0.00

LF +1.62 DF +0.0

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN**	**Clinica MEDYTEC**	
Fecha de nacimie...	19/may./1969		
Sexo	Masculino		
ID paciente	20288	**Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida**	
Médico	Surgeon	**999 926 8619**	
		info@clinicamedytec.com	

Fecha de la medición **05/feb./2026** Fecha verif. calibración: **05/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS


OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente


OD derecho					OS izquierdo				
AL	**25.67 mm**	SD 7 µm	WTW	12.2 mm	**AL**	**25.41 mm**	SD 8 µm	WTW	12.6 mm
ACD	3.74 mm	SD 7 µm	Pupila	2.9 mm	ACD	3.80 mm	SD 7 µm	Pupila	3.4 mm
LT	3.80 mm	SD 10 µm	Ix / Iy	+0.6 mm / +0.1 mm	LT	3.75 mm	SD 9 µm	Ix / Iy	-0.3 mm / +0.0 mm
CCT	520 µm	SD 4 µm	Kappa	0.4 mm @ 240 °	CCT	525 µm	SD 3 µm	Kappa	0.3 mm @ 292 °
Ast. K	**-0.28 D @ 25°**				**Ast. K**	**-0.80 D @ 169°**			
Avg. K	42.39 D	SD 0.01 D			Avg. K	42.30 D	SD 0.01 D		
K1	42.25 D @ 25°	SD 0.02 D			K1	41.90 D @ 169°	SD 0.02 D		
K2	42.53 D @ 115°	SD 0.01 D			K2	42.70 D @ 79°	SD 0.02 D		
Ast. TK	**-0.30 D @ 58°**				**Ast. TK**	**-0.77 D @ 169°**			
Avg. TK	42.52 D	SD 0.04 D			Avg. TK	42.43 D	SD 0.03 D		
TK1	42.37 D @ 58°	SD 0.03 D			TK1	42.05 D @ 169°	SD 0.09 D		
TK2	42.67 D @ 148°	SD 0.08 D			TK2	42.82 D @ 79°	SD 0.04 D		

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

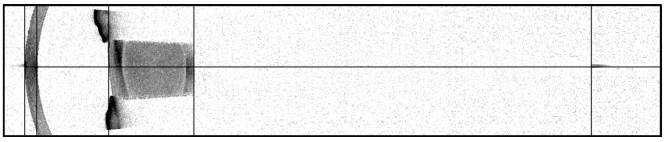


TOTAL AXIAL POWER

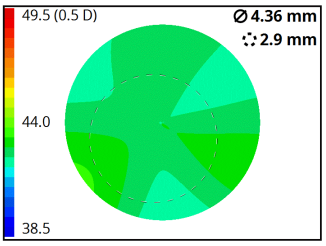


Ast. TK
-0.30 D @ 58°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

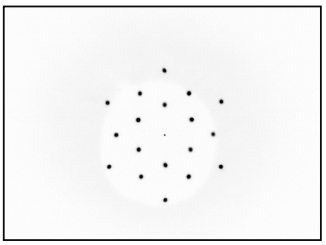


BLANCO-A-BLANCO

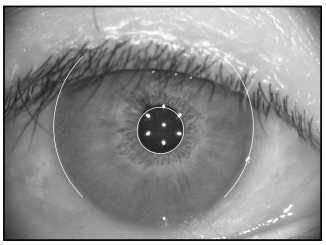

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

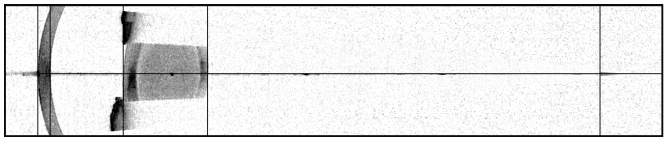


TOTAL AXIAL POWER

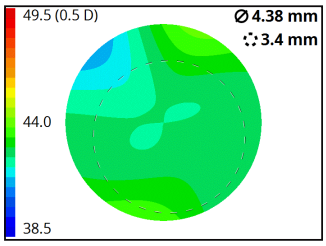


Ast. TK
-0.77 D @ 169°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

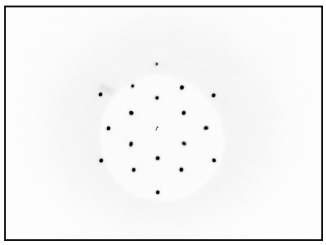

BLANCO-A-BLANCO

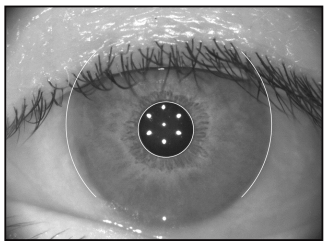

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 25.67 mm SD: 7 µm	AL: 25.41 mm SD: 8 µm
ACD: 3.74 mm SD: 7 µm	ACD: 3.80 mm SD: 7 µm
LT: 3.80 mm SD: 10 µm	LT: 3.75 mm SD: 9 µm
WTW: 12.2 mm	WTW: 12.6 mm
SE: 42.39 D SD: 0.01 D	SE: 42.30 D SD: 0.01 D
K1: 42.25 D @ 25°	K1: 41.90 D @169°
ΔK: -0.28 D @ 25°	ΔK: -0.80 D @169°
K2: 42.53 D @115°	K2: 42.70 D @ 79°
TSE: 42.52 D SD: 0.04 D	TSE: 42.43 D SD: 0.03 D
TK1: 42.37 D @ 58°	TK1: 42.05 D @169°
ΔTK: -0.30 D @ 58°	ΔTK: -0.77 D @169°
TK2: 42.67 D @148°	TK2: 42.82 D @ 79°

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+16.00	-0.74
+15.50	-0.38
+15.00	**-0.02**
+14.50	+0.34
+14.00	+0.69
+14.98	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.54
+16.00	-0.20
+15.50	**+0.15**
+15.00	+0.49
+14.50	+0.82
+15.72	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.84
+16.50	-0.47
+16.00	**-0.11**
+15.50	+0.25
+15.00	+0.61
+15.85	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.60
+17.00	-0.25
+16.50	**+0.09**
+16.00	+0.44
+15.50	+0.77
+16.64	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.85
+16.50	-0.50
+16.00	**-0.15**
+15.50	+0.19
+15.00	+0.53
+15.78	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.80
+17.00	-0.46
+16.50	**-0.12**
+16.00	+0.21
+15.50	+0.54
+16.32	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.55
+17.00	-0.20
+16.50	**+0.14**
+16.00	+0.48
+15.50	+0.82
+16.71	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+18.50	-0.83
+18.00	-0.49
+17.50	**-0.15**
+17.00	+0.19
+16.50	+0.52
+17.28	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	25.67 mm	SD:	7 µm				
ACD:	3.74 mm	SD:	7 µm				
LT:	3.80 mm	SD:	10 µm				
WTW:	12.2 mm						
SE:	42.39 D	SD:	0.01 D	K1:	42.25 D	@	25°
ΔK:	-0.28 D	@	25°	K2:	42.53 D	@	115°
TSE:	42.52 D	SD:	0.04 D	TK1:	42.37 D	@	58°
ΔTK:	-0.30 D	@	58°	TK2:	42.67 D	@	148°

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.66
+16.50	-0.32
+16.00	**+0.02**
+15.50	+0.36
+15.00	+0.69
+16.03	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.57 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.81
+16.00	-0.45
+15.50	**-0.09**
+15.00	+0.25
+14.50	+0.60
+15.37	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.59
+16.00	-0.24
+15.50	**+0.10**
+15.00	+0.44
+14.50	+0.78
+15.65	Emetropía

TK HOYA 250

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.76
+16.00	-0.40
+15.50	**-0.05**
+15.00	+0.30
+14.50	+0.64
+15.43	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	25.41 mm	SD:	8 µm				
ACD:	3.80 mm	SD:	7 µm				
LT:	3.75 mm	SD:	9 µm				
WTW:	12.6 mm						
SE:	42.30 D	SD:	0.01 D	K1:	41.90 D	@	169°
ΔK:	-0.80 D	@	169°	K2:	42.70 D	@	79°
TSE:	42.43 D	SD:	0.03 D	TK1:	42.05 D	@	169°
ΔTK:	-0.77 D	@	169°	TK2:	42.82 D	@	79°

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.70
+17.50	-0.36
+17.00	**-0.02**
+16.50	+0.32
+16.00	+0.65
+16.98	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.57 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.88
+17.00	-0.52
+16.50	**-0.17**
+16.00	+0.19
+15.50	+0.53
+16.27	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.66
+17.00	-0.30
+16.50	**+0.04**
+16.00	+0.39
+15.50	+0.73
+16.57	Emetropía

TK HOYA 250

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.83
+17.00	-0.47
+16.50	**-0.12**
+16.00	+0.23
+15.50	+0.58
+16.34	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD				OS			
AL:	25.67 mm	SD:	7 µm	AL:	25.41 mm	SD:	8 µm
ACD:	3.74 mm	SD:	7 µm	ACD:	3.80 mm	SD:	7 µm
LT:	3.80 mm	SD:	10 µm	LT:	3.75 mm	SD:	9 µm
WTW:	12.2 mm			WTW:	12.6 mm		
SE:	42.39 D	SD:	0.01 D	SE:	42.30 D	SD:	0.01 D
ΔK:	-0.28 D @ 25°			ΔK:	-0.80 D @169°		
TSE:	42.52 D	SD:	0.04 D	TSE:	42.43 D	SD:	0.03 D
ΔTK:	-0.30 D @ 58°			ΔTK:	-0.77 D @169°		

OD				OS			
K1:	42.25 D	@	25°	K1:	41.90 D	@	169°
K2:	42.53 D	@	115°	K2:	42.70 D	@	79°
TK1:	42.37 D	@	58°	TK1:	42.05 D	@	169°
TK2:	42.67 D	@	148°	TK2:	42.82 D	@	79°

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.63
+16.50	-0.29
+16.00	**+0.05**
+15.50	+0.38
+15.00	+0.71
+16.08	Emetropía

TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT015 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.79
+16.50	-0.45
+16.00	**-0.10**
+15.50	+0.24
+15.00	+0.57
+15.85	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.67
+17.50	-0.33
+17.00	**+0.01**
+16.50	+0.35
+16.00	+0.68
+17.02	Emetropía

TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT015 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.85
+17.50	-0.50
+17.00	**-0.15**
+16.50	+0.19
+16.00	+0.53
+16.78	Emetropía

TK ZEISS AT TORBI 709MP — OD

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	+0.61	3°	Emetropía			

TK ZEISS AT TORBI 709MP — OS

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	+0.88	62°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 25.67 mm SD: 7 µm	AL: 25.41 mm SD: 8 µm
ACD: 3.74 mm SD: 7 µm	ACD: 3.80 mm SD: 7 µm
LT: 3.80 mm SD: 10 µm	LT: 3.75 mm SD: 9 µm
WTW: 12.2 mm	WTW: 12.6 mm
SE: 42.39 D SD: 0.01 D K1: 42.25 D @ 25°	SE: 42.30 D SD: 0.01 D K1: 41.90 D @169°
ΔK: -0.28 D @ 25° K2: 42.53 D @115°	ΔK: -0.80 D @169° K2: 42.70 D @ 79°
TSE: 42.52 D SD: 0.04 D TK1: 42.37 D @ 58°	TSE: 42.43 D SD: 0.03 D TK1: 42.05 D @169°
ΔTK: -0.30 D @ 58° TK2: 42.67 D @148°	ΔTK: -0.77 D @169° TK2: 42.82 D @ 79°

TK ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	+0.61	3°	Emetropía			

TK ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	+0.88	62°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.67 mm	SD:	7 µm	WTW:	12.2 mm	Ix:	+0.6 mm
CCT:	520 µm	SD:	4 µm	P:	2.9 mm	Iy:	+0.1 mm
ACD:	3.74 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 240°
LT:	3.80 mm	SD:	10 µm				


SE:	42.39 D		SD: 0.01 D	TSE:	42.52 D		SD:	0.04 D
K1:	42.25 D	@ 25°	SD: 0.02 D	TK1:	42.37 D	@ 58°	SD:	0.03 D
K2:	42.53 D	@ 115°	SD: 0.01 D	TK2:	42.67 D	@ 148°	SD:	0.08 D
ΔK:	-0.28 D	@ 25°		ΔTK:	-0.30 D	@ 58°		

Scan B

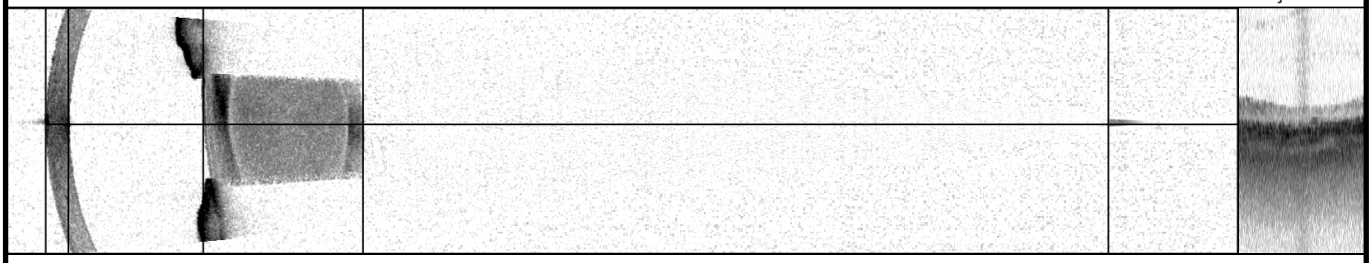


Fijación


Total Axial Power

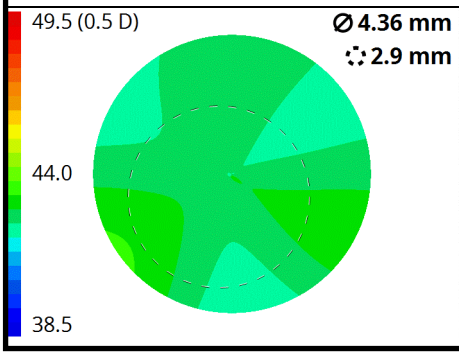

Queratometría

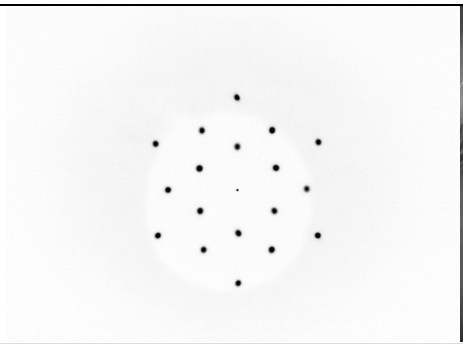

Blanco a blanco

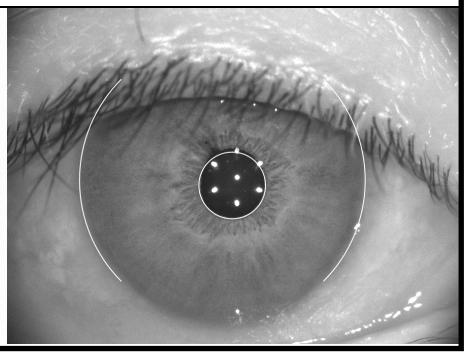

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.41 mm	SD:	8 µm	WTW:	12.6 mm	Ix:	-0.3 mm
CCT:	525 µm	SD:	3 µm	P:	3.4 mm	Iy:	+0.0 mm
ACD:	3.80 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.3 mm @ 292°
LT:	3.75 mm	SD:	9 µm				


SE:	42.30 D		SD:	0.01 D	TSE:	42.43 D		SD: 0.03 D
K1:	41.90 D	@ 169°	SD:	0.02 D	TK1:	42.05 D	@ 169°	SD: 0.09 D
K2:	42.70 D	@ 79°	SD:	0.02 D	TK2:	42.82 D	@ 79°	SD: 0.04 D
ΔK:	-0.80 D	@ 169°			ΔTK:	-0.77 D	@ 169°	

Scan B

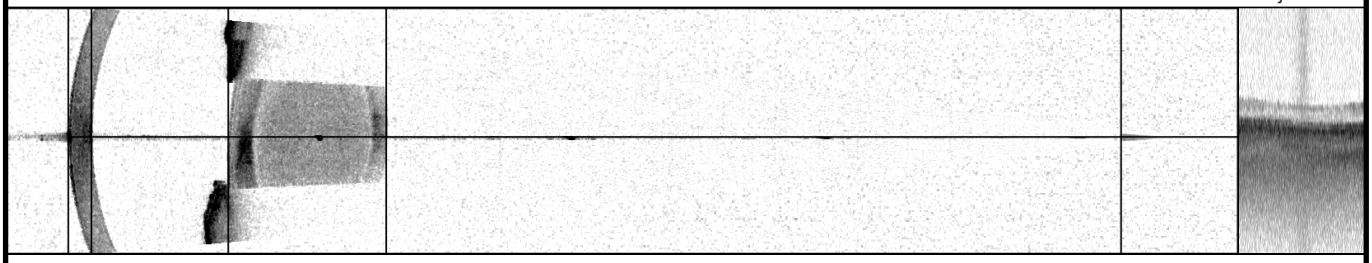


Fijación


Total Axial Power

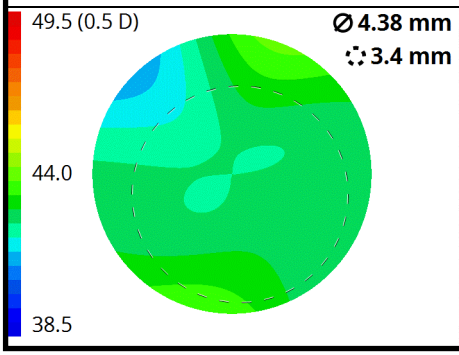

Queratometría

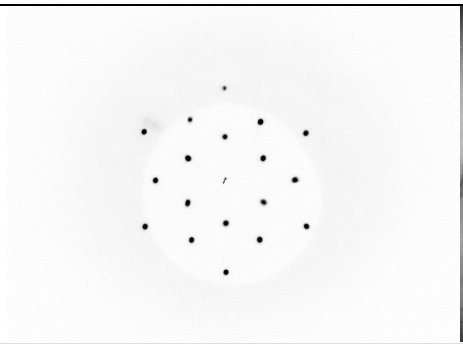

Blanco a blanco

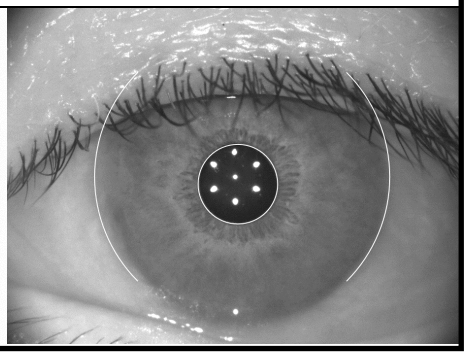

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica VS: Humor vítreo	LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **25.67** mm SD: 7 µm	AL: **25.41** mm SD: 8 µm
CCT: **520** µm SD: 4 µm	CCT: **525** µm SD: 3 µm
ACD: **3.74** mm SD: 7 µm	ACD: **3.80** mm SD: 7 µm
LT: **3.80** mm SD: 10 µm	LT: **3.75** mm SD: 9 µm

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
25.66 mm	518 µm	3.73 mm	3.80 mm	25.42 mm	526 µm	3.79 mm	3.76 mm
25.67 mm	522 µm	3.74 mm	3.79 mm	25.42 mm	524 µm	3.79 mm	3.76 mm
25.67 mm	518 µm	3.74 mm	3.80 mm	25.41 mm	523 µm	3.79 mm	3.76 mm
25.67 mm	517 µm	3.74 mm	3.80 mm	25.41 mm	525 µm	3.81 mm	3.75 mm
25.67 mm	522 µm	3.74 mm	3.80 mm	25.41 mm	524 µm	3.80 mm	3.75 mm
25.67 mm	524 µm	3.73 mm	3.80 mm	25.41 mm	529 µm	3.79 mm	3.75 mm

Valores de la córnea	
SE: **42.39** D SD: 0.01 D	SE: **42.30** D SD: 0.01 D
K1: **42.25** D @ **25°** SD: 0.02 D	K1: **41.90** D @ **169°** SD: 0.02 D
K2: **42.53** D @ **115°** SD: 0.01 D	K2: **42.70** D @ **79°** SD: 0.02 D
ΔK: **-0.28** D @ **25°**	ΔK: **-0.80** D @ **169°**
SE: 42.38 D ΔK: -0.29 D @ 24°	SE: 42.30 D ΔK: -0.89 D @ 164°
SE: 42.39 D ΔK: -0.27 D @ 25°	SE: 42.30 D ΔK: -0.81 D @ 169°
SE: 42.40 D ΔK: -0.27 D @ 27°	SE: 42.30 D ΔK: -0.77 D @ 170°
TSE: **42.52** D SD: 0.04 D	TSE: **42.43** D SD: 0.03 D
TK1: **42.37** D @ **58°** SD: 0.03 D	TK1: **42.05** D @ **169°** SD: 0.09 D
TK2: **42.67** D @ **148°** SD: 0.08 D	TK2: **42.82** D @ **79°** SD: 0.04 D
ΔTK: **-0.30** D @ **58°**	ΔTK: **-0.77** D @ **169°**
TSE: 42.57 D ΔTK: -0.40 D @ 53°	TSE: 42.39 D ΔTK: -0.90 D @ 165°
TSE: 42.49 D ΔTK: -0.36 D @ 49°	TSE: 42.45 D ΔTK: -0.67 D @ 169°
TSE: 42.49 D ΔTK: -0.25 D @ 79°	TSE: 42.46 D ΔTK: -0.79 D @ 170°
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 12.2 mm Ix: +0.6 mm Iy: +0.1 mm	WTW: 12.6 mm Ix: -0.3 mm Iy: +0.0 mm
P: 2.9 mm CW-chord: 0.4 mm @ 240°	P: 3.4 mm CW-chord: 0.3 mm @ 292°
Se ha guardado la imagen	Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho


Reference Image

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.67 mm			SE:	42.39 D		TSE:	42.52 D	
ACD:	3.74 mm			K1:	42.25 D	@ 25°	TK1:	42.37 D	@ 58°
LT:	3.80 mm			K2:	42.53 D	@ 115°	TK2:	42.67 D	@ 148°
WTW:	12.2 mm	Ix:	+0.6 mm	ΔK:	-0.28 D	@ 25°	ΔTK:	-0.30 D	@ 58°
P:	2.9 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 240°						

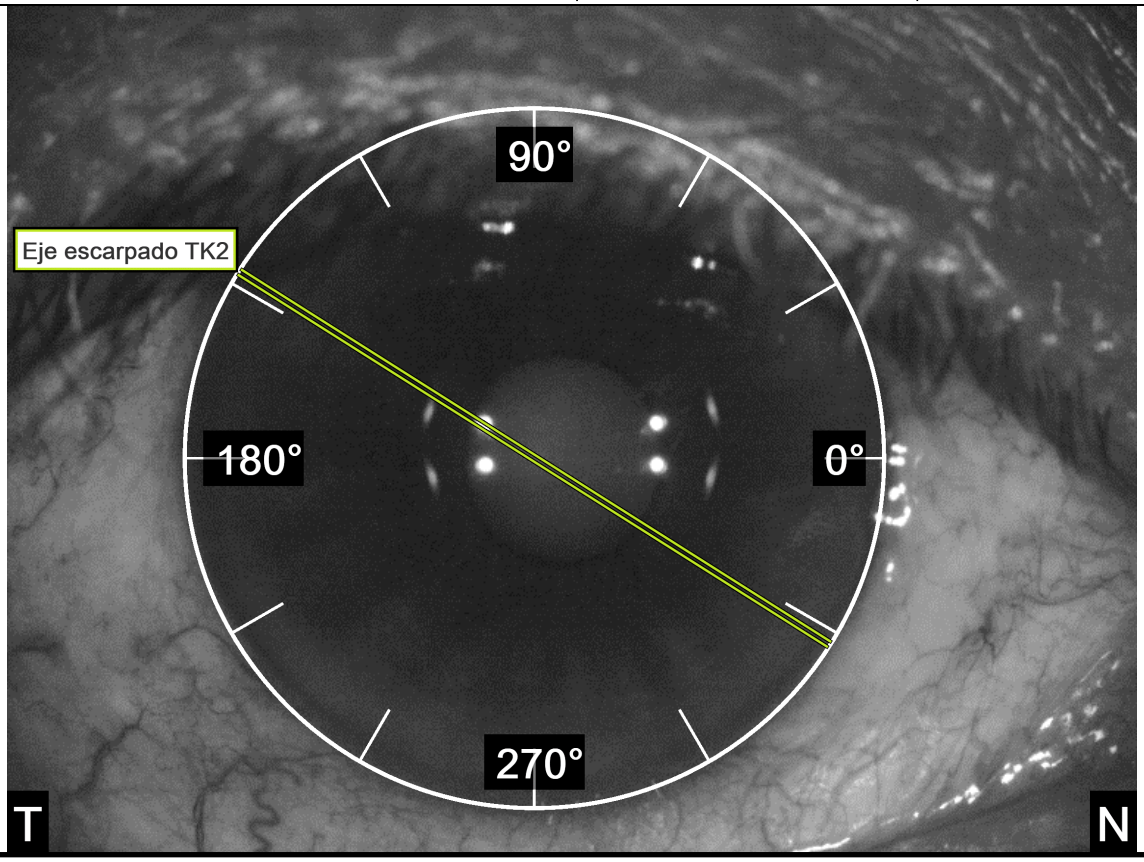

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.41 mm			SE:	42.30 D		
ACD:	3.80 mm			K1:	41.90 D	@	169°
LT:	3.75 mm			K2:	42.70 D	@	79°
WTW:	12.6 mm	Ix:	-0.3 mm	ΔK:	-0.80 D	@	169°
P:	3.4 mm	Iy:	+0.0 mm				
		CW-chord:	0.3 mm @ 292°				

TSE:	42.43 D				
TK1:	42.05 D	@	169°		
TK2:	42.82 D	@	79°		
ΔTK:	-0.77 D	@	169°		

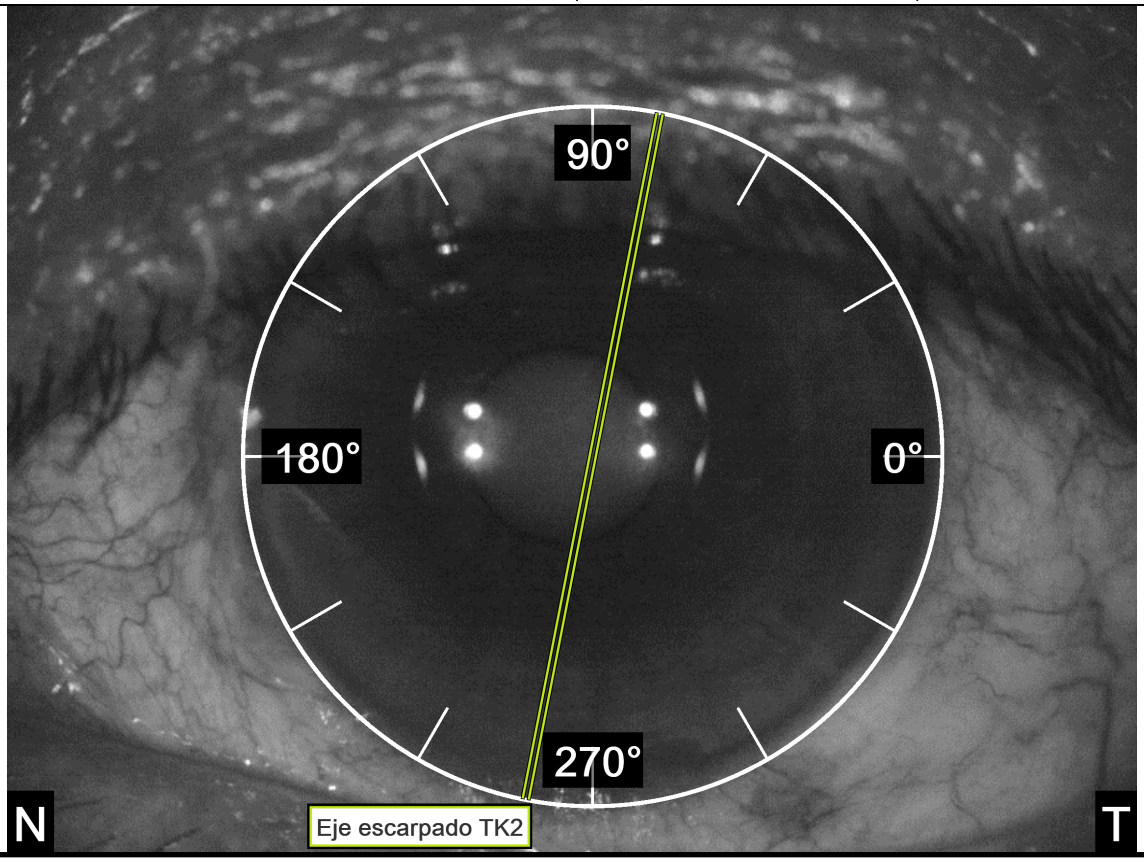

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved