CÁLCULO DE IOL

Paciente	**AVILA CHAN, MARIANA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	03/mar./1955		
Sexo	Femenino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20788		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **06/jun./2026**	Fecha verif. calibración: **06/jun./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho					OS izquierdo				
LS	Fáquica		LVC	No tratado	LS	Fáquica		LVC	No tratado
VS	Humor vítreo		Modo LVC	-	VS	Humor vítreo		Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**		SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**		SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**22.97 mm**	**(*)**	WTW	11.6 mm		**AL**	**22.51 mm**		WTW	11.7 mm	
ACD	2.88 mm		Pupila	2.7 mm		ACD	2.85 mm		Pupila	2.6 mm	
LT	4.42 mm	(!)	Ix / Iy	+0.5 mm	/+0.2 mm	LT	4.36 mm	(!)	Ix / Iy	-0.5 mm	/+0.2 mm
CCT	554 µm		Kappa	0.5 mm	@ 203°	CCT	551 µm		Kappa	0.4 mm	@ 335°
Ast. K	**-0.77 D**	**@ 88°**	**Ast. TK**	**-1.17 D**	**@ 88°**	**Ast. K**	**-0.58 D**	**@ 31°**	**Ast. TK**	**---**	
Avg. K	44.25 D		Avg. TK	44.14 D	(!)	Avg. K	44.28 D		Avg. TK	---	
K1	43.87 D	@ 88°	TK1	43.56 D	@ 88°	K1	43.99 D	@ 31°	TK1	---	
K2	44.63 D	@ 178°	TK2	44.73 D	@ 178°	K2	44.57 D	@ 121°	TK2	---	

CÁLCULO DE IOL

⟅ ⟆ Rotación del eje

OD derecho

DCB00

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.82
+23.00	-0.46
+22.50	**-0.11**
+22.00	+0.24
+22.35	0.00

a0 +1.508 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+23.00	-0.85
+22.50	-0.48
+22.00	**-0.12**
+21.50	+0.24
+21.84	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+22.00	-0.73
+21.50	-0.35
+21.00	**+0.02**
+20.50	+0.39
+21.03	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.54
+23.50	-0.20
+23.00	**+0.14**
+22.50	+0.48
+23.21	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+23.00	-0.55
+22.50	-0.19
+22.00	**+0.16**
+21.50	+0.51
+22.23	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

Clareon CNA0T0

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.67
+23.00	-0.32
+22.50	**+0.03**
+22.00	+0.38
+22.55	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

CT LUCIA 221P

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.65
+23.50	-0.30
+23.00	**+0.04**
+22.50	+0.38
+23.06	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

Akreos Adapt

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+22.00	-0.56
+21.50	-0.19
+21.00	**+0.17**
+20.50	+0.54
+21.24	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+23.50	-0.69
+23.00	-0.33
+22.50	**+0.02**
+22.00	+0.37
+22.53	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

OS izquierdo

DCB00

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+25.00	-0.63
+24.50	-0.27
+24.00	**+0.08**
+23.50	+0.43
+24.12	0.00

a0 +1.508 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+24.50	-0.80
+24.00	-0.43
+23.50	**-0.06**
+23.00	+0.30
+23.41	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.92
+23.50	-0.54
+23.00	**-0.17**
+22.50	+0.20
+22.77	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+26.00	-0.73
+25.50	-0.38
+25.00	**-0.03**
+24.50	+0.31
+24.95	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+25.00	-0.73
+24.50	-0.37
+24.00	**-0.01**
+23.50	+0.34
+23.99	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

Clareon CNA0T0

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+25.00	-0.55
+24.50	-0.19
+24.00	**+0.16**
+23.50	+0.51
+24.23	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

CT LUCIA 221P

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+26.00	-0.77
+25.50	-0.42
+25.00	**-0.07**
+24.50	+0.27
+24.90	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

Akreos Adapt

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+24.00	-0.82
+23.50	-0.44
+23.00	**-0.07**
+22.50	+0.30
+22.90	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis	K
IOL	**Res. SE**
+25.00	-0.54
+24.50	-0.18
+24.00	**+0.17**
+23.50	+0.52
+24.24	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**AVILA CHAN, MARIANA**
Fecha de nacimie...	03/mar./1955
Sexo	Femenino
ID paciente	20788
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **06/jun./2026** Fecha verif. calibración: **06/jun./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Micro F

Haigis K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.69
+22.50	-0.33
+22.00	**+0.03**
+21.50	+0.38
+22.04	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.83
+22.50	-0.47
+22.00	**-0.10**
+21.50	+0.25
+21.85	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis K

IOL	Res. SE
+24.00	-0.87
+23.50	-0.52
+23.00	**-0.17**
+22.50	+0.18
+22.76	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Micro F

Haigis K

IOL	Res. SE
+25.00	-0.88
+24.50	-0.52
+24.00	**-0.16**
+23.50	+0.20
+23.78	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis K

IOL	Res. SE
+24.50	-0.73
+24.00	-0.36
+23.50	**+0.00**
+23.00	+0.36
+23.51	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis K

IOL	Res. SE
+25.50	-0.66
+25.00	-0.30
+24.50	**+0.05**
+24.00	+0.39
+24.57	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**AVILA CHAN, MARIANA**
Fecha de nacimie...	03/mar./1955
Sexo	Femenino
ID paciente	20788
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **06/jun./2026** Fecha verif. calibración: **06/jun./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

!

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	---		WTW	11.6 mm	**AL**	**22.51 mm**	SD 13 µm	WTW	11.7 mm
ACD	2.88 mm	SD 7 µm	Pupila	2.7 mm	ACD	2.85 mm	SD 6 µm	Pupila	2.6 mm
LT	4.42 mm (!)	SD 53 µm	Ix / Iy	+0.5 mm / +0.2 mm	LT	4.36 mm (!)	SD 47 µm	Ix / Iy	-0.5 mm / +0.2 mm
CCT	554 µm	SD 3 µm	Kappa	0.5 mm @ 203 °	CCT	551 µm	SD 4 µm	Kappa	0.4 mm @ 335 °


OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-0.77 D @ 88°**			**Ast. K**	**-0.58 D @ 31°**		
Avg. K	44.25 D		SD 0.01 D	Avg. K	44.28 D		SD 0.02 D
K1	43.87 D @ 88°		SD 0.01 D	K1	43.99 D @ 31°		SD 0.02 D
K2	44.63 D @ 178°		SD 0.02 D	K2	44.57 D @ 121°		SD 0.03 D
Ast. TK	**-1.17 D @ 88°**			**Ast. TK**	**---**		
Avg. TK	44.14 D	(!)	SD 0.04 D	Avg. TK	---		
TK1	43.56 D @ 88°		SD 0.02 D	TK1	---		
TK2	44.73 D @ 178°		SD 0.10 D	TK2	---		

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

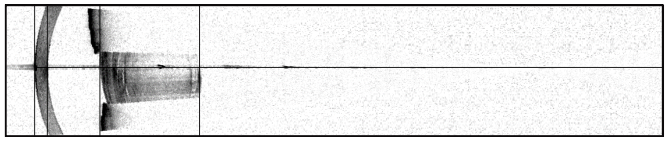


TOTAL AXIAL POWER (!)

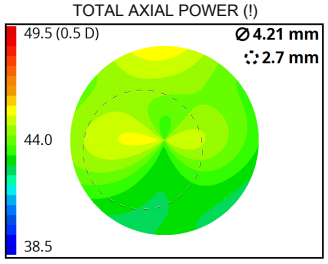


Ast. TK
-1.17 D @ 88°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

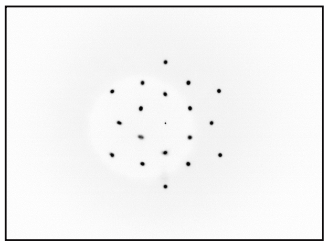


BLANCO-A-BLANCO

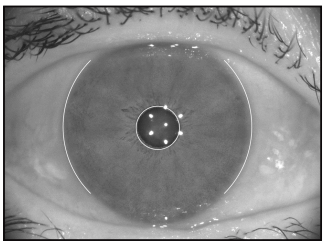

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

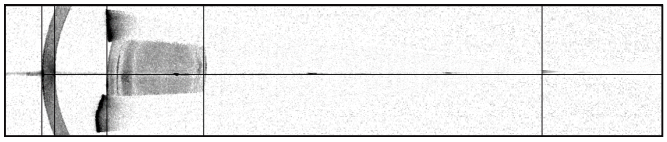


ANTERIOR AXIAL POWER

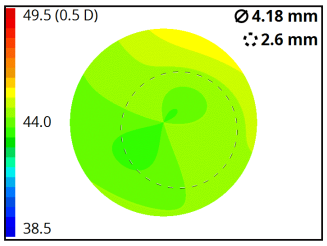


Ast. K
-0.58 D @ 31°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

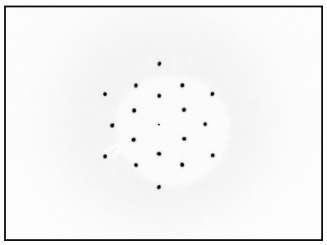

BLANCO-A-BLANCO

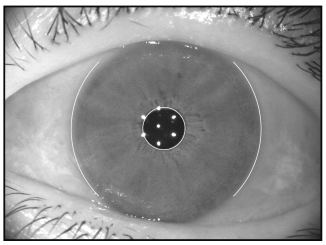

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado — Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D — SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL: 22.97 mm (*)
ACD: 2.88 mm — SD: 7 µm
LT: 4.42 mm (!) — SD: 53 µm
WTW: 11.6 mm
SE: 44.25 D — SD: 0.01 D — K1: 43.87 D @ 88°
ΔK: -0.77 D @ 88° — K2: 44.63 D @178°
TSE: 44.14 D (!) — SD: 0.04 D — TK1: 43.56 D @ 88°
ΔTK: -1.17 D @ 88° — TK2: 44.73 D @178°

K Johnson and Johnson Vision DCB00 — **- Haigis -** a0: +1.508 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.82
+23.00	-0.46
+22.50	**-0.11**
+22.00	+0.24
+21.50	+0.59
+22.35	Emetropía

K ZEISS AT LISA tri 839MP — **- Haigis -** a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.85
+22.50	-0.48
+22.00	**-0.12**
+21.50	+0.24
+21.00	+0.59
+21.84	Emetropía

K ZEISS AT LARA 829MP — **- Haigis -** a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.73
+21.50	-0.35
+21.00	**+0.02**
+20.50	+0.39
+20.00	+0.75
+21.03	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 621P — **- Haigis -** a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.54
+23.50	-0.20
+23.00	**+0.14**
+22.50	+0.48
+22.00	+0.81
+23.21	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado — Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D — SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL: 22.51 mm — SD: 13 µm
ACD: 2.85 mm — SD: 6 µm
LT: 4.36 mm (!) — SD: 47 µm
WTW: 11.7 mm
SE: 44.28 D — SD: 0.02 D — K1: 43.99 D @ 31°
ΔK: -0.58 D @ 31° — K2: 44.57 D @121°
TSE: --- — TK1: ---
ΔTK: --- — TK2: ---

K Johnson and Johnson Vision DCB00 — **- Haigis -** a0: +1.508 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.63
+24.50	-0.27
+24.00	**+0.08**
+23.50	+0.43
+23.00	+0.78
+24.12	Emetropía

K ZEISS AT LISA tri 839MP — **- Haigis -** a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.80
+24.00	-0.43
+23.50	**-0.06**
+23.00	+0.30
+22.50	+0.65
+23.41	Emetropía

K ZEISS AT LARA 829MP — **- Haigis -** a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.92
+23.50	-0.54
+23.00	**-0.17**
+22.50	+0.20
+22.00	+0.57
+22.77	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 621P — **- Haigis -** a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.73
+25.50	-0.38
+25.00	**-0.03**
+24.50	+0.31
+24.00	+0.65
+24.95	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 22.97 mm (*)	AL: 22.51 mm SD: 13 µm
ACD: 2.88 mm SD: 7 µm	ACD: 2.85 mm SD: 6 µm
LT: 4.42 mm (!) SD: 53 µm	LT: 4.36 mm (!) SD: 47 µm
WTW: 11.6 mm	WTW: 11.7 mm
SE: 44.25 D SD: 0.01 D	SE: 44.28 D SD: 0.02 D
K1: 43.87 D @ 88°	K1: 43.99 D @ 31°
ΔK: -0.77 D @ 88°	ΔK: -0.58 D @ 31°
K2: 44.63 D @178°	K2: 44.57 D @121°
TSE: 44.14 D (!) SD: 0.04 D	TSE: ---
TK1: 43.56 D @ 88°	TK1: ---
ΔTK: -1.17 D @ 88°	ΔTK: ---
TK2: 44.73 D @178°	TK2: ---

K ZEISS CT LUCIA 202 — OD

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.55
+22.50	-0.19
+22.00	**+0.16**
+21.50	+0.51
+21.00	+0.86
+22.23	Emetropía

K Alcon Clareon CNA0T0 — OD

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.67
+23.00	-0.32
+22.50	**+0.03**
+22.00	+0.38
+21.50	+0.72
+22.55	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 202 — OS

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.73
+24.50	-0.37
+24.00	**-0.01**
+23.50	+0.34
+23.00	+0.69
+23.99	Emetropía

K Alcon Clareon CNA0T0 — OS

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.55
+24.50	-0.19
+24.00	**+0.16**
+23.50	+0.51
+23.00	+0.85
+24.23	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 221P — OD

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.65
+23.50	-0.30
+23.00	**+0.04**
+22.50	+0.38
+22.00	+0.72
+23.06	Emetropía

K Bausch + Lomb Akreos Adapt — OD

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.56
+21.50	-0.19
+21.00	**+0.17**
+20.50	+0.54
+20.00	+0.90
+21.24	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 221P — OS

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+26.00	-0.77
+25.50	-0.42
+25.00	**-0.07**
+24.50	+0.27
+24.00	+0.61
+24.90	Emetropía

K Bausch + Lomb Akreos Adapt — OS

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.82
+23.50	-0.44
+23.00	**-0.07**
+22.50	+0.30
+22.00	+0.66
+22.90	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 22.97 mm (*)	AL: 22.51 mm SD: 13 µm
ACD: 2.88 mm SD: 7 µm	ACD: 2.85 mm SD: 6 µm
LT: 4.42 mm (!) SD: 53 µm	LT: 4.36 mm (!) SD: 47 µm
WTW: 11.6 mm	WTW: 11.7 mm
SE: 44.25 D SD: 0.01 D	SE: 44.28 D SD: 0.02 D
K1: 43.87 D @ 88°	K1: 43.99 D @ 31°
ΔK: -0.77 D @ 88°	ΔK: -0.58 D @ 31°
K2: 44.63 D @178°	K2: 44.57 D @121°
TSE: 44.14 D (!) SD: 0.04 D	TSE: ---
TK1: 43.56 D @ 88°	TK1: ---
ΔTK: -1.17 D @ 88°	ΔTK: ---
TK2: 44.73 D @178°	TK2: ---

K Bausch + Lomb enVista — **- Haigis -** a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

OD IOL (D)	OD Ref (D)	OS IOL (D)	OS Ref (D)
+23.50	-0.69	+25.00	-0.54
+23.00	-0.33	+24.50	-0.18
+22.50	**+0.02**	**+24.00**	**+0.17**
+22.00	+0.37	+23.50	+0.52
+21.50	+0.71	+23.00	+0.86
+22.53	Emetropía	+24.24	Emetropía

K PhysIOL Micro F — **- Haigis -** a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

OD IOL (D)	OD Ref (D)	OS IOL (D)	OS Ref (D)
+23.00	-0.69	+25.00	-0.88
+22.50	-0.33	+24.50	-0.52
+22.00	**+0.03**	**+24.00**	**-0.16**
+21.50	+0.38	+23.50	+0.20
+21.00	+0.73	+23.00	+0.55
+22.04	Emetropía	+23.78	Emetropía

K Alcon AcrySof SA60AT — **- Haigis -** a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

OD IOL (D)	OD Ref (D)	OS IOL (D)	OS Ref (D)
+23.00	-0.83	+24.50	-0.73
+22.50	-0.47	+24.00	-0.36
+22.00	**-0.10**	**+23.50**	**+0.00**
+21.50	+0.25	+23.00	+0.36
+21.00	+0.61	+22.50	+0.72
+21.85	Emetropía	+23.51	Emetropía

K PhysIOL ISOPURE 123 — **- Haigis -** a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

OD IOL (D)	OD Ref (D)	OS IOL (D)	OS Ref (D)
+24.00	-0.87	+25.50	-0.66
+23.50	-0.52	+25.00	-0.30
+23.00	**-0.17**	**+24.50**	**+0.05**
+22.50	+0.18	+24.00	+0.39
+22.00	+0.52	+23.50	+0.73
+22.76	Emetropía	+24.57	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
VS: Humor vítreo
VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL:	---			WTW:	11.6 mm	Ix:	+0.5 mm
CCT:	554 µm	SD:	3 µm	P:	2.7 mm	Iy:	+0.2 mm
ACD:	2.88 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.5 mm @ 203°
LT:	4.42 mm (!)	SD:	53 µm				


SE:	44.25 D			SD:	0.01 D	TSE:	44.14 D	(!)	SD: 0.04 D
K1:	43.87 D	@	88°	SD:	0.01 D	TK1:	43.56 D	@ 88°	SD: 0.02 D
K2:	44.63 D	@	178°	SD:	0.02 D	TK2:	44.73 D	@ 178°	SD: 0.10 D
ΔK:	-0.77 D	@	88°			ΔTK:	-1.17 D	@ 88°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power (!)

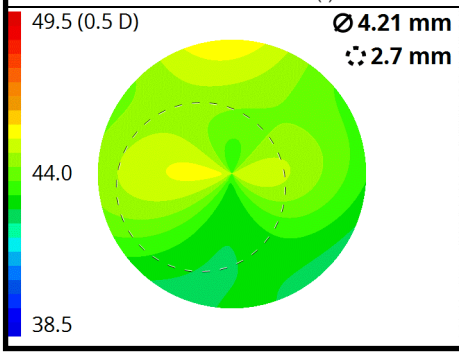

Queratometría

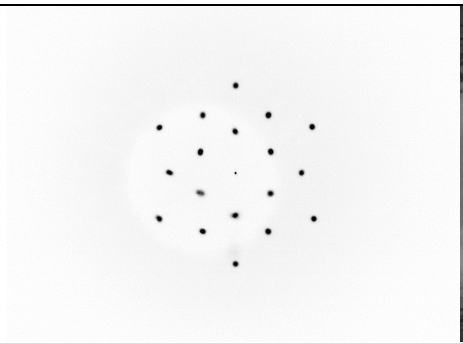

Blanco a blanco

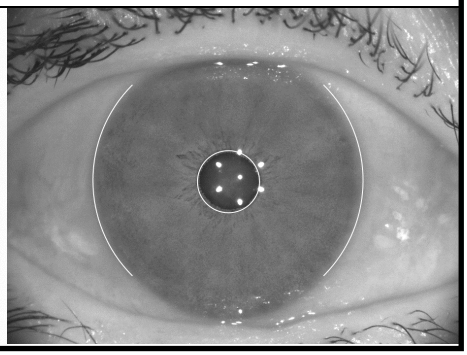

(!) Valor marginal
(*) Valor editado manualmente
--- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	22.51 mm	SD:	13 µm	WTW:	11.7 mm	Ix:	-0.5 mm Iy: +0.2 mm
CCT:	551 µm	SD:	4 µm	P:	2.6 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 335°
ACD:	2.85 mm	SD:	6 µm				
LT:	4.36 mm (!)	SD:	47 µm				


SE:	44.28 D		SD: 0.02 D	TSE:	---
K1:	43.99 D	@ 31°	SD: 0.02 D	TK1:	---
K2:	44.57 D	@ 121°	SD: 0.03 D	TK2:	---
ΔK:	-0.58 D	@ 31°		ΔTK:	---


Scan B | Fijación

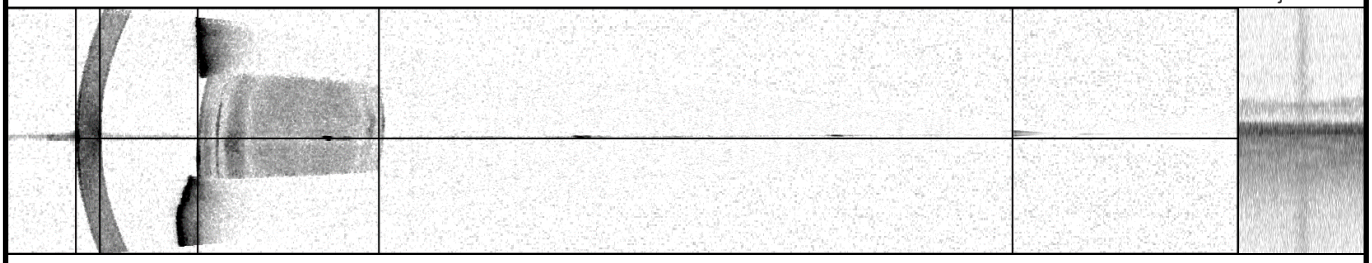

Anterior Axial Power | Queratometría | Blanco a blanco

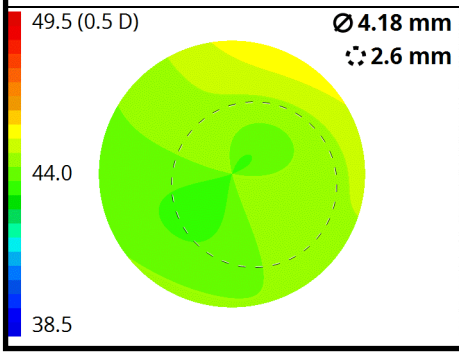

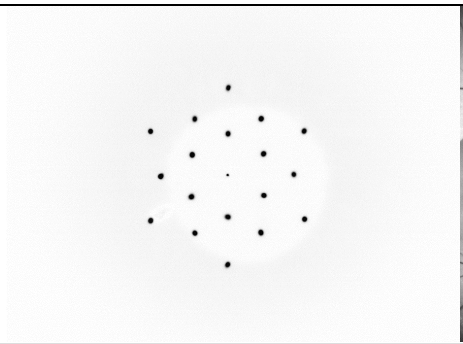

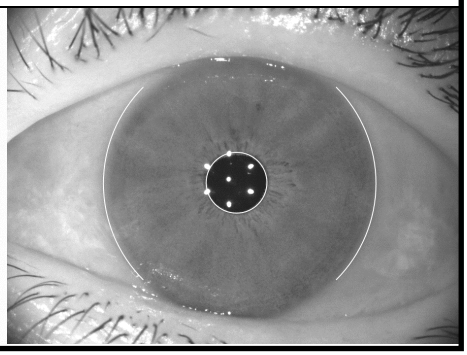

(!) Valor marginal | (*) Valor editado manualmente | --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **---**
CCT: **554** µm SD: 3 µm
ACD: **2.88** mm SD: 7 µm
LT: **4.42** mm (!) SD: 53 µm

AL	CCT	ACD	LT
---	553 µm	2.88 mm	---
---	553 µm	2.87 mm	4.40 mm
---	554 µm	2.87 mm	---
---	554 µm	2.88 mm	4.44 mm
---	554 µm	2.88 mm	4.45 mm
---	554 µm	2.88 mm	4.40 mm

Valores de la córnea

SE: **44.25** D SD: 0.01 D
K1: **43.87** D @ **88**° SD: 0.01 D
K2: **44.63** D @ **178**° SD: 0.02 D
ΔK: **-0.77** D @ **88**°

SE: 44.25 D ΔK: -0.77 D @ 89°
SE: 44.24 D ΔK: -0.77 D @ 88°
SE: 44.35 D ΔK: -0.98 D @ 105°

TSE: **44.14** D (!) SD: 0.04 D
TK1: **43.56** D @ **88**° SD: 0.02 D
TK2: **44.73** D @ **178**° SD: 0.10 D
ΔTK: **-1.17** D @ **88**°

TSE: 44.17 D ΔTK: -1.18 D @ 89°
TSE: 44.14 D ΔTK: -1.14 D @ 87°
TSE: 44.22 D ΔTK: -1.35 D @ 99°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.6 mm lx: +0.5 mm ly: +0.2 mm
P: 2.7 mm CW-chord: 0.5 mm @ 203°

Se ha guardado la imagen

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **22.51** mm SD: 13 µm
CCT: **551** µm SD: 4 µm
ACD: **2.85** mm SD: 6 µm
LT: **4.36** mm (!) SD: 47 µm

AL	CCT	ACD	LT
22.50 mm	552 µm	2.85 mm	4.32 mm
22.50 mm	550 µm	2.85 mm	4.38 mm
22.51 mm	549 µm	2.85 mm	4.38 mm
22.51 mm	548 µm	2.85 mm	4.37 mm
22.53 mm	552 µm	2.85 mm	4.38 mm
22.51 mm	553 µm	2.85 mm	4.36 mm

Valores de la córnea

SE: **44.28** D SD: 0.02 D
K1: **43.99** D @ **31**° SD: 0.02 D
K2: **44.57** D @ **121**° SD: 0.03 D
ΔK: **-0.58** D @ **31**°

SE: 44.30 D ΔK: -0.58 D @ 33°
SE: 44.26 D ΔK: -0.58 D @ 29°
SE: 44.24 D ΔK: -0.43 D @ 47°

TSE: **---**
TK1: **---**
TK2: **---**
ΔTK: **---**

TSE: --- ΔTK: ---
TSE: --- ΔTK: ---
TSE: --- ΔTK: ---

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.7 mm lx: -0.5 mm ly: +0.2 mm
P: 2.6 mm CW-chord: 0.4 mm @ 335°

Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Para este cálculo de IOL se han editado valores manualmente.

OD
derecho


Reference Image

Estatus del ojo

LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LVC: No tratado
Ref: ---	VA: ---	

Valores biométricos

AL:	22.97 mm	(*)					
ACD:	2.88 mm						
LT:	4.42 mm	(!)					
WTW:	11.6 mm	lx: +0.5 mm	ly: +0.2 mm				
P:	2.7 mm	CW-chord:	0.5 mm @ 203°				
SE:	44.25 D			TSE:	44.14 D	(!)	
K1:	43.87 D	@	88°	TK1:	43.56 D	@	88°
K2:	44.63 D	@	178°	TK2:	44.73 D	@	178°
ΔK:	-0.77 D	@	88°	ΔTK:	-1.17 D	@	88°

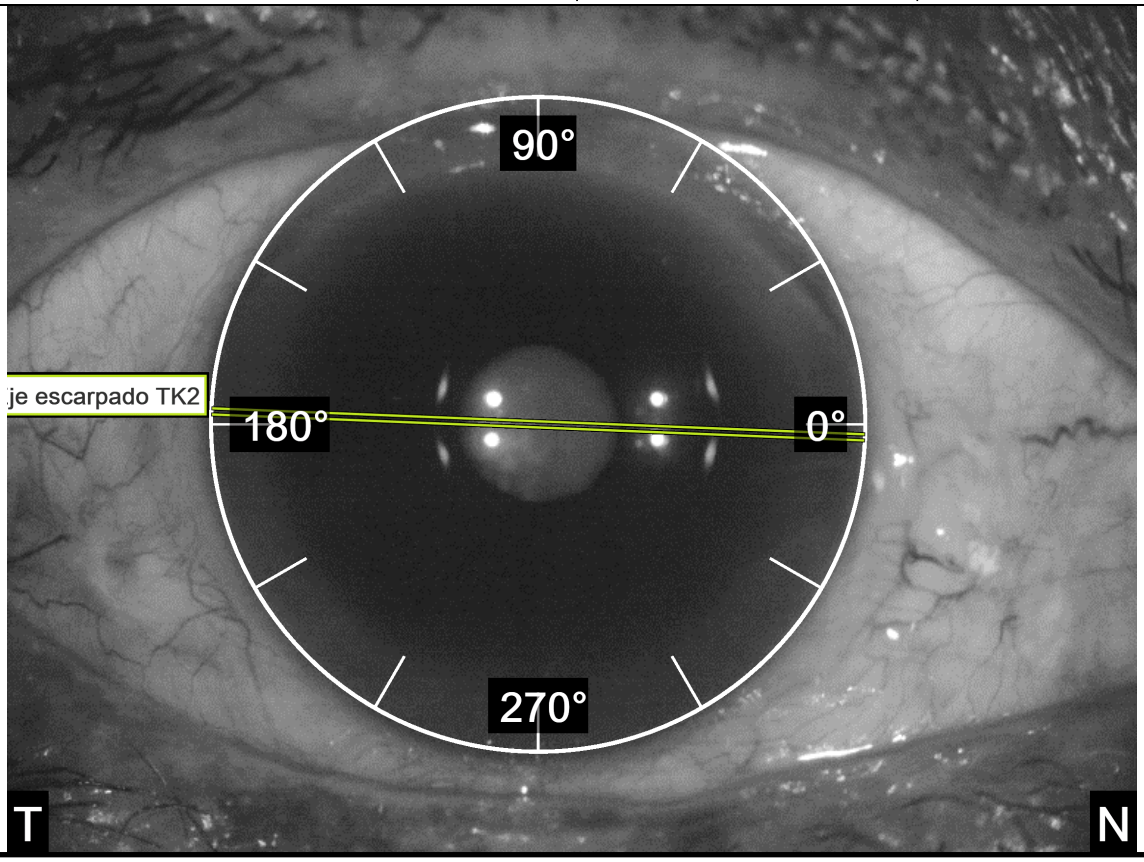

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	AVILA CHAN, MARIANA		
Fecha de nacim.	03/mar./1955	Sexo	Femenino
ID del paciente	20788		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	06/jun./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	06/jun./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image


OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	22.51 mm			SE:	44.28 D	TSE:	---
ACD:	2.85 mm			K1:	43.99 D @ 31°	TK1:	---
LT:	4.36 mm (!)			K2:	44.57 D @ 121°	TK2:	---
WTW:	11.7 mm	Ix:	-0.5 mm Iy: +0.2 mm	ΔK:	-0.58 D @ 31°	ΔTK:	---
P:	2.6 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 335°				

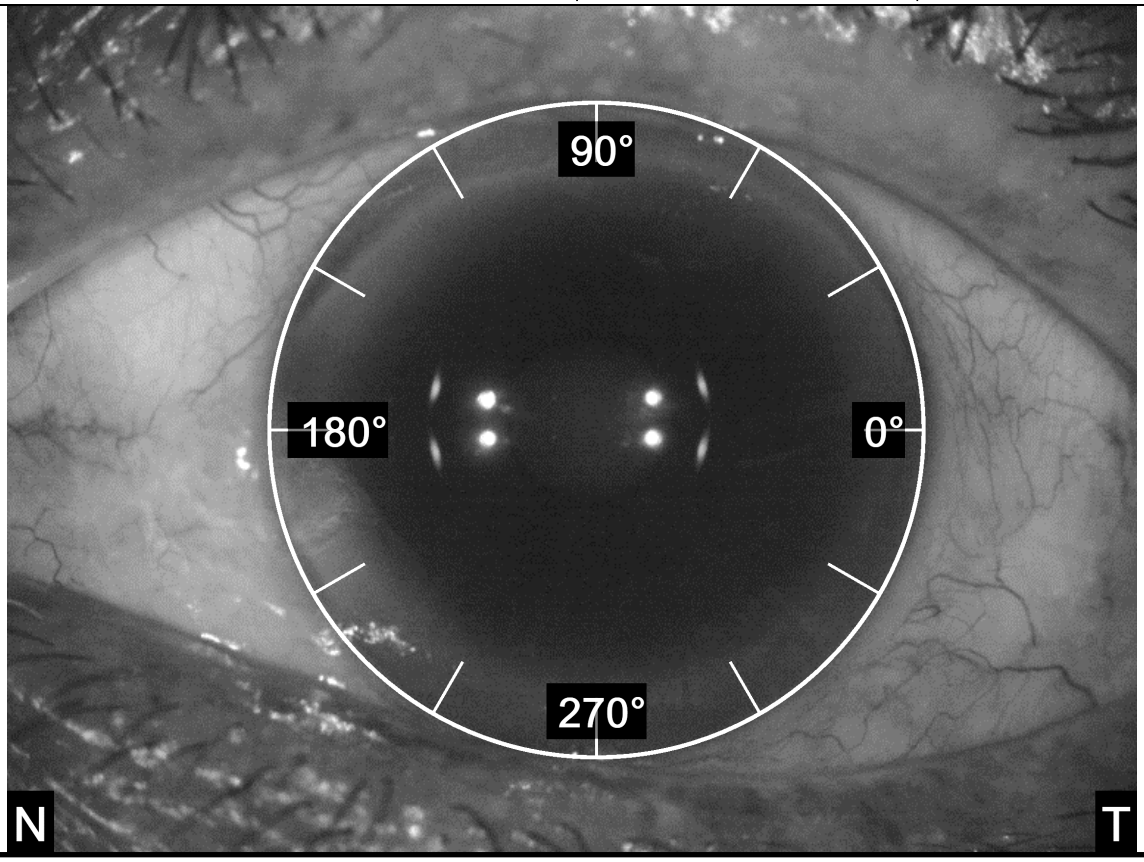

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,HTAS,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved