CÁLCULO DE IOL

Paciente	**HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	23/jul./1991		
Sexo	Femenino		
ID paciente	20972		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **21/jul./2026**	Fecha verif. calibración: **21/jul./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**23.69 mm**		WTW	12.5 mm		**AL**	**23.82 mm**		WTW	12.4 mm	
ACD	3.18 mm		Pupila	5.0 mm		ACD	3.17 mm		Pupila	5.2 mm	
LT	3.95 mm		Ix / Iy	+0.6 mm	/+0.0 mm	LT	3.94 mm		Ix / Iy	-0.6 mm	/+0.2 mm
CCT	508 µm		Kappa	0.6 mm	@ 237°	CCT	497 µm		Kappa	0.4 mm	@ 311°
Ast. K	**-2.32 D**	**@ 168°**	**Ast. TK**	**-2.29 D**	**@ 170°**	**Ast. K**	**-1.56 D**	**@ 7°**	**Ast. TK**	**-1.51 D**	**@ 6°**
Avg. K	43.18 D		Avg. TK	43.28 D		Avg. K	42.52 D		Avg. TK	42.56 D	
K1	42.05 D	@ 168°	TK1	42.17 D	@ 170°	K1	41.76 D	@ 7°	TK1	41.82 D	@ 6°
K2	44.37 D	@ 78°	TK2	44.46 D	@ 80°	K2	43.31 D	@ 97°	TK2	43.33 D	@ 96°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+20.50	-0.60
+20.00	-0.22
+19.50	**+0.15**
+19.00	+0.52
+19.70	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.57
+21.00	-0.21
+20.50	**+0.15**
+20.00	+0.50
+20.71	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SA60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.87
+21.50	-0.50
+21.00	**-0.14**
+20.50	+0.21
+20.80	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.65
+20.50	-0.27
+20.00	**+0.11**
+19.50	+0.48
+20.15	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.62
+21.50	-0.25
+21.00	**+0.11**
+20.50	+0.47
+21.16	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SA60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.91
+22.00	-0.54
+21.50	**-0.18**
+21.00	+0.18
+21.25	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.68
+22.00	-0.32
+21.50	**+0.02**
+21.00	+0.37
+21.54	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.61
+21.50	-0.25
+21.00	**+0.10**
+20.50	+0.45
+21.15	0.00

LF +2.06 DF +5.0

Akreos Adapt

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.57
+20.50	-0.20
+20.00	**+0.17**
+19.50	+0.53
+20.23	0.00

LF +1.57 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.72
+22.50	-0.36
+22.00	**-0.01**
+21.50	+0.34
+21.99	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.65
+22.00	-0.29
+21.50	**+0.07**
+21.00	+0.42
+21.60	0.00

LF +2.06 DF +5.0

Akreos Adapt

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.61
+21.00	-0.24
+20.50	**+0.13**
+20.00	+0.50
+20.68	0.00

LF +1.57 DF +5.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.64
+21.00	-0.28
+20.50	**+0.08**
+20.00	+0.44
+20.62	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.87
+21.00	-0.50
+20.50	**-0.13**
+20.00	+0.23
+20.32	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.57
+21.50	-0.21
+21.00	**+0.14**
+20.50	+0.49
+21.21	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.69
+21.50	-0.32
+21.00	**+0.05**
+20.50	+0.41
+21.07	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.92
+21.50	-0.54
+21.00	**-0.17**
+20.50	+0.20
+20.77	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.61
+22.00	-0.25
+21.50	**+0.11**
+21.00	+0.46
+21.66	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	23/jul./1991		
Sexo	Femenino		
ID paciente	20972		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **21/jul./2026**	Fecha verif. calibración: **21/jul./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Clareon PanOptix CNW

TT0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.78
+21.50	-0.42
+21.00	**-0.06**
+20.50	+0.29
+20.91	0.00

LF +1.94 DF +5.0

Clareon PanOptix CNW

TT0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.83
+22.00	-0.46
+21.50	**-0.10**
+21.00	+0.26
+21.37	0.00

LF +1.94 DF +5.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+20.50	-1.06	135° 75° T N	**2.50**	**-0.09 @ 165°**
+20.00	-0.68			
+19.50	**-0.31**			
+19.00	+0.05			
---	0.00	75°	2.53	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+21.50	-0.92	135° 90° N T	**1.00**	**-0.30 @ 180°**
+21.00	-0.54			
+20.50	**-0.17**			
+20.00	+0.20			
---	0.00	90°	1.38	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+20.50	-1.06	135° 75° T N	**2.50**	**-0.09 @ 165°**
+20.00	-0.68			
+19.50	**-0.31**			
+19.00	+0.05			
---	0.00	75°	2.53	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+21.50	-0.92	135° 90° N T	**1.00**	**-0.30 @ 180°**
+21.00	-0.54			
+20.50	**-0.17**			
+20.00	+0.20			
---	0.00	90°	1.38	0.00

LF +1.62 DF +0.0

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA**	**Clinica MEDYTEC**	
Fecha de nacimie...	23/jul./1991		
Sexo	Femenino		
ID paciente	20972	**Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida**	
Médico	Surgeon	**999 926 8619**	
		info@clinicamedytec.com	

Fecha de la medición **21/jul./2026** Fecha verif. calibración: **21/jul./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

!

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.69 mm**	SD	4 µm	WTW 12.5 mm	**AL**	**23.82 mm**	SD	8 µm	WTW 12.4 mm
ACD	3.18 mm	SD	4 µm	Pupila 5.0 mm	ACD	3.17 mm	SD	5 µm	Pupila 5.2 mm
LT	3.95 mm	SD	5 µm	Ix / Iy +0.6 mm / +0.0 mm	LT	3.94 mm	SD	8 µm	Ix / Iy -0.6 mm / +0.2 mm
CCT	508 µm	SD	3 µm	Kappa 0.6 mm @ 237 °	CCT	497 µm	SD	6 µm	Kappa 0.4 mm @ 311 °


OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-2.32 D**	**@**	**168°**	**Ast. K**	**-1.56 D**	**@**	**7°**
Avg. K	43.18 D		SD 0.01 D	Avg. K	42.52 D		SD 0.04 D
K1	42.05 D	@	168° SD 0.01 D	K1	41.76 D	@	7° SD 0.04 D
K2	44.37 D	@	78° SD 0.03 D	K2	43.31 D	@	97° SD 0.05 D
Ast. TK	**-2.29 D**	**@**	**170°**	**Ast. TK**	**-1.51 D**	**@**	**6°**
Avg. TK	43.28 D		SD 0.03 D	Avg. TK	42.56 D		SD 0.04 D
TK1	42.17 D	@	170° SD 0.04 D	TK1	41.82 D	@	6° SD 0.04 D
TK2	44.46 D	@	80° SD 0.03 D	TK2	43.33 D	@	96° SD 0.03 D

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

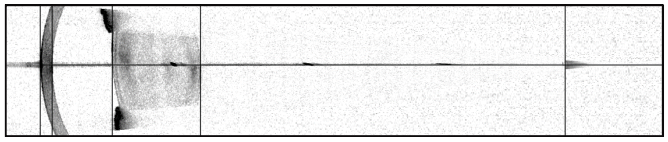


TOTAL AXIAL POWER

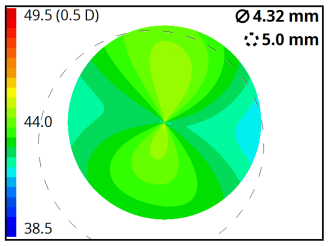


Ast. TK
-2.29 D @ 170°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

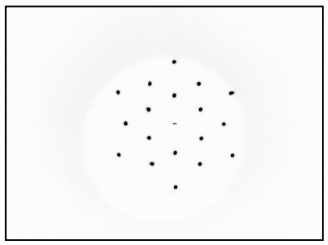


BLANCO-A-BLANCO

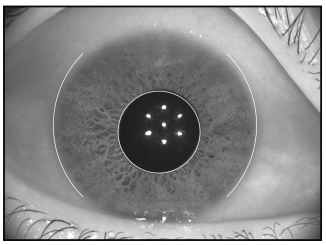

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

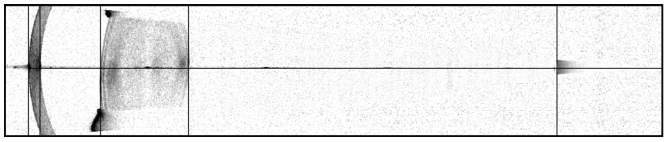


TOTAL AXIAL POWER

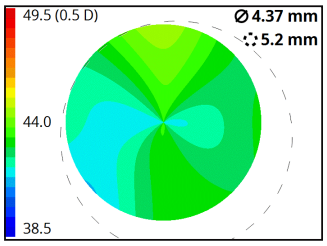


Ast. TK
-1.51 D @ 6°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

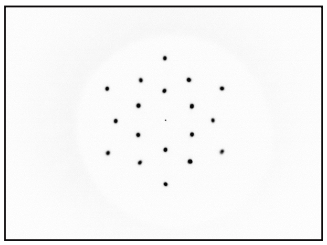

BLANCO-A-BLANCO

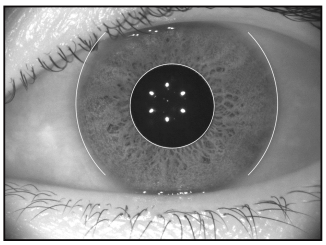

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD				OS			
LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---	Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-	LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°	Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD					OS				
AL:	23.69 mm	SD:	4 µm		AL:	23.82 mm	SD:	8 µm	
ACD:	3.18 mm	SD:	4 µm		ACD:	3.17 mm	SD:	5 µm	
LT:	3.95 mm	SD:	5 µm		LT:	3.94 mm	SD:	8 µm	
WTW:	12.5 mm				WTW:	12.4 mm			
SE:	43.18 D	SD:	0.01 D	K1: 42.05 D @168°	SE:	42.52 D	SD:	0.04 D	K1: 41.76 D @ 7°
ΔK:	-2.32 D	@168°		K2: 44.37 D @ 78°	ΔK:	-1.56 D	@ 7°		K2: 43.31 D @ 97°
TSE:	43.28 D	SD:	0.03 D	TK1: 42.17 D @170°	TSE:	42.56 D	SD:	0.04 D	TK1: 41.82 D @ 6°
ΔTK:	-2.29 D	@170°		TK2: 44.46 D @ 80°	ΔTK:	-1.51 D	@ 6°		TK2: 43.33 D @ 96°

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+20.50	-0.60
+20.00	-0.22
+19.50	**+0.15**
+19.00	+0.52
+18.50	+0.88
+19.70	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.57
+21.00	-0.21
+20.50	**+0.15**
+20.00	+0.50
+19.50	+0.85
+20.71	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.65
+20.50	-0.27
+20.00	**+0.11**
+19.50	+0.48
+19.00	+0.85
+20.15	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.62
+21.50	-0.25
+21.00	**+0.11**
+20.50	+0.47
+20.00	+0.83
+21.16	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.87
+21.50	-0.50
+21.00	**-0.14**
+20.50	+0.21
+20.00	+0.57
+20.80	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.68
+22.00	-0.32
+21.50	**+0.02**
+21.00	+0.37
+20.50	+0.71
+21.54	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.91
+22.00	-0.54
+21.50	**-0.18**
+21.00	+0.18
+20.50	+0.54
+21.25	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.72
+22.50	-0.36
+22.00	**-0.01**
+21.50	+0.34
+21.00	+0.69
+21.99	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.69 mm	SD: 4 µm	AL:	23.82 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.18 mm	SD: 4 µm	ACD:	3.17 mm	SD: 5 µm
LT:	3.95 mm	SD: 5 µm	LT:	3.94 mm	SD: 8 µm
WTW:	12.5 mm		WTW:	12.4 mm	
SE:	43.18 D	SD: 0.01 D	SE:	42.52 D	SD: 0.04 D
ΔK:	-2.32 D	@168°	ΔK:	-1.56 D	@ 7°
TSE:	43.28 D	SD: 0.03 D	TSE:	42.56 D	SD: 0.04 D
ΔTK:	-2.29 D	@170°	ΔTK:	-1.51 D	@ 6°

OD				OS			
K1:	42.05 D	@168°		K1:	41.76 D	@	7°
K2:	44.37 D	@ 78°		K2:	43.31 D	@	97°
TK1:	42.17 D	@170°		TK1:	41.82 D	@	6°
TK2:	44.46 D	@ 80°		TK2:	43.33 D	@	96°

TK Alcon Clareon CNA0T0 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.61
+21.50	-0.25
+21.00	**+0.10**
+20.50	+0.45
+20.00	+0.79
+21.15	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.57 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.57
+20.50	-0.20
+20.00	**+0.17**
+19.50	+0.53
+19.00	+0.88
+20.23	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.65
+22.00	-0.29
+21.50	**+0.07**
+21.00	+0.42
+20.50	+0.77
+21.60	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.57 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.61
+21.00	-0.24
+20.50	**+0.13**
+20.00	+0.50
+19.50	+0.85
+20.68	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.64
+21.00	-0.28
+20.50	**+0.08**
+20.00	+0.44
+19.50	+0.79
+20.62	Emetropía

TK HOYA 250 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.87
+21.00	-0.50
+20.50	**-0.13**
+20.00	+0.23
+19.50	+0.59
+20.32	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.69
+21.50	-0.32
+21.00	**+0.05**
+20.50	+0.41
+20.00	+0.76
+21.07	Emetropía

TK HOYA 250 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.92
+21.50	-0.54
+21.00	**-0.17**
+20.50	+0.20
+20.00	+0.56
+20.77	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.69 mm	SD: 4 µm	AL:	23.82 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.18 mm	SD: 4 µm	ACD:	3.17 mm	SD: 5 µm
LT:	3.95 mm	SD: 5 µm	LT:	3.94 mm	SD: 8 µm
WTW:	12.5 mm		WTW:	12.4 mm	
SE:	43.18 D	SD: 0.01 D	SE:	42.52 D	SD: 0.04 D
ΔK:	-2.32 D	@168°	ΔK:	-1.56 D	@ 7°
TSE:	43.28 D	SD: 0.03 D	TSE:	42.56 D	SD: 0.04 D
ΔTK:	-2.29 D	@170°	ΔTK:	-1.51 D	@ 6°

OD				OS			
K1:	42.05 D	@168°		K1:	41.76 D	@	7°
K2:	44.37 D	@ 78°		K2:	43.31 D	@	97°
TK1:	42.17 D	@170°		TK1:	41.82 D	@	6°
TK2:	44.46 D	@ 80°		TK2:	43.33 D	@	96°

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.57
+21.50	-0.21
+21.00	**+0.14**
+20.50	+0.49
+20.00	+0.83
+21.21	Emetropía

TK Alcon Clareon PanOptix CNW TT0 — OD

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.94 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.78
+21.50	-0.42
+21.00	**-0.06**
+20.50	+0.29
+20.00	+0.64
+20.91	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.61
+22.00	-0.25
+21.50	**+0.11**
+21.00	+0.46
+20.50	+0.81
+21.66	Emetropía

TK Alcon Clareon PanOptix CNW TT0 — OS

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.94 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.83
+22.00	-0.46
+21.50	**-0.10**
+21.00	+0.26
+20.50	+0.62
+21.37	Emetropía

TK ZEISS AT TORBI 709MP — OD

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+21.75	+2.50	75°	-1.06	-1.02	-0.08	165°
+21.25	+2.50	75°	-0.68	-0.64	-0.08	165°
+20.75	**+2.50**	**75°**	**-0.31**	**-0.27**	**-0.09**	**165°**
+20.25	+2.50	75°	+0.05	+0.10	-0.09	165°
+19.75	+2.50	75°	+0.41	+0.46	-0.09	165°
---	+2.53	75°	Emetropía			

TK ZEISS AT TORBI 709MP — OS

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+22.00	+1.00	90°	-0.92	-0.77	-0.30	180°
+21.50	+1.00	90°	-0.54	-0.39	-0.30	180°
+21.00	**+1.00**	**90°**	**-0.17**	**-0.02**	**-0.30**	**180°**
+20.50	+1.00	90°	+0.20	+0.35	-0.30	180°
+20.00	+1.00	90°	+0.56	+0.71	-0.30	180°
---	+1.38	90°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.69 mm	SD: 4 µm	AL:	23.82 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.18 mm	SD: 4 µm	ACD:	3.17 mm	SD: 5 µm
LT:	3.95 mm	SD: 5 µm	LT:	3.94 mm	SD: 8 µm
WTW:	12.5 mm		WTW:	12.4 mm	
SE:	43.18 D	SD: 0.01 D	SE:	42.52 D	SD: 0.04 D
ΔK:	-2.32 D	@168°	ΔK:	-1.56 D	@ 7°
TSE:	43.28 D	SD: 0.03 D	TSE:	42.56 D	SD: 0.04 D
ΔTK:	-2.29 D	@170°	ΔTK:	-1.51 D	@ 6°

OD			OS		
K1:	42.05 D	@168°	K1:	41.76 D	@ 7°
K2:	44.37 D	@ 78°	K2:	43.31 D	@ 97°
TK1:	42.17 D	@170°	TK1:	41.82 D	@ 6°
TK2:	44.46 D	@ 80°	TK2:	43.33 D	@ 96°

TK ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP

- Barrett Toric TK -

LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+21.75	+2.50	75°	-1.06	-1.02	-0.08	165°
+21.25	+2.50	75°	-0.68	-0.64	-0.08	165°
+20.75	**+2.50**	**75°**	**-0.31**	**-0.27**	**-0.09**	**165°**
+20.25	+2.50	75°	+0.05	+0.10	-0.09	165°
+19.75	+2.50	75°	+0.41	+0.46	-0.09	165°
---	+2.53	75°	Emetropía			

TK ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP

- Barrett Toric TK -

LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+22.00	+1.00	90°	-0.92	-0.77	-0.30	180°
+21.50	+1.00	90°	-0.54	-0.39	-0.30	180°
+21.00	**+1.00**	**90°**	**-0.17**	**-0.02**	**-0.30**	**180°**
+20.50	+1.00	90°	+0.20	+0.35	-0.30	180°
+20.00	+1.00	90°	+0.56	+0.71	-0.30	180°
---	+1.38	90°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.69 mm	SD:	4 µm	WTW:	12.5 mm	Ix:	+0.6 mm
CCT:	508 µm	SD:	3 µm	P:	5.0 mm	Iy:	+0.0 mm
ACD:	3.18 mm	SD:	4 µm			CW-chord:	0.6 mm @ 237°
LT:	3.95 mm	SD:	5 µm				


SE:	43.18 D		SD:	0.01 D	TSE:	43.28 D		SD: 0.03 D
K1:	42.05 D	@ 168°	SD:	0.01 D	TK1:	42.17 D	@ 170°	SD: 0.04 D
K2:	44.37 D	@ 78°	SD:	0.03 D	TK2:	44.46 D	@ 80°	SD: 0.03 D
ΔK:	-2.32 D	@ 168°			ΔTK:	-2.29 D	@ 170°	

Scan B

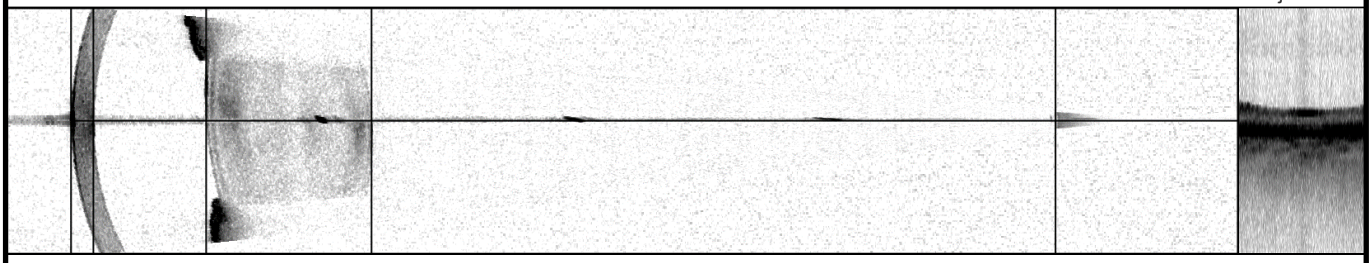


Fijación


Total Axial Power

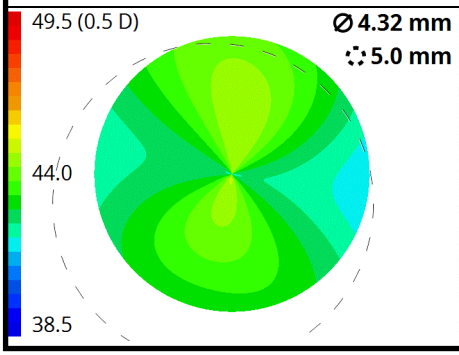

Queratometría

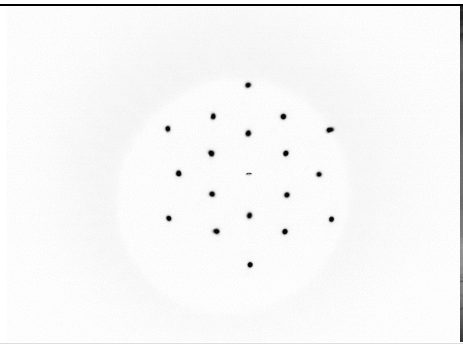

Blanco a blanco

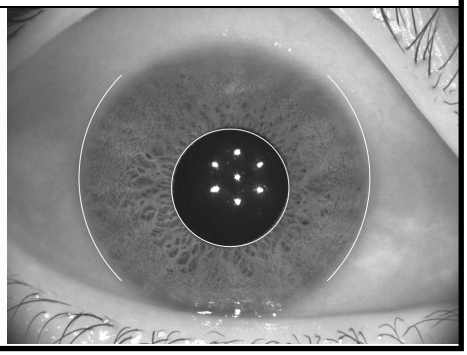

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.82 mm	SD:	8 µm	WTW:	12.4 mm	Ix:	-0.6 mm
CCT:	497 µm	SD:	6 µm	P:	5.2 mm	Iy:	+0.2 mm
ACD:	3.17 mm	SD:	5 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 311°
LT:	3.94 mm	SD:	8 µm				

SE:	42.52 D			SD:	0.04 D	TSE:	42.56 D			SD:	0.04 D
K1:	41.76 D	@	7°	SD:	0.04 D	TK1:	41.82 D	@	6°	SD:	0.04 D
K2:	43.31 D	@	97°	SD:	0.05 D	TK2:	43.33 D	@	96°	SD:	0.03 D
ΔK:	-1.56 D	@	7°			ΔTK:	-1.51 D	@	6°		


Scan B

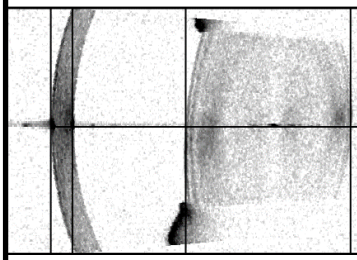


Fijación




Total Axial Power

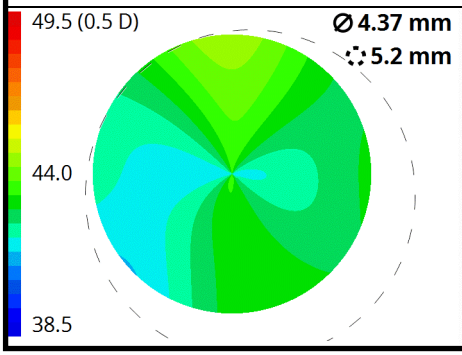

Queratometría

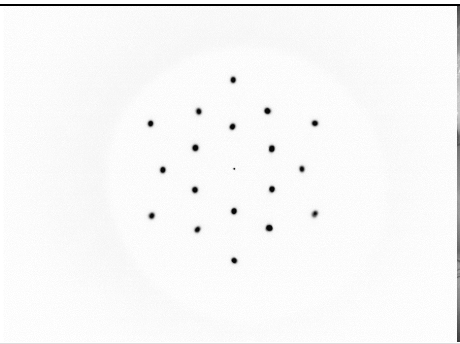

Blanco a blanco

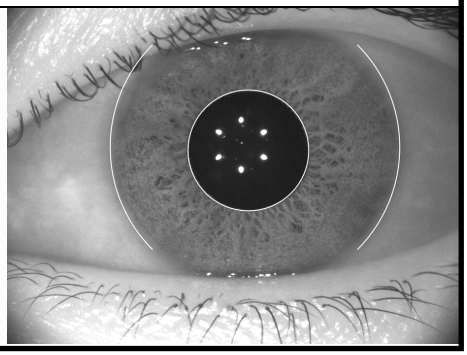

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA
Fecha de nacim.	23/jul./1991
Sexo	Femenino
ID del paciente	20972
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL:	**23.69** mm	SD:	4 µm
CCT:	**508** µm	SD:	3 µm
ACD:	**3.18** mm	SD:	4 µm
LT:	**3.95** mm	SD:	5 µm

AL	CCT	ACD	LT
23.69 mm	508 µm	3.18 mm	3.95 mm
23.69 mm	508 µm	3.18 mm	3.95 mm
23.69 mm	505 µm	3.18 mm	3.95 mm
23.69 mm	506 µm	3.18 mm	3.95 mm
23.70 mm	509 µm	3.18 mm	3.95 mm
23.70 mm	510 µm	3.18 mm	3.95 mm

Valores de la córnea

SE:	**43.18** D		SD:	0.01 D
K1:	**42.05** D	@ **168°**	SD:	0.01 D
K2:	**44.37** D	@ **78°**	SD:	0.03 D
ΔK:	**-2.32** D	@ **168°**		

SE: 43.17 D	ΔK: -2.28 D	@ 168°
SE: 43.17 D	ΔK: -2.32 D	@ 168°
SE: 43.19 D	ΔK: -2.36 D	@ 168°

TSE:	**43.28** D		SD:	0.03 D
TK1:	**42.17** D	@ **170°**	SD:	0.04 D
TK2:	**44.46** D	@ **80°**	SD:	0.03 D
ΔTK:	**-2.29** D	@ **170°**		

TSE: 43.27 D	ΔTK: -2.26 D	@ 171°
TSE: 43.32 D	ΔTK: -2.29 D	@ 169°
TSE: 43.26 D	ΔTK: -2.34 D	@ 169°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW:	12.5 mm	Ix:	+0.6 mm	Iy:	+0.0 mm
P:	5.0 mm	CW-chord:	0.6 mm @ 237°		

Se ha guardado la imagen

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL:	**23.82** mm	SD:	8 µm
CCT:	**497** µm	SD:	6 µm
ACD:	**3.17** mm	SD:	5 µm
LT:	**3.94** mm	SD:	8 µm

AL	CCT	ACD	LT
23.82 mm	493 µm	3.17 mm	3.94 mm
23.81 mm	495 µm	3.17 mm	3.93 mm
23.81 mm	493 µm	3.16 mm	3.94 mm
23.82 mm	501 µm	3.17 mm	3.93 mm
23.82 mm	506 µm	3.17 mm	3.93 mm
23.81 mm	496 µm	3.17 mm	3.94 mm

Valores de la córnea

SE:	**42.52** D		SD:	0.04 D
K1:	**41.76** D	@ **7°**	SD:	0.04 D
K2:	**43.31** D	@ **97°**	SD:	0.05 D
ΔK:	**-1.56** D	@ **7°**		

SE: 42.47 D	ΔK: -1.56 D	@ 8°
SE: 42.52 D	ΔK: -1.56 D	@ 7°
SE: 42.57 D	ΔK: -1.56 D	@ 6°

TSE:	**42.56** D		SD:	0.04 D
TK1:	**41.82** D	@ **6°**	SD:	0.04 D
TK2:	**43.33** D	@ **96°**	SD:	0.03 D
ΔTK:	**-1.51** D	@ **6°**		

TSE: 42.52 D	ΔTK: -1.52 D	@ 8°
TSE: 42.58 D	ΔTK: -1.48 D	@ 6°
TSE: 42.57 D	ΔTK: -1.53 D	@ 5°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW:	12.4 mm	Ix:	-0.6 mm	Iy:	+0.2 mm
P:	5.2 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 311°		

Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA
Fecha de nacim.	23/jul./1991
ID del paciente	20972
Sexo	Femenino
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.69 mm			SE:	43.18 D		
ACD:	3.18 mm			K1:	42.05 D	@	168°
LT:	3.95 mm			K2:	44.37 D	@	78°
WTW:	12.5 mm	Ix:	+0.6 mm	ΔK:	-2.32 D	@	168°
P:	5.0 mm	Iy:	+0.0 mm				
		CW-chord:	0.6 mm @ 237°				

TSE:	43.28 D		
TK1:	42.17 D	@	170°
TK2:	44.46 D	@	80°
ΔTK:	-2.29 D	@	170°

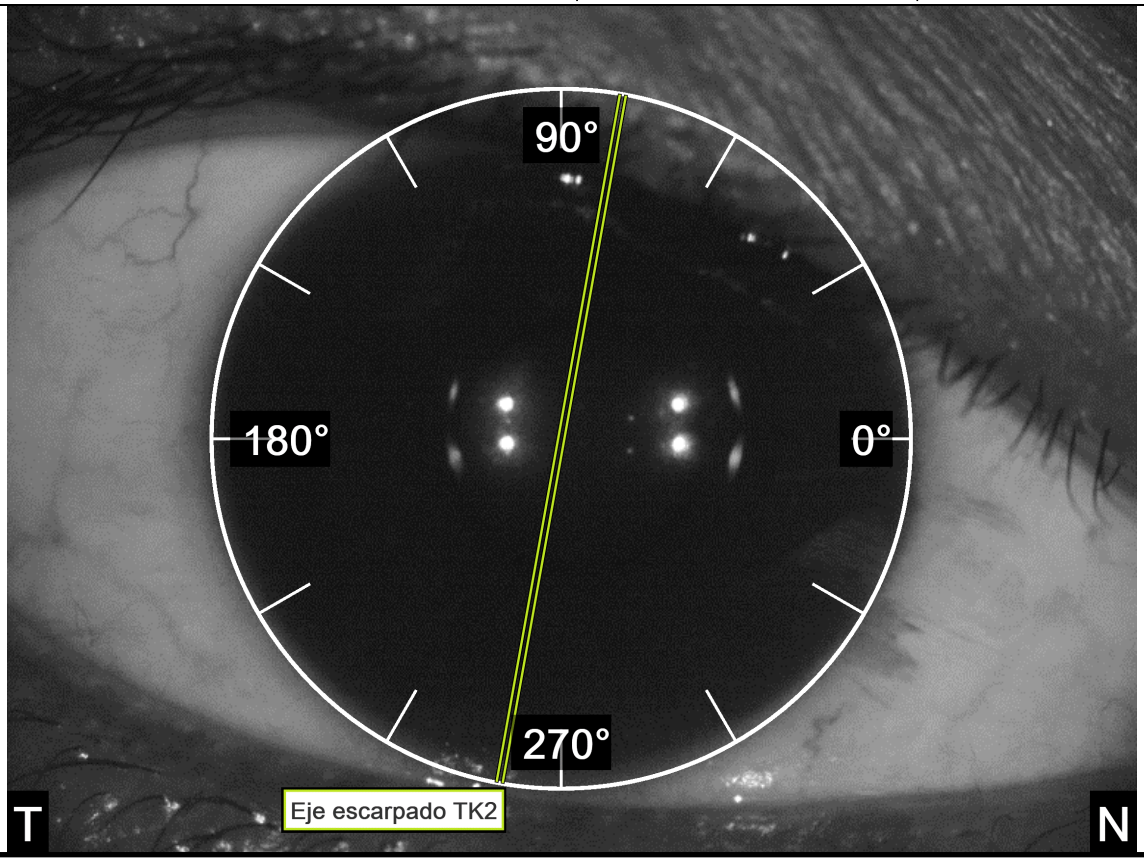

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	HERNANDEZ HERNANDEZ, THALIA ALEJANDRA		
Fecha de nacim.	23/jul./1991	Sexo	Femenino
ID del paciente	20972		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/jul./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/jul./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image


OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.82 mm			SE:	42.52 D		TSE:	42.56 D	
ACD:	3.17 mm			K1:	41.76 D	@ 7°	TK1:	41.82 D	@ 6°
LT:	3.94 mm			K2:	43.31 D	@ 97°	TK2:	43.33 D	@ 96°
WTW:	12.4 mm	Ix:	-0.6 mm Iy: +0.2 mm	ΔK:	-1.56 D	@ 7°	ΔTK:	-1.51 D	@ 6°
P:	5.2 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 311°						

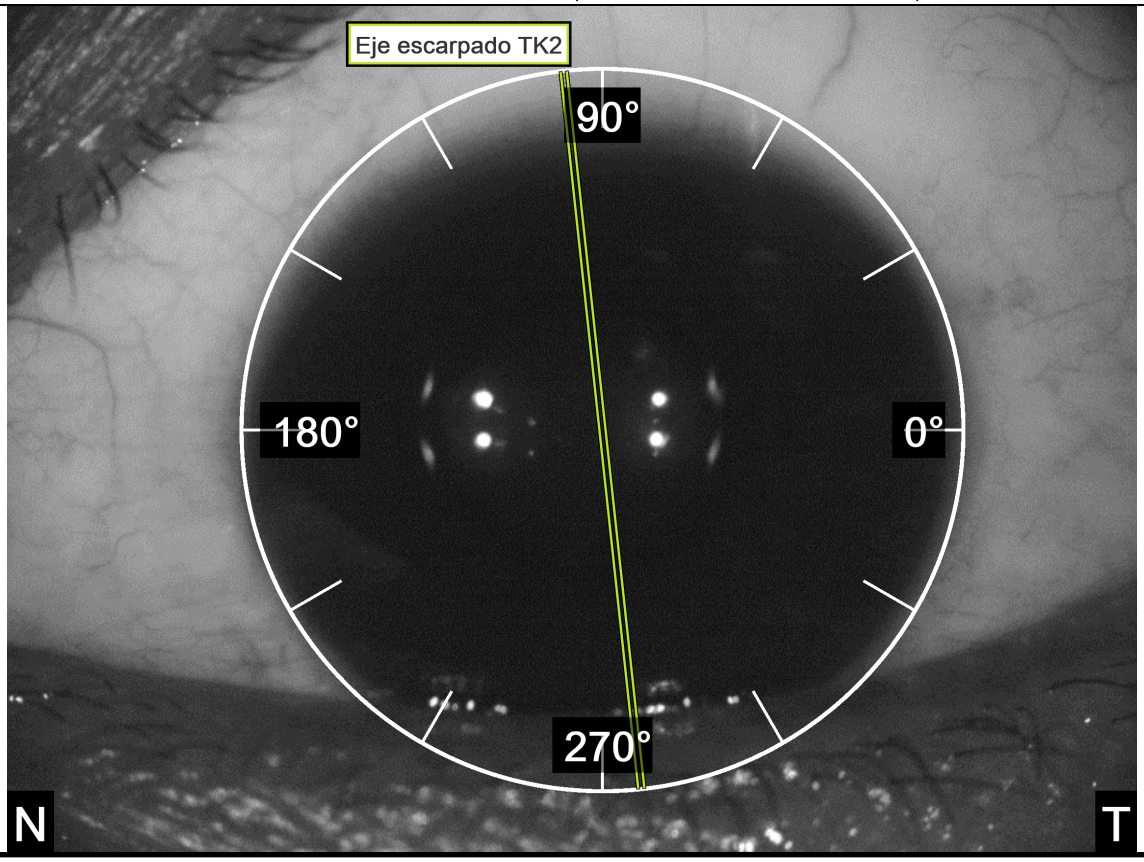

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.HIGADO GRASO.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved