
Paciente: **BAEZ TREJO, ANA VALERIA**

Fecha de nacimiento: **20-ene.-1992**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20969**

OD Central 24-2 Prueba de umbral

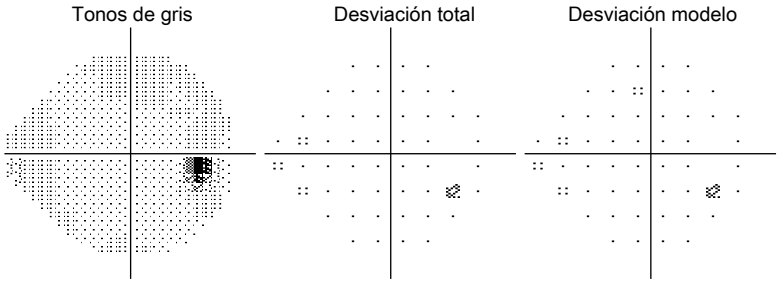



20-jul.-2026 **SITA-Fast**

FP: **0%**
FN: **0%**
FL: **0/10**

VFI24-2: **99%**
MD24-2: **-0,83 dB**
PSD24-2: **1,46 dB**
GHT: Dentro de límites normales

Estructura-función OU (examen único)




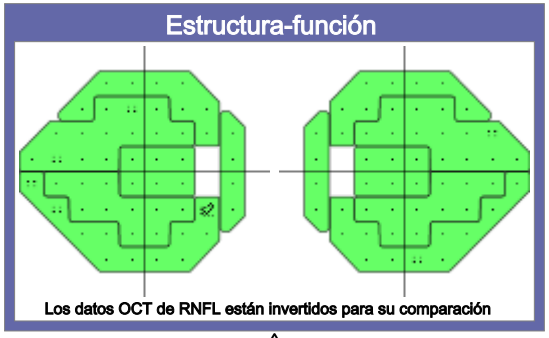

OD		OS
98µm	Grosor RNFL promedio	95µm
0,41	Proporción media C/D	0,39
1,10mm²	Zona anillo	1,14mm²
0,39	Proporción C/D vertical	0,43
0,055mm³	Volumen de Cup	0,041mm³
1,33mm²	Área de Disc	1,34mm²
81µm	Grosor medio de GCL+IPL promedio	82µm
80µm	Grosor GCL+IPL mínimo	81µm

Distribución de valores normales: N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

Central 24-2 Prueba de umbral OS

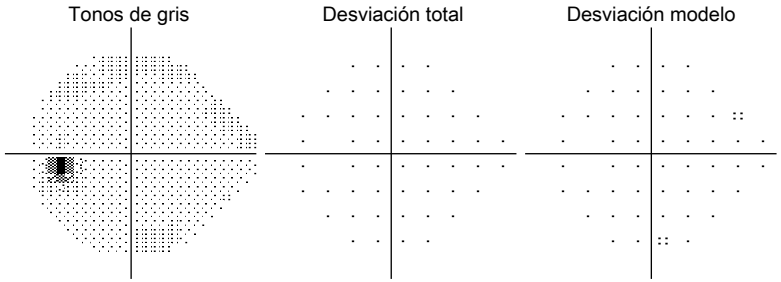


20-jul.-2026 **SITA-Fast**

FP: **0%**
FN: **0%**
FL: **0/10**

VFI24-2: **100%**
MD24-2: **0,09 dB**
PSD24-2: **1,25 dB**
GHT: Dentro de límites normales

OD CIRRUS HD-OCT


Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **10/10**



Cuadrantes de RNFL




Horas de reloj de RNFL





RNFL
20-jul.-2026

Intensidad señal: **10/10**




Células ganglionares
20-jul.-2026

CIRRUS HD-OCT OS


Cuadrantes de RNFL



Horas de reloj de RNFL




Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **9/10**



Intensidad señal: **10/10**

Células ganglionares
20-jul.-2026



RNFL
20-jul.-2026



Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **BAEZ TREJO, ANA VALERIA**

Fecha de nacimiento: **20-ene.-1992**

Sexo: **Femenino**


N.º de paciente: **20969**

OD — Información detallada de los datos normativos — OS

Fecha: 20-jul.-2026 Edad: 34
Hora: 18:52 Intensidad señal: 10/10

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,41	43	0,35	71	0,48	18
Zona anillo	1,10mm²	17	0,93mm²	3	1,28mm²	63
Proporción C/D vertical	0,39	50	0,31	80	0,48	12
Volumen de Cup	0,05mm³	19	0,03mm³	41	0,08mm³	10


Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	98,27µm	64	94,47µm	48	102,07µm	75
Zona 1	116,67	57	104,57	37	128,76	74
Zona 2	133,82	32	121,43	15	146,22	57
Zona 3	106,93	44	95,51	24	118,34	62
Zona 4	116,11	26	105,20	12	127,02	46
Zona 5	95,18	94	88,36	86	102,00	98
Zona 6	66,14	60	62,20	44	70,07	73



Fecha: 20-jul.-2026 Edad: 34
Hora: 18:57 Intensidad señal: 9/10

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,39	55	0,32	80	0,46	26
Zona anillo	1,14mm²	25	0,97mm²	5	1,31mm²	66
Proporción C/D vertical	0,43	31	0,34	67	0,51	8
Volumen de Cup	0,04mm³	33	0,01mm³	61	0,07mm³	13

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	95,18µm	51	91,38µm	36	98,98µm	67
Zona 1	112,79	52	100,70	32	124,88	68
Zona 2	145,12	55	132,73	28	157,52	81
Zona 3	102,65	35	91,24	18	114,06	53
Zona 4	109,48	18	98,56	6	120,39	33
Zona 5	82,88	67	76,06	45	89,70	86
Zona 6	70,19	73	66,25	60	74,13	83



⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **BAEZ TREJO, ANA VALERIA**

Fecha de nacimiento: **20-ene.-1992**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20969**

OD — Información detallada de los datos normativos — OS

Fecha:	20-jul.-2026	Edad:	34		
Hora:	18:52	Intensidad señal:	10/10		

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	66,21µm	59	60,51µm	36	71,91µm	77
Grosor superior	116,65µm	41	106,95µm	19	126,35µm	65
Grosor nasal	88,33µm	95	82,03µm	85	94,63µm	>99
Grosor inferior	121,88µm	44	113,08µm	23	130,68µm	66
CH09	57,84µm	79	52,84µm	64	62,84µm	86
CH10	80,07µm	59	70,17µm	30	89,97µm	82
CH11	114,04µm	26	100,64µm	11	127,44µm	48
CH12	108,30µm	29	90,10µm	12	126,50µm	55
CH01	127,59µm	81	113,49µm	59	141,69µm	94
CH02	105,44µm	82	92,14µm	57	118,74µm	96
CH03	68,03µm	91	60,83µm	72	75,23µm	98
CH04	91,51µm	96	82,11µm	87	100,91µm	>99
CH05	100,31µm	50	88,11µm	26	112,51µm	70
CH06	143,25µm	60	128,65µm	38	157,85µm	82
CH07	122,08µm	28	108,08µm	13	136,08µm	49
CH08	60,71µm	42	52,31µm	18	69,11µm	64


Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	81,00µm	31	78,90µm	20	83,10µm	47
Grosor GCL+IPL mínimo	80,00µm	33	71,90µm	5	88,10µm	86

Fecha:	20-jul.-2026	Edad:	34		
Hora:	18:57	Intensidad señal:	9/10		

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	69,86µm	73	64,16µm	50	75,56µm	86
Grosor superior	112,04µm	31	102,34µm	12	121,74µm	55
Grosor nasal	73,88µm	64	67,58µm	42	80,18µm	84
Grosor inferior	124,93µm	50	116,13µm	30	133,73µm	74
CH09	62,77µm	86	57,77µm	79	67,77µm	94
CH10	76,48µm	48	66,58µm	19	86,38µm	75
CH11	105,40µm	17	92,00µm	5	118,80µm	32
CH12	113,77µm	39	95,57µm	17	131,97µm	63
CH01	116,95µm	65	102,85µm	37	131,05µm	84
CH02	98,46µm	72	85,16µm	43	111,76µm	90
CH03	58,66µm	62	51,46µm	31	65,86µm	86
CH04	64,53µm	52	55,13µm	22	73,93µm	75
CH05	99,50µm	48	87,30µm	25	111,70µm	70
CH06	140,57µm	58	125,97µm	34	155,17µm	78
CH07	134,72µm	47	120,72µm	27	148,72µm	72
CH08	70,34µm	66	61,94µm	45	78,74µm	86

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	82,00µm	37	79,90µm	24	84,10µm	53
Grosor GCL+IPL mínimo	81,00µm	41	72,90µm	7	89,10µm	88

⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales 

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.