Paciente: **PECH KU, GILMAR DAVID**


FDN: **26-jun.-1986**


Sexo: **Masculino**

ID: **21380**


OS Análisis de campo único — Central 30-2 Prueba de umbral


Monitor de fijación:	Mancha ciega	Estímulo:	III, Blanco	Fecha:	28-oct.-2026
Objetivo de fijación:	Central	Fondo:	31,5 asb	Hora:	17:10
Pérdidas de fijación:	0/20	Estrategia:	SITA Standard	Edad:	40
Errores falsos pos.:	0%	Diámetro de pupila:			
Errores falsos neg.:	26%	Agudeza visual:			
Duración:	08:55	Rx:	+1,50 DS -2,25 DC X 8		
Foveal:	20 dB				

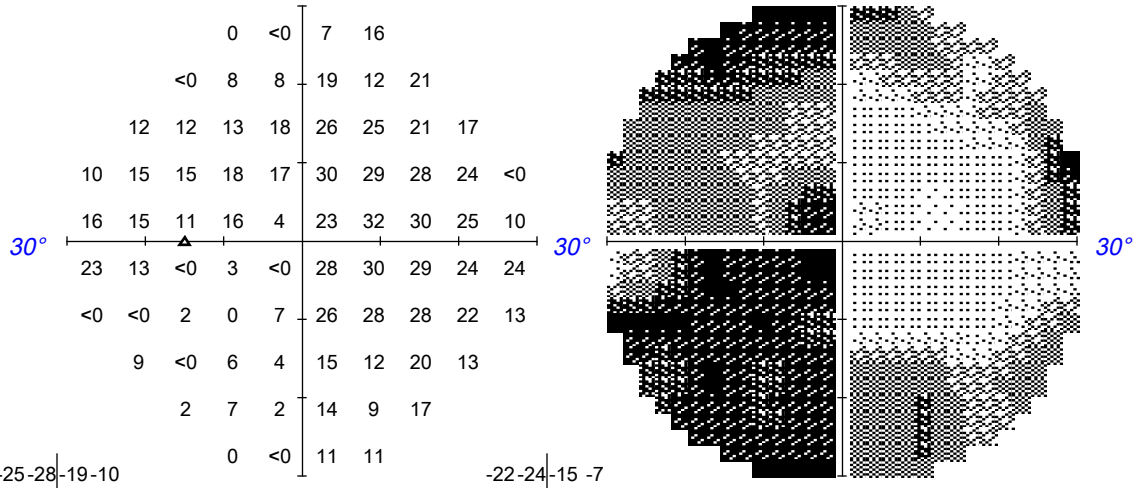

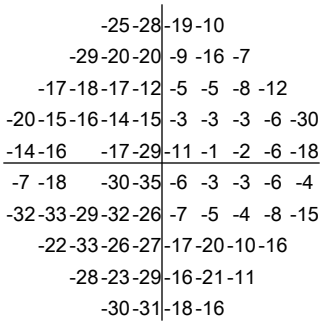


Desviación total

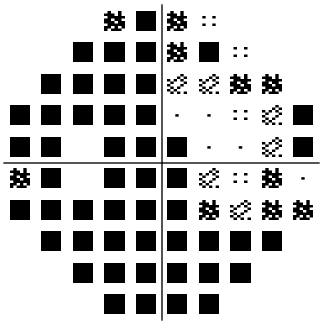

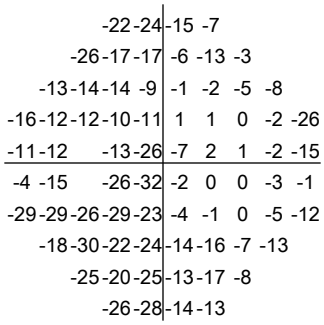

Desviación del modelo

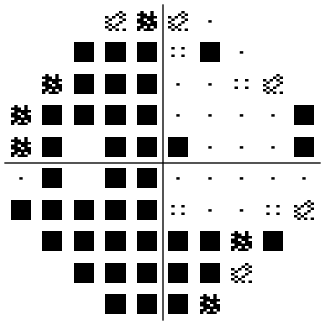

PHG: Fuera de límites normales

VFI24-2: 55%
MD30-2: -15,23 dB P < 0,5%
PSD30-2: 11,96 dB P < 0,5%

:: P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0,5%

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.