Paciente: **RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**

FDN: **08-feb.-1952**

Sexo: **Femenino**


ID: **9770**

OS Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

07-jun.-2019 SITA Standard — PHG: Fuera de límites normales — VFI24-2: **48%**


Foveal: **32 dB** — FL: **1/19** — FN: **33%** — FP: **0%**

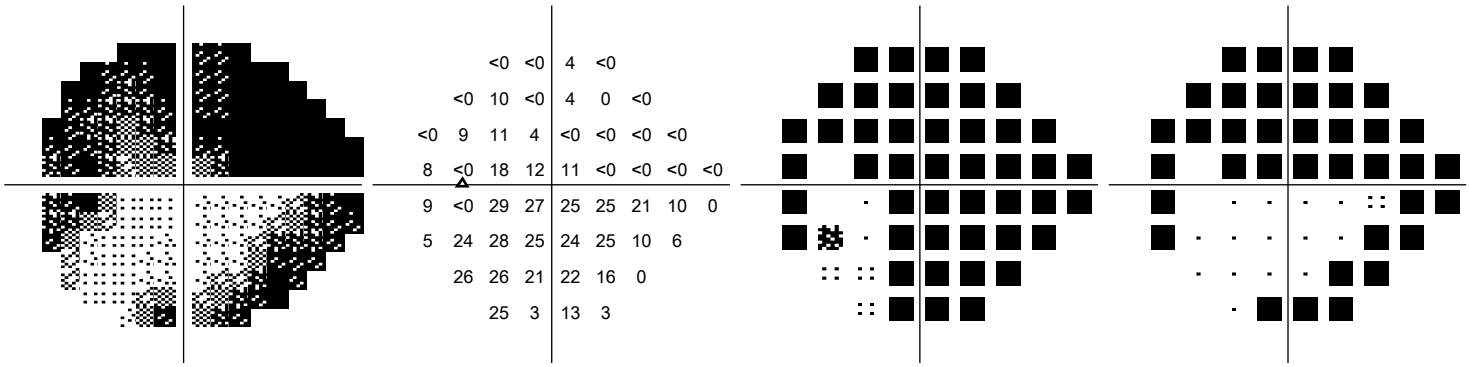

MD24-2: **-18,50 dB P < 0,5%** PSD24-2: **11,02 dB P < 0,5%**

07-jun.-2019 SITA Standard — PHG: Fuera de límites normales — VFI24-2: **19%**

Foveal: **31 dB** — FL: **0/14** — FN: **42%** — FP: **0%**

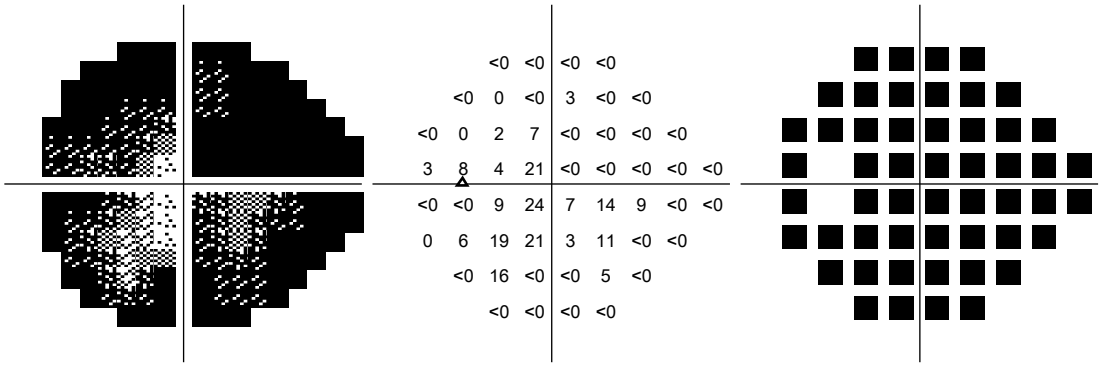


Se ha excedido el umbral MD. Consulte desviación total. Plantéese una prueba 10-2.

MD24-2: **-26,57 dB P < 0,5%** PSD24-2: **7,66 dB P < 0,5%**

07-jun.-2019 SITA Standard — PHG: Fuera de límites normales — VFI24-2: **34%**

Foveal: **31 dB** — FL: **0/14** — FN: **73%** — FP: **0%**

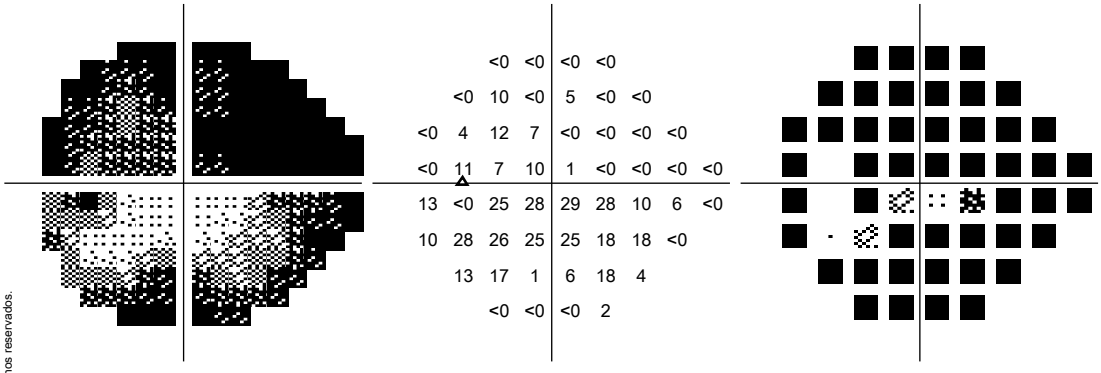

Se ha excedido el umbral MD. Consulte desviación total. Plantéese una prueba 10-2.

MD24-2: **-21,56 dB P < 0,5%** PSD24-2: **10,75 dB P < 0,5%**

:: P < 5% ▨ P < 2% ▩ P < 1% ■ P < 0,5%

Comentarios

Firma


© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**
FDN: **08-feb.-1952**
Sexo: **Femenino**
ID: **9770**

OS Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral


Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

27-ago.-2022 SITA Standard
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: **34 dB** FL: **0/16** FN: **0%** VFI24-2: **64%** FP: **1%**

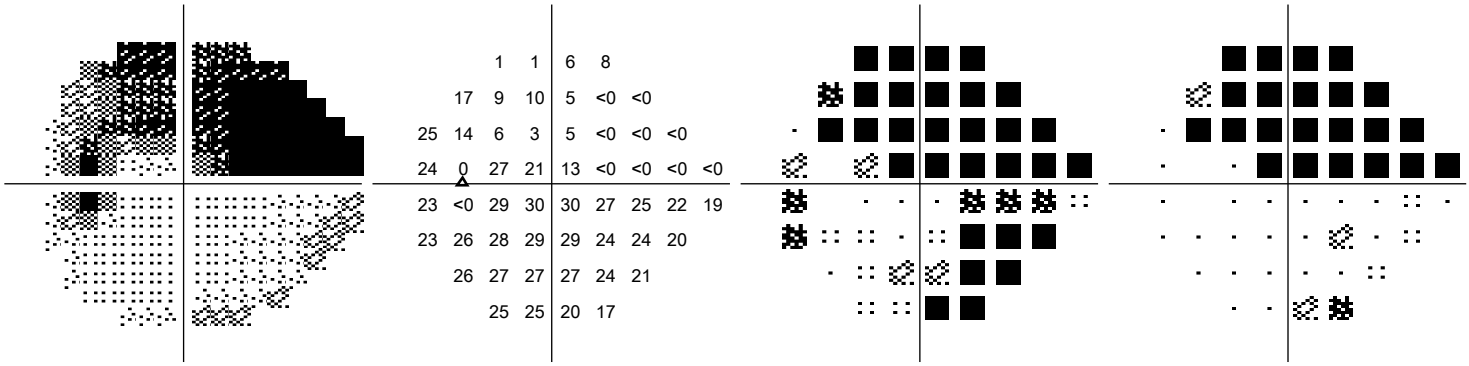


MD24-2: **-12,84 dB P < 0,5%** PSD24-2: **11,82 dB P < 0,5%**

29-nov.-2022 SITA Faster
*** Excesivos falsos positivos ***
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: **36 dB** FL: **0/0** FN: **11%** VFI24-2: **79%** FP: **23% XX**
4,3 mm *

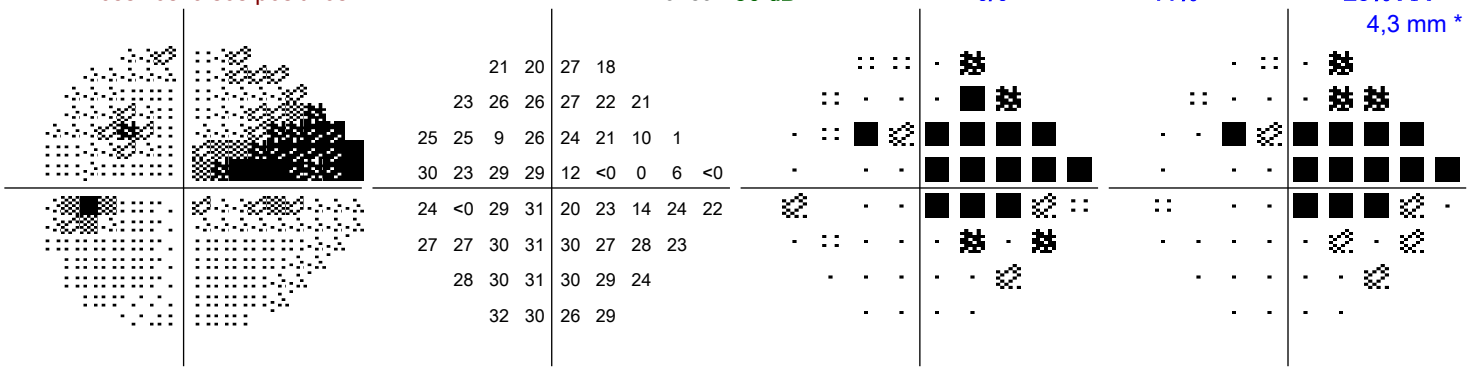

MD24-2: **-7,80 dB P < 0,5%** PSD24-2: **9,79 dB P < 0,5%**

29-nov.-2022 SITA Standard
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: **37 dB** FL: **2/17** FN: **0%** VFI24-2: **73%** FP: **1%**
4,2 mm *

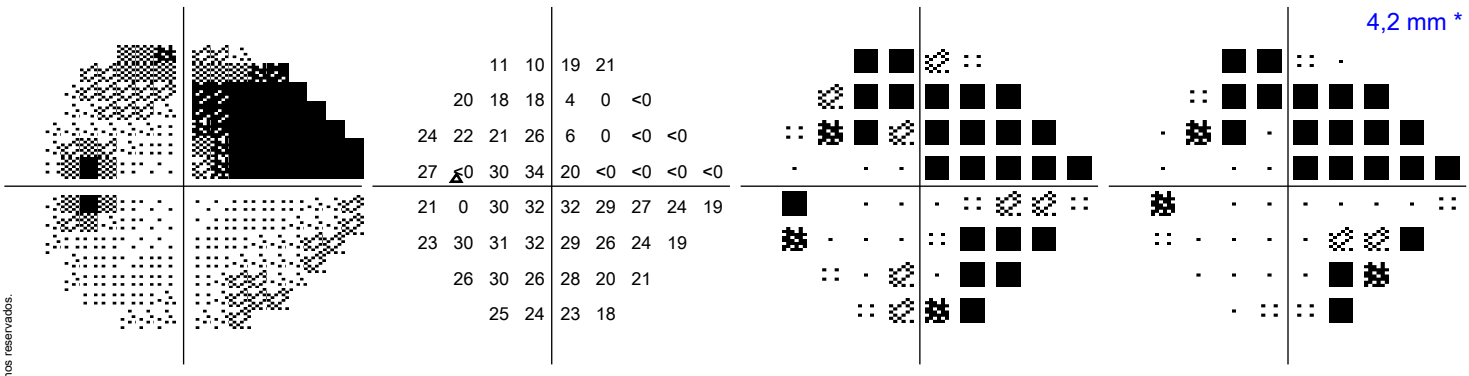

MD24-2: **-10,02 dB P < 0,5%** PSD24-2: **11,76 dB P < 0,5%**

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%


© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**
FDN: **08-feb.-1952**
Sexo: **Femenino**
ID: **9770**

OS Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral


Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

22-abr.-2023 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: **36 dB** FL: **2/12** FN: **0%** VFI24-2: **73%** FP: **3%**
4,9 mm *

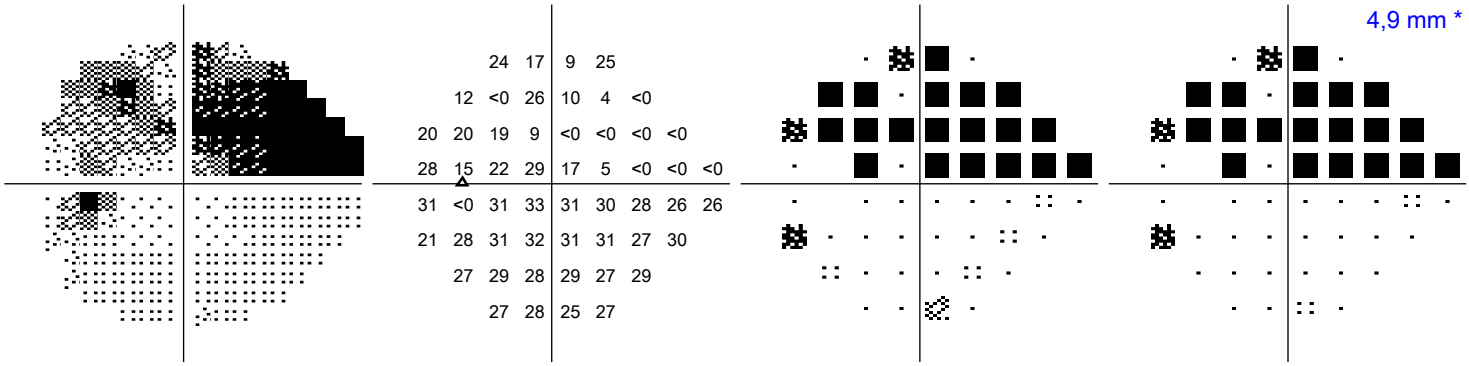


MD24-2: **-10,32 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,70 dB P < 0,5%**

23-ago.-2023 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: **36 dB** FL: **2/12** FN: **20%** VFI24-2: **78%** FP: **1%**
4,9 mm *

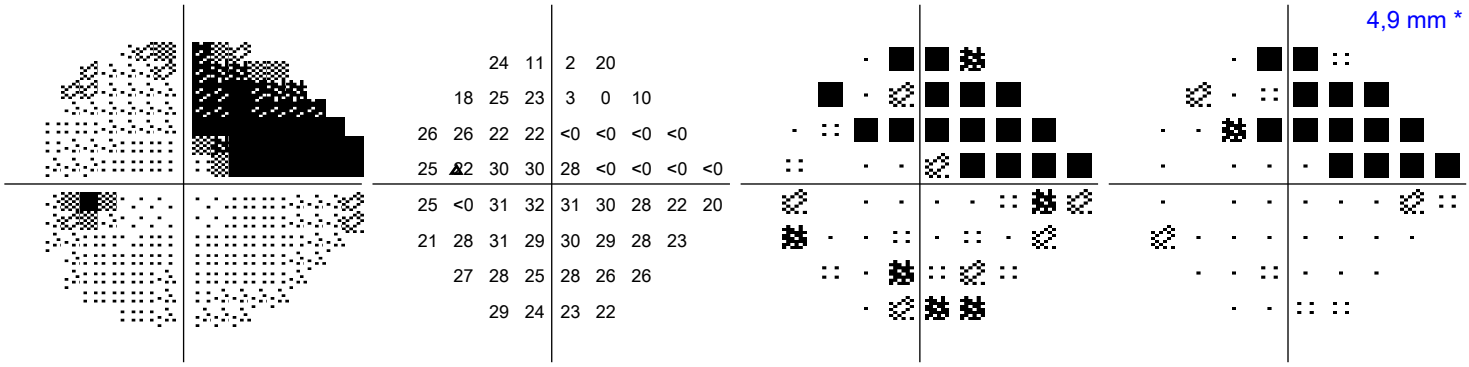

MD24-2: **-10,29 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,33 dB P < 0,5%**

23-ago.-2023 SITA Fast
*** Fiabilidad de la prueba baja ***
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: **35 dB** FL: **7/12 XX** FN: **0%** VFI24-2: **69%** FP: **0%**
4,3 mm *

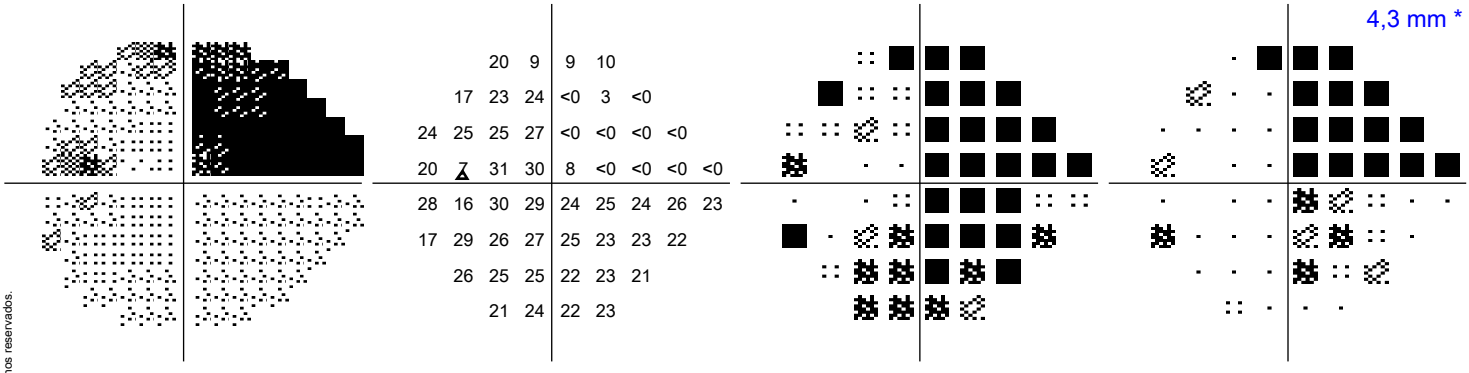

MD24-2: **-12,59 dB P < 0,5%** PSD24-2: **11,75 dB P < 0,5%**

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**

FDN: **08-feb.-1952**

Sexo: **Femenino**


ID: **9770**

OS Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

14-feb.-2024 SITA Fast


PHG: Fuera de límites normales | Foveal: **36 dB** | FL: **1/12** | FN: **9%** | VFI24-2: **72%** | FP: **1%** | **5,2 mm ***

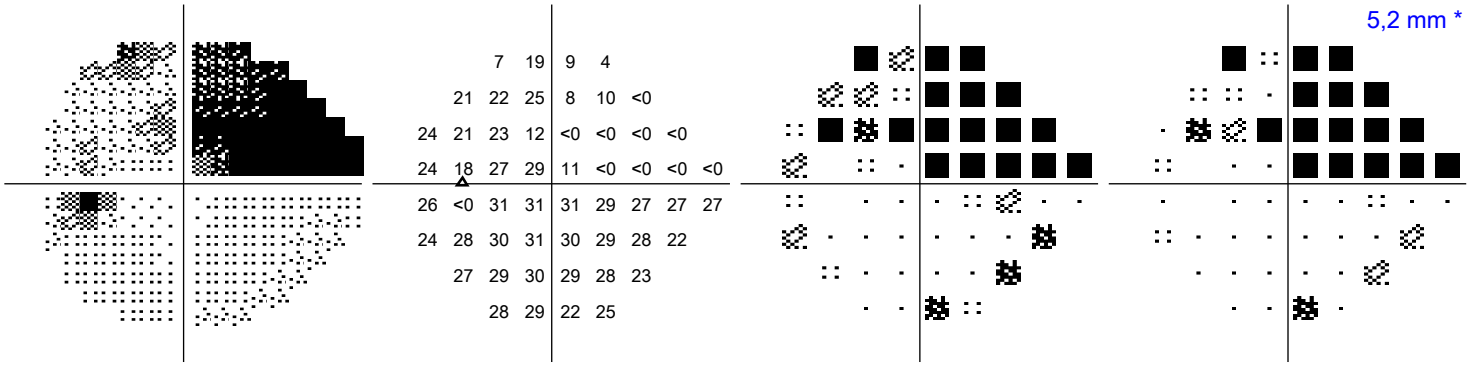

MD24-2: **-10,64 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,48 dB P < 0,5%**

19-nov.-2024 SITA Fast


PHG: Fuera de límites normales | Foveal: **36 dB** | FL: **1/14** | FN: **20%** | VFI24-2: **67%** | FP: **0%** | **4,0 mm ***

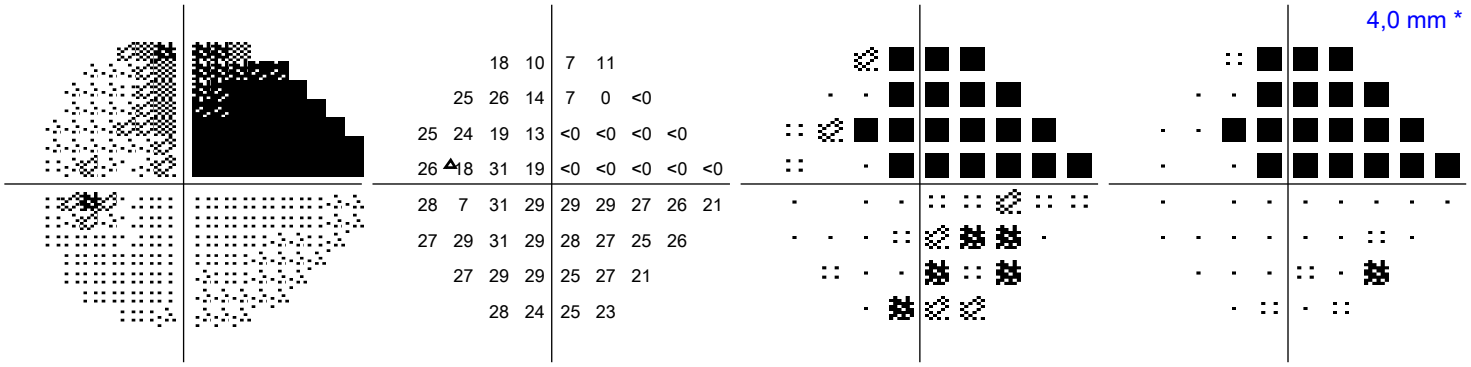

MD24-2: **-11,89 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,74 dB P < 0,5%**

19-nov.-2024 SITA Fast

PHG: Fuera de límites normales | Foveal: **33 dB** | FL: **1/12** | FN: **0%** | VFI24-2: **66%** | FP: **1%** | **5,1 mm ***

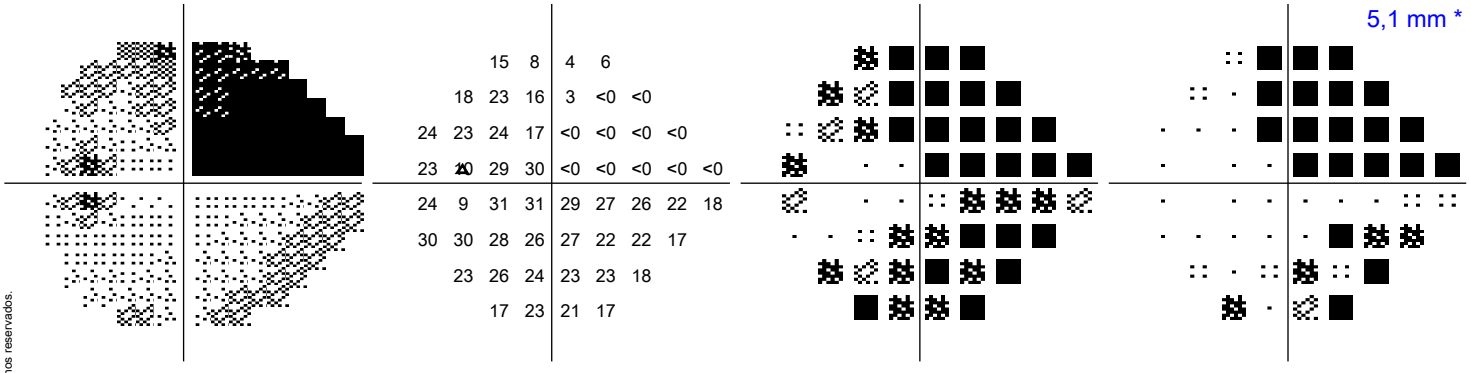

MD24-2: **-13,38 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,02 dB P < 0,5%**

:: P < 5% | P < 2% | P < 1% | P < 0,5%


© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**
FDN: **08-feb.-1952**
Sexo: **Femenino**
ID: **9770**

OS Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral


Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo

12-abr.-2025 SITA Fast
*** Fiabilidad de la prueba baja ***
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 38 dB FL: 3/12 XX FN: 0% FP: 1%
VFI24-2: 70%
4,3 mm *

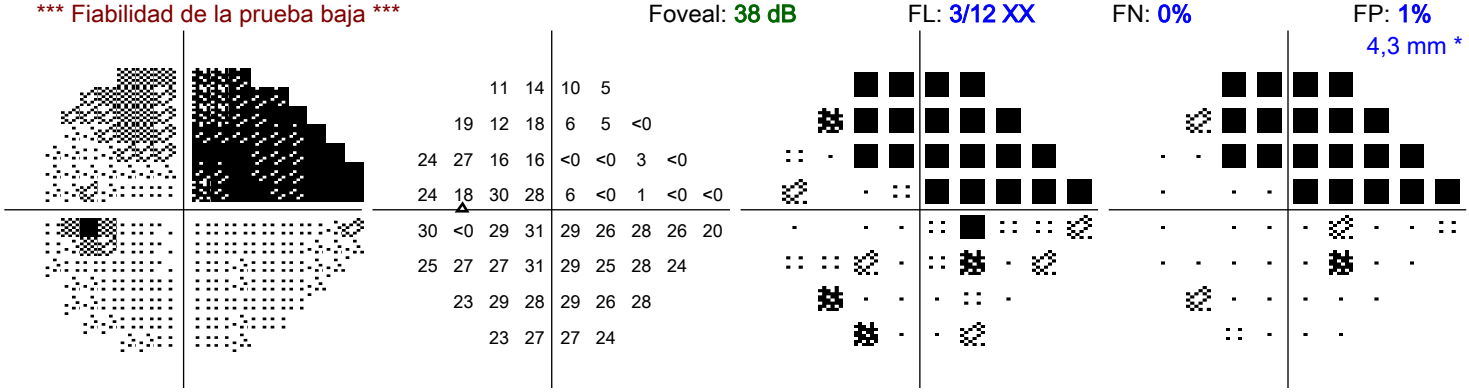


MD24-2: -11,32 dB P < 0,5% PSD24-2: 11,96 dB P < 0,5%

12-abr.-2025 SITA Fast
*** Fiabilidad de la prueba baja ***
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 37 dB FL: 3/13 XX FN: 0% FP: 0%
VFI24-2: 68%
3,9 mm *

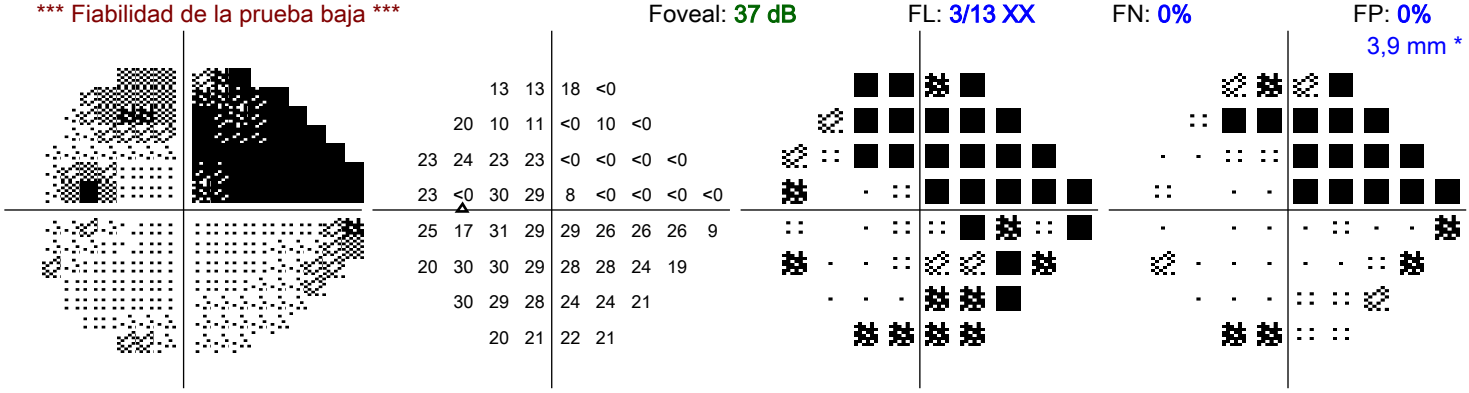

MD24-2: -12,39 dB P < 0,5% PSD24-2: 12,02 dB P < 0,5%

22-nov.-2025 SITA Fast
PHG: Fuera de límites normales
Foveal: 35 dB FL: 1/13 FN: 16% FP: 1%
VFI24-2: 66%
4,4 mm *

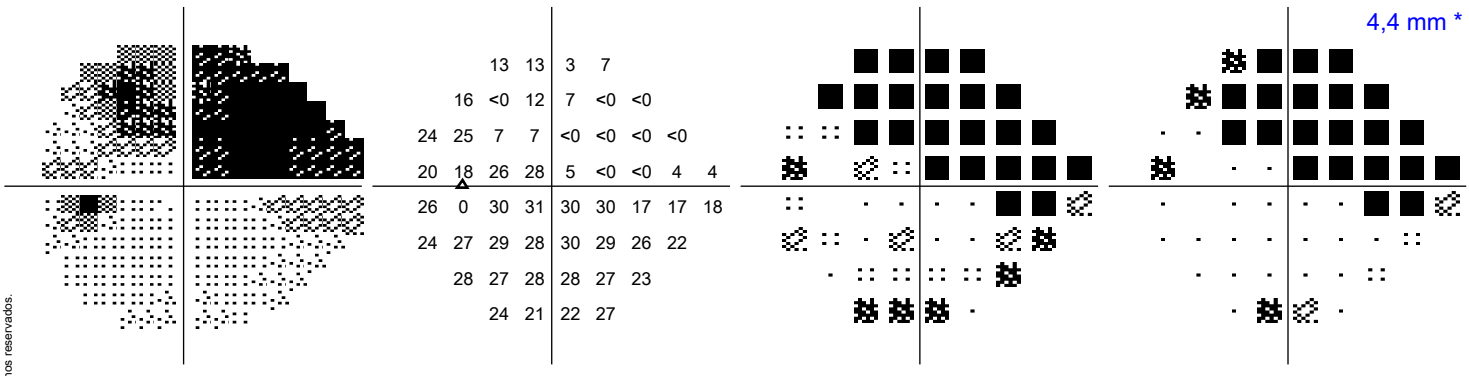

MD24-2: -13,06 dB P < 0,5% PSD24-2: 12,33 dB P < 0,5%

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: **RAVELL CARDENAS, ELVIRA ESPERANZA**

FDN: **08-feb.-1952**

Sexo: **Femenino**

ID: **9770**

OS Resumen — Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos grises | Umbral (dB) | Desviación total | Desviación del modelo


20-dic.-2025 SITA Fast

PHG: Fuera de límites normales

Foveal: **37 dB** FL: **0/12** VFI24-2: **70%**

FN: **9%** FP: **1%**

4,5 mm *

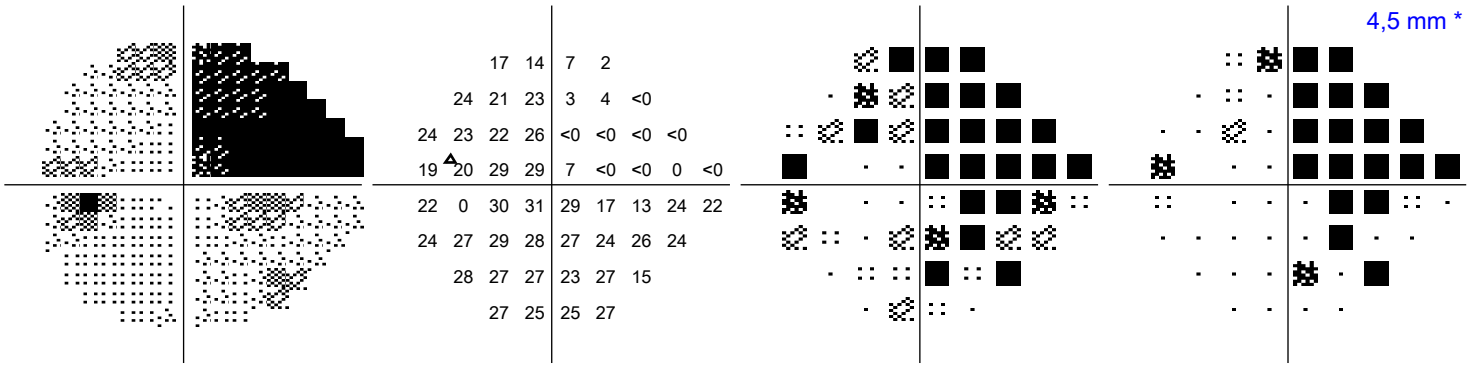


MD24-2: **-12,39 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,01 dB P < 0,5%**

10-jun.-2026 SITA Fast

PHG: Fuera de límites normales

Foveal: **38 dB** FL: **2/11** VFI24-2: **66%**

FN: **10%** FP: **0%**

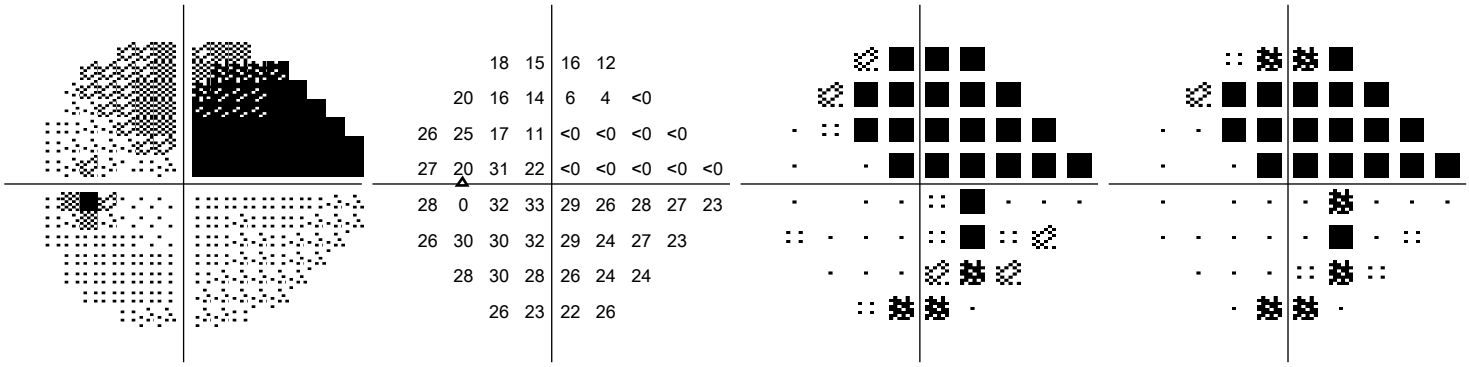

MD24-2: **-11,65 dB P < 0,5%** PSD24-2: **12,69 dB P < 0,5%**

:: P < 5% P < 2% P < 1% P < 0,5%

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.