Paciente: **VILLALOBOS LARA, MARIA EUGENIA**


Fecha de nacimiento: **11-nov.-1961**

Sexo: **Femenino**

N.º de paciente: **20420**

OD Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos de gris | Desviación total | Desviación modelo

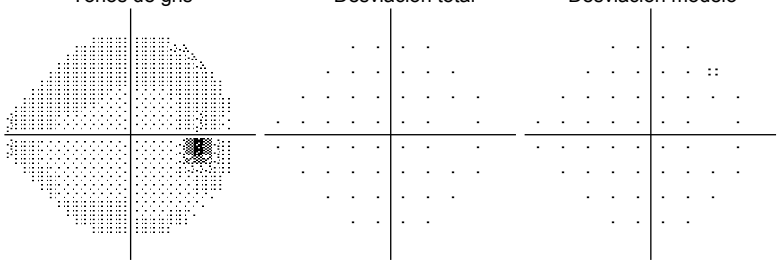



06-mar.-2026 **SITA-Fast**

FP: **16% XX**
FN: **0%**
FL: **2/10 XX**

VFI24-2: **100%**
MD24-2: **0,17 dB**
PSD24-2: **1,24 dB**
GHT: Dentro de límites normales


Estructura-función OU (examen único)



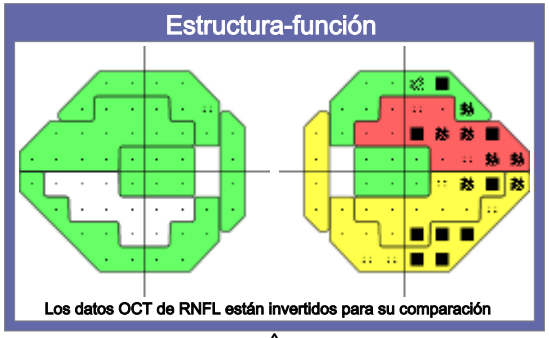

OS Central 24-2 Prueba de umbral

Tonos de gris | Desviación total | Desviación modelo

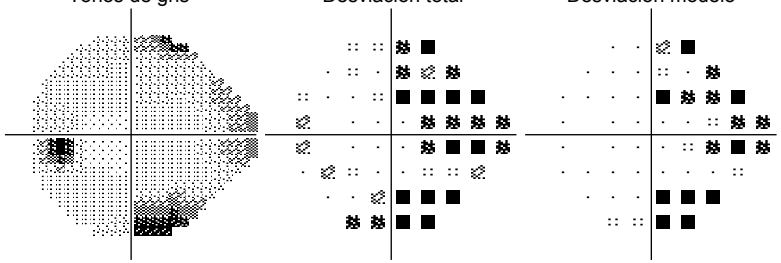


06-mar.-2026 **SITA-Fast**

FP: **2%**
FN: **17%**
FL: **2/10 XX**

VFI24-2: **89%**
MD24-2: **-5,95 dB P < 1%**
PSD24-2: **6,16 dB P < 0,5%**
GHT: Fuera de límites normales

OD CIRRUS HD-OCT


Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **10/10**



Cuadrantes de RNFL




Horas de reloj de RNFL



Intensidad señal: **10/10**



RNFL
06-mar.-2026



Células ganglionares
06-mar.-2026


Estructura-función

OD		OS
107µm	Grosor RNFL promedio	68µm
0,44	Proporción media C/D	0,69
1,50mm²	Zona anillo	0,95mm²
0,33	Proporción C/D vertical	0,64
0,086mm³	Volumen de Cup	0,222mm³
1,86mm²	Área de Disc	1,88mm²
88µm	Grosor medio de GCL+IPL promedio	78µm
84µm	Grosor GCL+IPL mínimo	69µm


Distribución de valores normales N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

OS CIRRUS HD-OCT


Cuadrantes de RNFL



Horas de reloj de RNFL




Mapa de grosor RNFL
Intensidad señal: **9/10**




Intensidad señal: **10/10**

Células ganglionares
06-mar.-2026



RNFL
06-mar.-2026



⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Comentarios

Firma

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: VILLALOBOS LARA, MARIA EUGENIA

Fecha de nacimiento: 11-nov.-1961

Sexo: Femenino


N.º de paciente: 20420

OD — Información detallada de los datos normativos — OS

Fecha:	06-mar.-2026	Edad:	64		
Hora:	11:59	Intensidad señal:	10/10		

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,44	86	0,37	93	0,51	70
Zona anillo	1,50mm²	84	1,33mm²	62	1,67mm²	97
Proporción C/D vertical	0,33	>99	0,25	>99	0,42	89
Volumen de Cup	0,09mm³	75	0,06mm³	84	0,11mm³	67


Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	107,16µm	98	103,36µm	95	110,96µm	>99
Zona 1	135,65	90	123,56	77	147,74	98
Zona 2	158,74	93	146,34	80	171,13	>99
Zona 3	105,06	51	93,65	33	116,47	72
Zona 4	159,02	>99	148,10	93	169,93	>99
Zona 5	93,23	95	86,42	87	100,05	>99
Zona 6	66,57	72	62,63	59	70,51	82



Fecha:	06-mar.-2026	Edad:	64		
Hora:	12:02	Intensidad señal:	9/10		

Parámetros de ONH	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Proporción media C/D	0,69	5	0,63	22	0,76	<1
Zona anillo	0,95mm²	3	0,78mm²	<1	1,13mm²	21
Proporción C/D vertical	0,64	9	0,56	45	0,73	<1
Volumen de Cup	0,22mm³	27	0,19mm³	39	0,25mm³	23

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor RNFL promedio	67,98µm	<1	64,18µm	<1	71,78µm	3
Zona 1	91,48	30	79,39	14	103,57	51
Zona 2	74,17	<1	61,77	<1	86,57	2
Zona 3	69,42	5	58,01	<1	80,84	16
Zona 4	76,48	2	65,57	<1	87,39	5
Zona 5	53,23	4	46,41	<1	60,05	14
Zona 6	68,48	77	64,55	67	72,42	86



⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales: N. d. | 95 % | 5 % | 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.

Paciente: VILLALOBOS LARA, MARIA EUGENIA

Fecha de nacimiento: 11-nov.-1961

Sexo: Femenino

N.º de paciente: 20420

Información detallada de los datos normativos

OD

Fecha: 06-mar.-2026 Edad: 64

Hora: 11:59 Intensidad señal: 10/10

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	67,24µm	73	61,54µm	51	72,94µm	86
Grosor superior	130,38µm	89	120,68µm	70	140,08µm	96
Grosor nasal	87,26µm	96	80,96µm	91	93,56µm	>99
Grosor inferior	143,77µm	97	134,97µm	89	152,57µm	>99
CH09	50,22µm	55	45,22µm	31	55,22µm	76
CH10	88,69µm	86	78,79µm	69	98,59µm	95
CH11	164,76µm	98	151,36µm	93	178,16µm	>99
CH12	112,18µm	47	93,98µm	23	130,38µm	72
CH01	114,22µm	73	100,12µm	52	128,32µm	90
CH02	119,98µm	98	106,68µm	92	133,28µm	>99
CH03	67,53µm	91	60,33µm	70	74,73µm	97
CH04	74,26µm	79	64,86µm	56	83,66µm	91
CH05	117,96µm	88	105,76µm	73	130,16µm	97
CH06	170,73µm	96	156,13µm	89	185,33µm	>99
CH07	142,61µm	77	128,61µm	53	156,61µm	92
CH08	62,81µm	57	54,41µm	32	71,21µm	77

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	88,00µm	92	85,90µm	86	90,10µm	96
Grosor GCL+IPL mínimo	84,00µm	87	75,90µm	35	92,10µm	>99

OS

Fecha: 06-mar.-2026 Edad: 64

Hora: 12:02 Intensidad señal: 9/10

Parámetros de RNFL	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor temporal	68,61µm	77	62,91µm	58	74,31µm	87
Grosor superior	72,63µm	<1	62,93µm	<1	82,33µm	<1
Grosor nasal	49,36µm	4	43,06µm	2	55,66µm	17
Grosor inferior	81,31µm	<1	72,51µm	<1	90,11µm	5
CH09	56,65µm	79	51,65µm	65	61,65µm	86
CH10	90,91µm	89	81,01µm	74	100,81µm	95
CH11	76,92µm	3	63,52µm	<1	90,32µm	6
CH12	60,13µm	<1	41,93µm	<1	78,33µm	9
CH01	80,85µm	15	66,75µm	3	94,95µm	38
CH02	57,52µm	9	44,22µm	2	70,82µm	29
CH03	44,19µm	8	36,99µm	<1	51,39µm	31
CH04	46,37µm	8	36,97µm	<1	55,77µm	28
CH05	75,37µm	21	63,17µm	5	87,57µm	44
CH06	96,37µm	11	81,77µm	2	110,97µm	27
CH07	72,18µm	2	58,18µm	<1	86,18µm	5
CH08	58,27µm	42	49,87µm	20	66,67µm	65

Parámetros de GCA	Valor	Valor de percentil	Valor menos límite de reproducibilidad	Valor de percentil	Valor más límite de reproducibilidad	Valor de percentil
Grosor medio de GCL+IPL promedio	78,00µm	40	75,90µm	25	80,10µm	54
Grosor GCL+IPL mínimo	69,00µm	8	60,90µm	<1	77,10µm	44

⚠ Un parámetro, por lo menos, está próximo al umbral normativo y en caso de repetir la exploración puede causar un cambio en la codificación cromática.

Distribución de valores normales N. d. 95 % 5 % 1 %

© 2019 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados.