CÁLCULO DE IOL

Paciente	**PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	14/ene./1957		
Sexo	Femenino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	1572		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **14/abr./2026** Fecha verif. calibración: **14/abr./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Seudofáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD						OS					
AL	**22.27 mm**		WTW	11.5 mm		**AL**	**22.54 mm**		WTW	11.5 mm	
ACD	3.03 mm		Pupila	3.5 mm		ACD	4.48 mm		Pupila	3.8 mm	
LT	4.90 mm		Ix / Iy	+0.4 mm	/+0.0 mm	LT	0.73 mm		Ix / Iy	+0.2 mm	/ -0.3 mm
CCT	493 µm		Kappa	0.3 mm	@ 179°	CCT	508 µm		Kappa	0.6 mm	@ 121°
Ast. K	**-1.20 D**	**@ 87°**	**Ast. TK**	**-1.45 D**	**@ 86°**	**Ast. K**	**-1.06 D**	**@ 122°**	**Ast. TK**	**---**	
Avg. K	45.49 D	(!)	Avg. TK	45.44 D	(!)	Avg. K	45.72 D	(!)	Avg. TK	---	
K1	44.89 D	@ 87°	TK1	44.73 D	@ 86°	K1	45.20 D	@ 122°	TK1	---	
K2	46.09 D	@ 177°	TK2	46.17 D	@ 176°	K2	46.26 D	@ 32°	TK2	---	

CÁLCULO DE IOL

⟅ ⟆ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.70
+22.50	-0.32
+22.00	**+0.05**
+21.50	+0.42
+22.07	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+24.50	-0.89
+24.00	-0.53
+23.50	**-0.17**
+23.00	+0.19
+23.26	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+24.50	-0.81
+24.00	-0.45
+23.50	**-0.09**
+23.00	+0.27
+23.38	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+25.50	-0.87
+25.00	-0.52
+24.50	**-0.17**
+24.00	+0.17
+24.25	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+25.00	-0.86
+24.50	-0.50
+24.00	**-0.15**
+23.50	+0.20
+23.78	0.00

LF +2.06 DF +5.0

Akreos Adapt

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.59
+23.00	-0.22
+22.50	**+0.14**
+22.00	+0.50
+22.70	0.00

LF +1.57 DF +5.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.61
+23.50	-0.25
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.46
+23.16	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.88
+23.50	-0.51
+23.00	**-0.14**
+22.50	+0.22
+22.80	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+25.00	-0.81
+24.50	-0.45
+24.00	**-0.10**
+23.50	+0.25
+23.86	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	14/ene./1957		
Sexo	Femenino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	1572		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **14/abr./2026** Fecha verif. calibración: **14/abr./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — CÁLCULO DE IOL — izquierdo OS

Clareon PanOptix CNW
TT0


Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+24.50	-0.71
+24.00	-0.35
+23.50	**+0.01**
+23.00	+0.36
+23.51	0.00

LF +1.94 DF +5.0

AT TORBI 709MP


Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+23.00	-0.88			
+22.50	-0.51		**2.00**	**-0.18 @ 92°**
+22.00	**-0.14**			
+21.50	+0.22			
---	0.00	2°	2.16	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
+23.00	-0.88			
+22.50	-0.51		**2.00**	**-0.18 @ 92°**
+22.00	**-0.14**			
+21.50	+0.22			
---	0.00	2°	2.16	0.00

LF +1.62 DF +0.0

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE**	**Clinica MEDYTEC**	
Fecha de nacimie...	14/ene./1957		
Sexo	Femenino		
ID paciente	1572	**Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida**	
Médico	Surgeon	**999 926 8619**	
		info@clinicamedytec.com	

Fecha de la medición **14/abr./2026** Fecha verif. calibración: **14/abr./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS


OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Seudofáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente


OD derecho					OS izquierdo				
AL	**22.27 mm**	SD 10 µm	WTW	11.5 mm	**AL**	**22.54 mm**	SD 8 µm	WTW	11.5 mm
ACD	3.03 mm	SD 7 µm	Pupila	3.5 mm	ACD	4.48 mm	SD 11 µm	Pupila	3.8 mm
LT	4.90 mm	SD 10 µm	Ix / Iy	+0.4 mm / +0.0 mm	LT	0.73 mm	SD 16 µm	Ix / Iy	+0.2 mm / -0.3 mm
CCT	493 µm	SD 3 µm	Kappa	0.3 mm @ 179 °	CCT	508 µm	SD 3 µm	Kappa	0.6 mm @ 121 °
Ast. K	**-1.20 D @ 87°**				**Ast. K**	**-1.06 D @ 122°**			
Avg. K	45.49 D	(!)	SD 0.03 D		Avg. K	45.72 D	(!)	SD 0.06 D	
K1	44.89 D @ 87°		SD 0.04 D		K1	45.20 D @ 122°		SD 0.04 D	
K2	46.09 D @ 177°		SD 0.05 D		K2	46.26 D @ 32°		SD 0.08 D	
Ast. TK	**-1.45 D @ 86°**				**Ast. TK**	**---**			
Avg. TK	45.44 D	(!)	SD 0.03 D		Avg. TK	---			
TK1	44.73 D @ 86°		SD 0.08 D		TK1	---			
TK2	46.17 D @ 176°		SD 0.06 D		TK2	---			

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

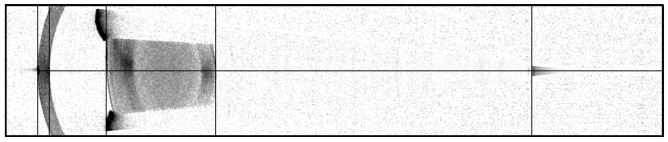


TOTAL AXIAL POWER (!)

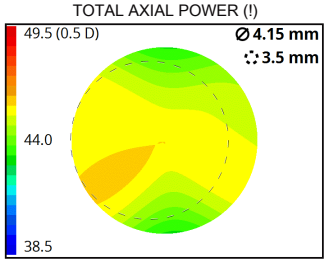


Ast. TK
-1.45 D @ 86°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

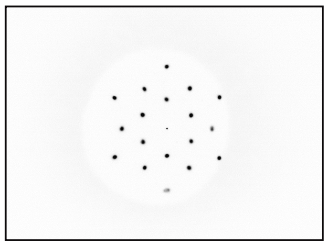

BLANCO-A-BLANCO

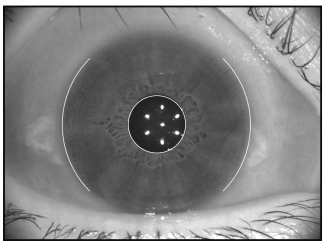


ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

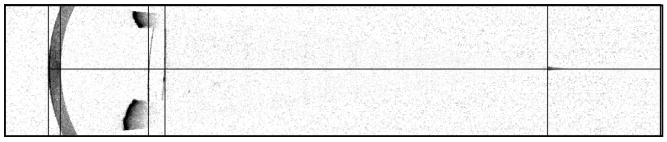


Central Topography

Error de medición


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

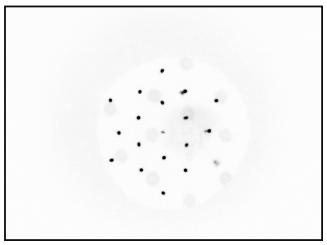

BLANCO-A-BLANCO

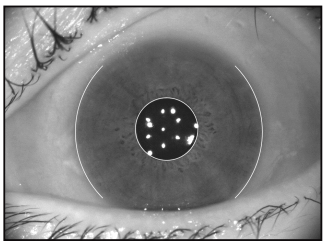

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE
Fecha de nacim.	14/ene./1957
Sexo	Femenino
ID del paciente	1572
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado — Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D — SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	22.27 mm	SD:	10 µm				
ACD:	3.03 mm	SD:	7 µm				
LT:	4.90 mm	SD:	10 µm				
WTW:	11.5 mm						
SE:	45.49 D	(!) SD:	0.03 D	K1:	44.89 D	@	87°
ΔK:	-1.20 D	@	87°	K2:	46.09 D	@	177°
TSE:	45.44 D	(!) SD:	0.03 D	TK1:	44.73 D	@	86°
ΔTK:	-1.45 D	@	86°	TK2:	46.17 D	@	176°

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.70
+22.50	-0.32
+22.00	**+0.05**
+21.50	+0.42
+21.00	+0.78
+22.07	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.89
+24.00	-0.53
+23.50	**-0.17**
+23.00	+0.19
+22.50	+0.54
+23.26	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.81
+24.00	-0.45
+23.50	**-0.09**
+23.00	+0.27
+22.50	+0.62
+23.38	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+25.50	-0.87
+25.00	-0.52
+24.50	**-0.17**
+24.00	+0.17
+23.50	+0.51
+24.25	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado — Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D — SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	22.54 mm	SD:	8 µm				
ACD:	4.48 mm	SD:	11 µm				
LT:	0.73 mm	SD:	16 µm				
WTW:	11.5 mm						
SE:	45.72 D	(!) SD:	0.06 D	K1:	45.20 D	@	122°
ΔK:	-1.06 D	@	122°	K2:	46.26 D	@	32°
TSE:	---			TK1:	---		
ΔTK:	---			TK2:	---		

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE
Fecha de nacim.	14/ene./1957
Sexo	Femenino
ID del paciente	1572
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Seudofáquico
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD		OS	
AL:	22.27 mm	SD: 10 µm	22.54 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.03 mm	SD: 7 µm	4.48 mm	SD: 11 µm
LT:	4.90 mm	SD: 10 µm	0.73 mm	SD: 16 µm
WTW:	11.5 mm		11.5 mm	
SE:	45.49 D	(!) SD: 0.03 D	45.72 D	(!) SD: 0.06 D
K1:	44.89 D @ 87°		45.20 D @122°	
ΔK:	-1.20 D @ 87°		-1.06 D @122°	
K2:	46.09 D @177°		46.26 D @ 32°	
TSE:	45.44 D	(!) SD: 0.03 D	---	
TK1:	44.73 D @ 86°		---	
ΔTK:	-1.45 D @ 86°		---	
TK2:	46.17 D @176°		---	

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.86
+24.50	-0.50
+24.00	**-0.15**
+23.50	+0.20
+23.00	+0.54
+23.78	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.57 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.59
+23.00	-0.22
+22.50	**+0.14**
+22.00	+0.50
+21.50	+0.86
+22.70	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.61
+23.50	-0.25
+23.00	**+0.11**
+22.50	+0.46
+22.00	+0.81
+23.16	Emetropía

TK HOYA 250

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.88
+23.50	-0.51
+23.00	**-0.14**
+22.50	+0.22
+22.00	+0.58
+22.80	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE		
Fecha de nacim.	14/ene./1957	Sexo	Femenino
ID del paciente	1572		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Seudofáquico
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD		OS	
AL:	22.27 mm	SD: 10 µm	22.54 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.03 mm	SD: 7 µm	4.48 mm	SD: 11 µm
LT:	4.90 mm	SD: 10 µm	0.73 mm	SD: 16 µm
WTW:	11.5 mm		11.5 mm	
SE:	45.49 D	(!) SD: 0.03 D	45.72 D	(!) SD: 0.06 D
K1:	44.89 D @ 87°		45.20 D @122°	
ΔK:	-1.20 D @ 87°		-1.06 D @122°	
K2:	46.09 D @177°		46.26 D @ 32°	
TSE:	45.44 D	(!) SD: 0.03 D	---	
TK1:	44.73 D @ 86°		---	
ΔTK:	-1.45 D @ 86°		---	
TK2:	46.17 D @176°		---	

TK PhysIOL ISOPURE 123

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+25.00	-0.81
+24.50	-0.45
+24.00	**-0.10**
+23.50	+0.25
+23.00	+0.59
+23.86	Emetropía

TK Alcon Clareon PanOptix CNW TT0

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.94 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+24.50	-0.71
+24.00	-0.35
+23.50	**+0.01**
+23.00	+0.36
+22.50	+0.71
+23.51	Emetropía

TK ZEISS AT TORBI 709MP

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+24.00	+2.00	2°	-0.88	-0.79	-0.17	92°
+23.50	+2.00	2°	-0.51	-0.42	-0.17	92°
+23.00	**+2.00**	**2°**	**-0.14**	**-0.05**	**-0.18**	**92°**
+22.50	+2.00	2°	+0.22	+0.31	-0.18	92°
+22.00	+2.00	2°	+0.58	+0.67	-0.18	92°
---	+2.16	2°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE		
Fecha de nacim.	14/ene./1957	Sexo	Femenino
ID del paciente	1572		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Seudofáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 22.27 mm SD: 10 µm	AL: 22.54 mm SD: 8 µm
ACD: 3.03 mm SD: 7 µm	ACD: 4.48 mm SD: 11 µm
LT: 4.90 mm SD: 10 µm	LT: 0.73 mm SD: 16 µm
WTW: 11.5 mm	WTW: 11.5 mm
SE: 45.49 D (!) SD: 0.03 D K1: 44.89 D @ 87°	SE: 45.72 D (!) SD: 0.06 D K1: 45.20 D @122°
ΔK: -1.20 D @ 87° K2: 46.09 D @177°	ΔK: -1.06 D @122° K2: 46.26 D @ 32°
TSE: 45.44 D (!) SD: 0.03 D TK1: 44.73 D @ 86°	TSE: --- TK1: ---
ΔTK: -1.45 D @ 86° TK2: 46.17 D @176°	ΔTK: --- TK2: ---

TK ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+24.00	+2.00	2°	-0.88	-0.79	-0.17	92°
+23.50	+2.00	2°	-0.51	-0.42	-0.17	92°
+23.00	**+2.00**	**2°**	**-0.14**	**-0.05**	**-0.18**	**92°**
+22.50	+2.00	2°	+0.22	+0.31	-0.18	92°
+22.00	+2.00	2°	+0.58	+0.67	-0.18	92°
---	+2.16	2°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE		
Fecha de nacim.	14/ene./1957	Sexo	Femenino
ID del paciente	1572		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	22.27 mm	SD:	10 µm	WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.4 mm
CCT:	493 µm	SD:	3 µm	P:	3.5 mm	Iy:	+0.0 mm
ACD:	3.03 mm	SD:	7 µm	CW-chord:	0.3 mm @ 179°		
LT:	4.90 mm	SD:	10 µm				


SE:	45.49 D	(!)	SD: 0.03 D	TSE:	45.44 D	(!)	SD: 0.03 D
K1:	44.89 D	@ 87°	SD: 0.04 D	TK1:	44.73 D	@ 86°	SD: 0.08 D
K2:	46.09 D	@ 177°	SD: 0.05 D	TK2:	46.17 D	@ 176°	SD: 0.06 D
ΔK:	-1.20 D	@ 87°		ΔTK:	-1.45 D	@ 86°	

Scan B

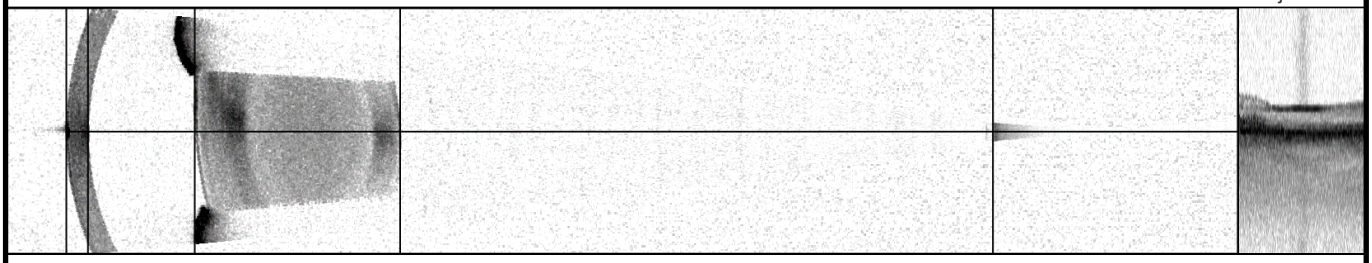


Fijación


Total Axial Power (!)

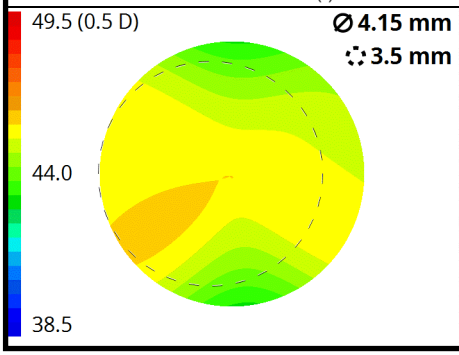

Queratometría

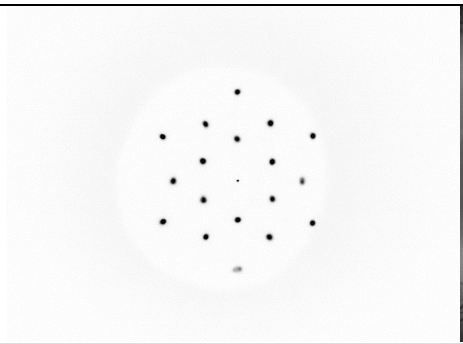

Blanco a blanco

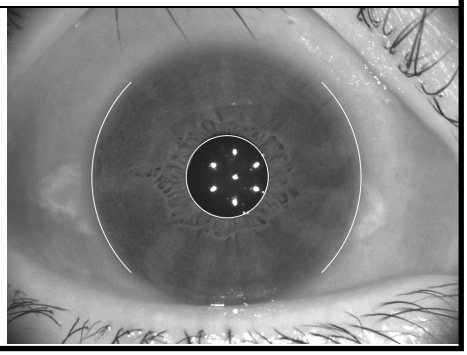

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE		
Fecha de nacim.	14/ene./1957	Sexo	Femenino
ID del paciente	1572		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	22.54 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.2 mm
CCT:	508 µm	SD:	3 µm	P:	3.8 mm	Iy:	-0.3 mm
ACD:	4.48 mm	SD:	11 µm			CW-chord:	0.6 mm @ 121°
LT:	0.73 mm	SD:	16 µm				

SE:	45.72 D (!)	SD:	0.06 D	TSE:	---
K1:	45.20 D @ 122°	SD:	0.04 D	TK1:	---
K2:	46.26 D @ 32°	SD:	0.08 D	TK2:	---
ΔK:	-1.06 D @ 122°			ΔTK:	---

Scan B

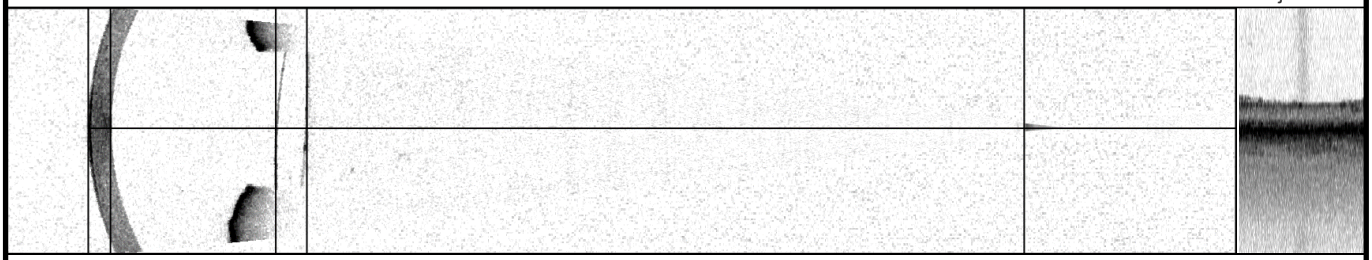


Fijación


Central Topography

Error de medición

Queratometría

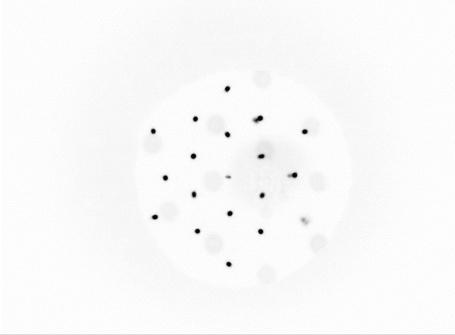

Blanco a blanco

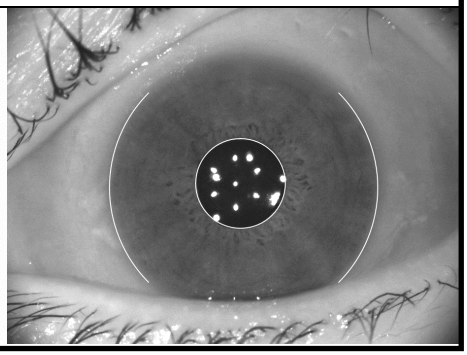

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE		
Fecha de nacim.	14/ene./1957	Sexo	Femenino
ID del paciente	1572		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica VS: Humor vítreo	LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **22.27** mm SD: 10 µm	AL: **22.54** mm SD: 8 µm
CCT: **493** µm SD: 3 µm	CCT: **508** µm SD: 3 µm
ACD: **3.03** mm SD: 7 µm	ACD: **4.48** mm SD: 11 µm
LT: **4.90** mm SD: 10 µm	LT: **0.73** mm SD: 16 µm

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
22.27 mm	494 µm	3.03 mm	4.90 mm	22.54 mm	507 µm	4.48 mm	0.73 mm
22.27 mm	492 µm	3.03 mm	4.89 mm	22.54 mm	510 µm	4.48 mm	0.72 mm
22.26 mm	491 µm	3.03 mm	4.90 mm	22.54 mm	504 µm	4.47 mm	0.73 mm
22.27 mm	492 µm	3.03 mm	4.90 mm	22.53 mm	506 µm	4.48 mm	0.72 mm
22.27 mm	497 µm	3.03 mm	4.90 mm	22.55 mm	511 µm	4.49 mm	0.73 mm
22.26 mm	491 µm	3.02 mm	4.90 mm	22.54 mm	511 µm	4.49 mm	0.73 mm

Valores de la córnea	
SE: **45.49** D (!) SD: 0.03 D	SE: **45.72** D (!) SD: 0.06 D
K1: **44.89** D @ **87°** SD: 0.04 D	K1: **45.20** D @ **122°** SD: 0.04 D
K2: **46.09** D @ **177°** SD: 0.05 D	K2: **46.26** D @ **32°** SD: 0.08 D
ΔK: **-1.20** D @ **87°**	ΔK: **-1.06** D @ **122°**
SE: 45.48 D ΔK: -1.19 D @ 87°	SE: --- ΔK: ---
SE: 45.49 D ΔK: -1.22 D @ 87°	SE: 45.86 D ΔK: -1.44 D @ 117°
SE: 45.47 D ΔK: -1.20 D @ 86°	SE: 45.52 D ΔK: -0.98 D @ 151°
TSE: **45.44** D (!) SD: 0.03 D	TSE: **---**
TK1: **44.73** D @ **86°** SD: 0.08 D	TK1: **---**
TK2: **46.17** D @ **176°** SD: 0.06 D	TK2: **---**
ΔTK: **-1.45** D @ **86°**	ΔTK: **---**
TSE: 45.42 D ΔTK: -1.60 D @ 90°	TSE: --- ΔTK: ---
TSE: 45.47 D ΔTK: -1.38 D @ 85°	TSE: --- ΔTK: ---
TSE: 45.42 D ΔTK: -1.36 D @ 86°	TSE: --- ΔTK: ---
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 11.5 mm lx: +0.4 mm ly: +0.0 mm	WTW: 11.5 mm lx: +0.2 mm ly: -0.3 mm
P: 3.5 mm CW-chord: 0.3 mm @ 179°	P: 3.8 mm CW-chord: 0.6 mm @ 121°
Se ha guardado la imagen (!)	Se ha guardado la imagen (!)

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE
Fecha de nacim.	14/ene./1957
Sexo	Femenino
ID del paciente	1572
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD derecho


Reference Image

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	22.27 mm			SE:	45.49 D	(!)	TSE:	45.44 D	(!)
ACD:	3.03 mm			K1:	44.89 D	@ 87°	TK1:	44.73 D	@ 86°
LT:	4.90 mm			K2:	46.09 D	@ 177°	TK2:	46.17 D	@ 176°
WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.4 mm	ΔK:	-1.20 D	@ 87°	ΔTK:	-1.45 D	@ 86°
P:	3.5 mm	CW-chord:	0.3 mm @ 179°						

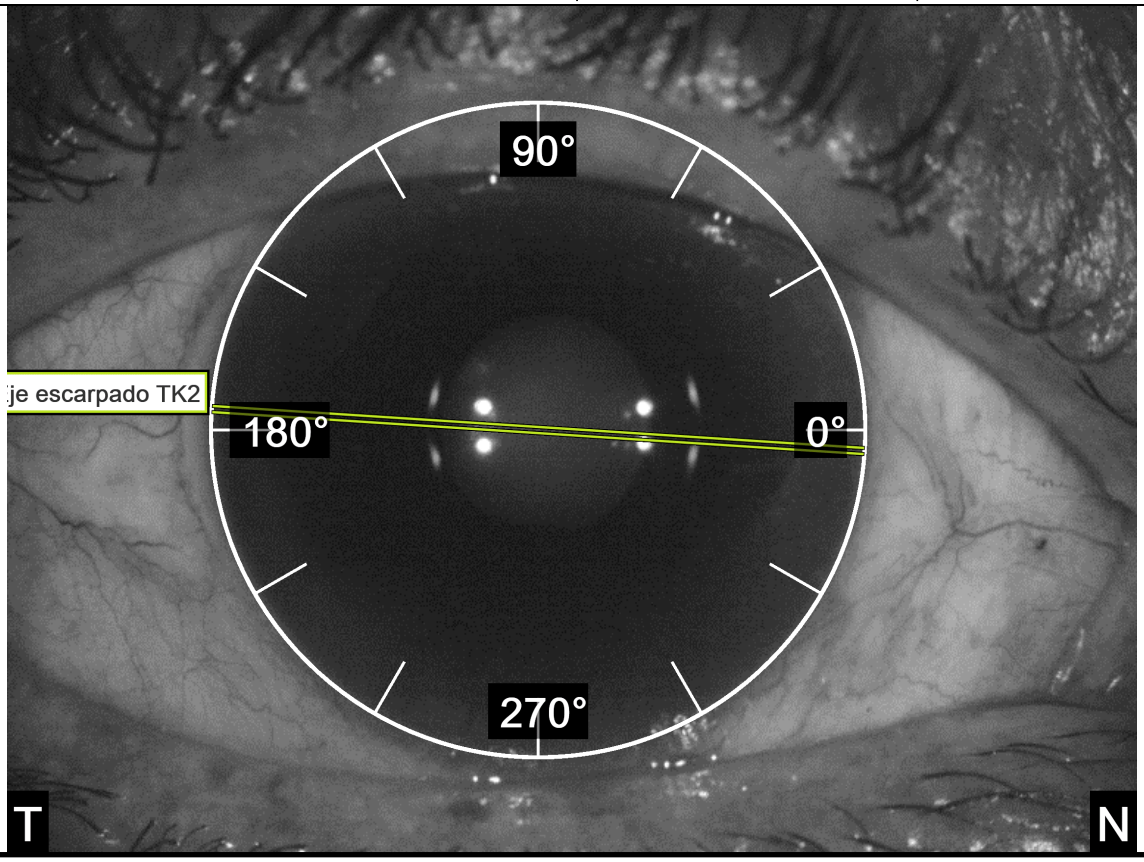

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	PECH ZUMARRAGA, MARTHA GUADALUPE		
Fecha de nacim.	14/ene./1957	Sexo	Femenino
ID del paciente	1572		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	14/abr./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	14/abr./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	22.54 mm			SE:	45.72 D	(!)	
ACD:	4.48 mm			K1:	45.20 D	@ 122°	
LT:	0.73 mm			K2:	46.26 D	@ 32°	
WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.2 mm	ΔK:	-1.06 D	@ 122°	
P:	3.8 mm	CW-chord:	0.6 mm @ 121°				

TSE:	---
TK1:	---
TK2:	---
ΔTK:	---

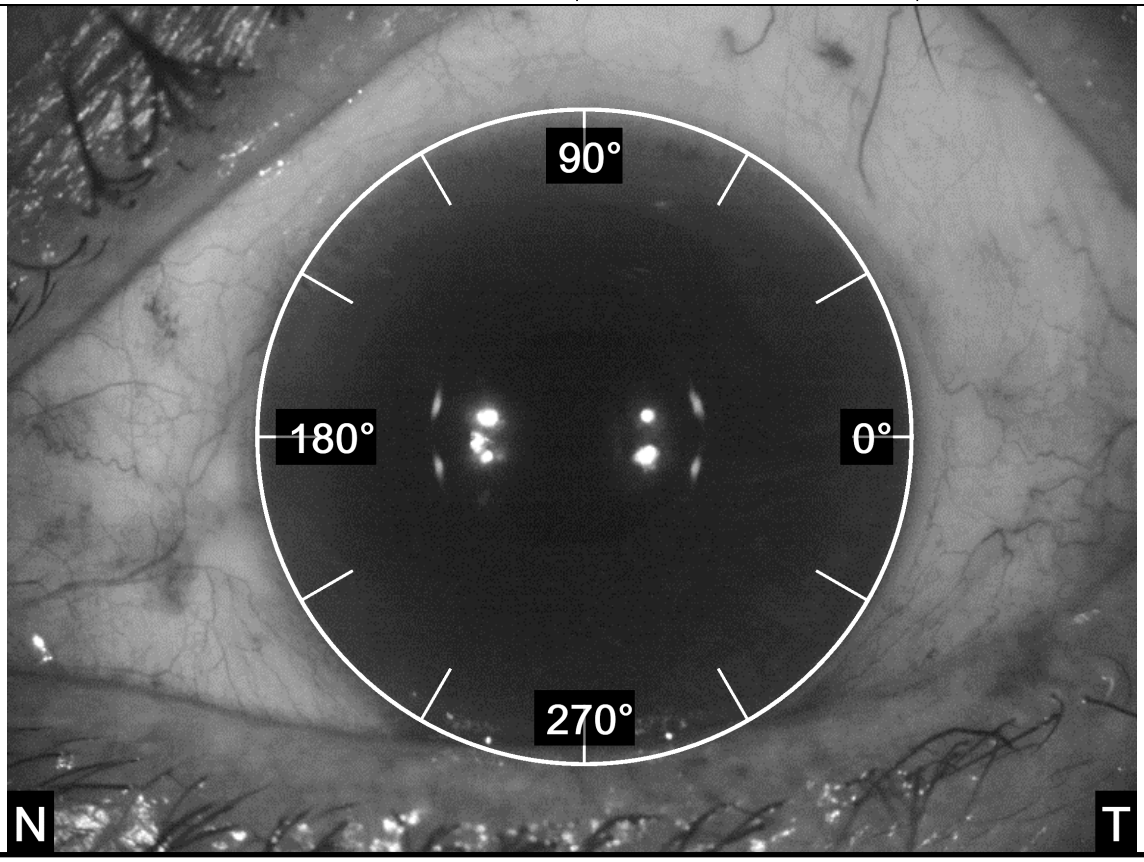

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,PSEUDOFAQUIA OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved