CÁLCULO DE IOL

Paciente	**NAJERA LOPEZ, BEATRIZ**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	28/abr./1953		
Sexo	Femenino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	8070		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **19/nov./2025** Fecha verif. calibración: **19/nov./2025**de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho					OS izquierdo				
LS	Fáquica		LVC	RK	LS	Fáquica		LVC	RK
VS	Humor vítreo		Modo LVC	Miope	VS	Humor vítreo		Modo LVC	Miope
Refr. dest.	**+0.00 D**		SIA 0.35 D	Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**		SIA 0.35 D	Inc 135°

(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**24.83 mm**		WTW	11.8 mm		**AL**	**24.66 mm**		WTW	11.9 mm	
ACD	3.39 mm		Pupila	2.8 mm		ACD	3.38 mm		Pupila	3.1 mm	
LT	4.30 mm		Ix / Iy	+0.2 mm	/+0.4 mm	LT	4.35 mm		Ix / Iy	-0.3 mm	/+0.5 mm
CCT	573 µm		Kappa	0.2 mm	@ 264°	CCT	571 µm		Kappa	0.2 mm	@ 274°
Ast. K	**-0.79 D**	**@ 169°**	**Ast. TK**	**-0.71 D**	**@ 163°**	**Ast. K**	**-1.74 D**	**@ 180°**	**Ast. TK**	**-1.62 D**	**@ 0°**
Avg. K	40.50 D		Avg. TK	40.35 D		Avg. K	40.57 D		Avg. TK	40.46 D	
K1	40.11 D	@ 169°	TK1	40.00 D	@ 163°	K1	39.72 D	@ 180°	TK1	39.67 D	@ 0°
K2	40.90 D	@ 79°	TK2	40.70 D	@ 73°	K2	41.46 D	@ 90°	TK2	41.28 D	@ 90°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+21.00	-0.62
+20.50	-0.24
+20.00	**+0.13**
+19.50	+0.50
+20.18	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.00	-0.61
+21.50	-0.24
+21.00	**+0.11**
+20.50	+0.47
+21.16	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.00	-0.54
+21.50	-0.18
+21.00	**+0.18**
+20.50	+0.53
+21.25	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT ASPHINA 509MP

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+21.50	-0.69
+21.00	-0.31
+20.50	**+0.06**
+20.00	+0.43
+20.58	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.66
+22.00	-0.30
+21.50	**+0.06**
+21.00	+0.42
+21.59	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.59
+22.00	-0.23
+21.50	**+0.13**
+21.00	+0.48
+21.68	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT LUCIA 221P

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.67
+22.50	-0.32
+22.00	**+0.03**
+21.50	+0.37
+22.04	0.00

LF +2.30 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.65
+22.00	-0.29
+21.50	**+0.06**
+21.00	+0.41
+21.59	0.00

LF +2.06 DF +5.0

enVista

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.82
+22.00	-0.46
+21.50	**-0.10**
+21.00	+0.25
+21.36	0.00

LF +1.94 DF +0.0

CT LUCIA 221P

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+23.50	-0.71
+23.00	-0.36
+22.50	**-0.01**
+22.00	+0.34
+22.49	0.00

LF +2.30 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.70
+22.50	-0.34
+22.00	**+0.01**
+21.50	+0.36
+22.02	0.00

LF +2.06 DF +5.0

enVista

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.87
+22.50	-0.51
+22.00	**-0.15**
+21.50	+0.21
+21.79	0.00

LF +1.94 DF +0.0

Micro F

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.00	-0.67
+21.50	-0.31
+21.00	**+0.05**
+20.50	+0.40
+21.07	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.00	-0.89
+21.50	-0.52
+21.00	**-0.16**
+20.50	+0.20
+20.78	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.61
+22.00	-0.25
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.44
+21.64	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Micro F

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.73
+22.00	-0.37
+21.50	**+0.00**
+21.00	+0.35
+21.50	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.00	-0.58
+21.50	-0.22
+21.00	**+0.15**
+20.50	+0.50
+21.20	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.65
+22.50	-0.30
+22.00	**+0.05**
+21.50	+0.40
+22.08	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**NAJERA LOPEZ, BEATRIZ**
Fecha de nacimie...	28/abr./1953
Sexo	Femenino
ID paciente	8070
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **19/nov./2025** Fecha verif. calibración: **19/nov./2025**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

AcrySof IQ Vivity DFT0
15

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+22.50	-0.83
+22.00	-0.47
+21.50	**-0.11**
+21.00	+0.24
+21.34	0.00

LF +1.93 DF +5.0

AcrySof IQ Vivity DFT0
15

Barrett True-K | K

IOL	Res. SE
+23.00	-0.88
+22.50	-0.52
+22.00	**-0.16**
+21.50	+0.19
+21.77	0.00

LF +1.93 DF +5.0

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**NAJERA LOPEZ, BEATRIZ**
Fecha de nacimie...	28/abr./1953
Sexo	Femenino
ID paciente	8070
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **19/nov./2025** Fecha verif. calibración: **19/nov./2025**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! [OD] Únicamente válido para tratamientos RK de miopía.
OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.
[OS] Únicamente válido para tratamientos RK de miopía.
OS:Las mediciones de longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	RK	LS	Fáquica	LVC	RK
VS	Humor vítreo	Modo LVC	Miope	VS	Humor vítreo	Modo LVC	Miope
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

OD					OS				
AL	**24.83 mm**	SD 6 µm	WTW	11.8 mm	**AL**	**24.66 mm**	SD 11 µm	WTW	11.9 mm
ACD	3.39 mm	SD 7 µm	Pupila	2.8 mm	ACD	3.38 mm	SD 7 µm	Pupila	3.1 mm
LT	4.30 mm	SD 10 µm	Ix / Iy	+0.2 mm / +0.4 mm	LT	4.35 mm	SD 12 µm	Ix / Iy	-0.3 mm / +0.5 mm
CCT	573 µm	SD 4 µm	Kappa	0.2 mm @ 264 °	CCT	571 µm	SD 4 µm	Kappa	0.2 mm @ 274 °


OD				OS			
Ast. K	**-0.79 D**	**@ 169°**		**Ast. K**	**-1.74 D**	**@ 180°**	
Avg. K	40.50 D		SD 0.01 D	Avg. K	40.57 D		SD 0.01 D
K1	40.11 D	@ 169°	SD 0.01 D	K1	39.72 D	@ 180°	SD 0.03 D
K2	40.90 D	@ 79°	SD 0.01 D	K2	41.46 D	@ 90°	SD 0.02 D
Ast. TK	**-0.71 D**	**@ 163°**		**Ast. TK**	**-1.62 D**	**@ 0°**	
Avg. TK	40.35 D		SD 0.01 D	Avg. TK	40.46 D		SD 0.07 D
TK1	40.00 D	@ 163°	SD 0.07 D	TK1	39.67 D	@ 0°	SD 0.02 D
TK2	40.70 D	@ 73°	SD 0.06 D	TK2	41.28 D	@ 90°	SD 0.12 D

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

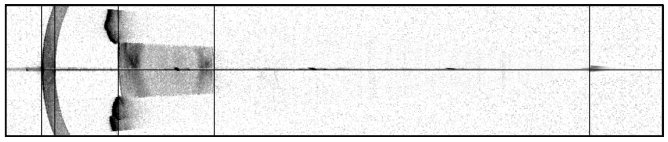


TOTAL AXIAL POWER

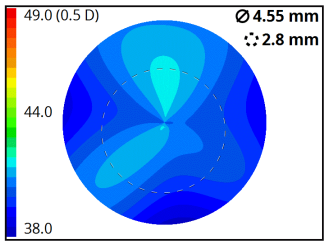


Ast. TK
-0.71 D @ 163°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA

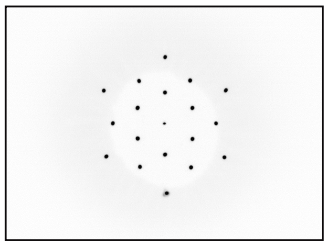


BLANCO-A-BLANCO

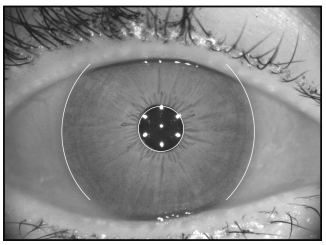

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA

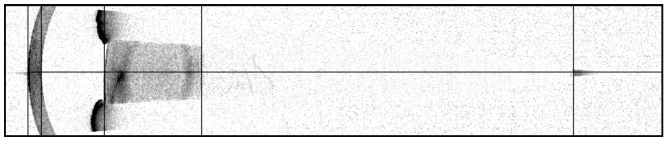


TOTAL AXIAL POWER

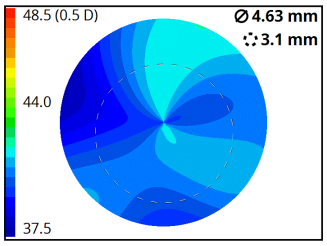


Ast. TK
-1.62 D @ 0°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA

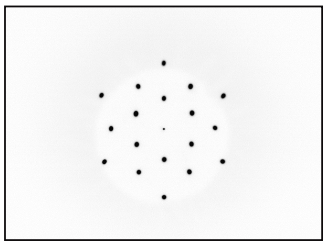

BLANCO-A-BLANCO

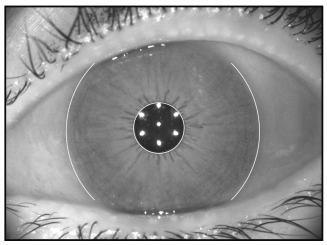

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración: 19/nov./2025 de: Surgeon Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 19/nov./2025 n: 1.3375 CVD: 12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Fáquica	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: RK	Modo LVC: Miope	LVC: RK	Modo LVC: Miope
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD				OS			
AL: 24.83 mm	SD: 6 µm			AL: 24.66 mm	SD: 11 µm		
ACD: 3.39 mm	SD: 7 µm			ACD: 3.38 mm	SD: 7 µm		
LT: 4.30 mm	SD: 10 µm			LT: 4.35 mm	SD: 12 µm		
WTW: 11.8 mm				WTW: 11.9 mm			
SE: 40.50 D	SD: 0.01 D	K1: 40.11 D	@169°	SE: 40.57 D	SD: 0.01 D	K1: 39.72 D	@180°
ΔK: -0.79 D	@169°	K2: 40.90 D	@ 79°	ΔK: -1.74 D	@180°	K2: 41.46 D	@ 90°
TSE: 40.35 D	SD: 0.01 D	TK1: 40.00 D	@163°	TSE: 40.46 D	SD: 0.07 D	TK1: 39.67 D	@ 0°
ΔTK: -0.71 D	@163°	TK2: 40.70 D	@ 73°	ΔTK: -1.62 D	@ 0°	TK2: 41.28 D	@ 90°

K ZEISS CT ASPHINA 509MP — OD

- Barrett True-K -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.62
+20.50	-0.24
+20.00	**+0.13**
+19.50	+0.50
+19.00	+0.86
+20.18	Emetropía

K ZEISS AT LISA tri 839MP — OD

- Barrett True-K -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.61
+21.50	-0.24
+21.00	**+0.11**
+20.50	+0.47
+20.00	+0.81
+21.16	Emetropía

K ZEISS CT ASPHINA 509MP — OS

- Barrett True-K -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.69
+21.00	-0.31
+20.50	**+0.06**
+20.00	+0.43
+19.50	+0.79
+20.58	Emetropía

K ZEISS AT LISA tri 839MP — OS

- Barrett True-K -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.66
+22.00	-0.30
+21.50	**+0.06**
+21.00	+0.42
+20.50	+0.77
+21.59	Emetropía

K Alcon AcrySof SN60WF — OD

- Barrett True-K -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.54
+21.50	-0.18
+21.00	**+0.18**
+20.50	+0.53
+20.00	+0.87
+21.25	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 221P — OD

- Barrett True-K -
LF: +2.30 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.67
+22.50	-0.32
+22.00	**+0.03**
+21.50	+0.37
+21.00	+0.71
+22.04	Emetropía

K Alcon AcrySof SN60WF — OS

- Barrett True-K -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.59
+22.00	-0.23
+21.50	**+0.13**
+21.00	+0.48
+20.50	+0.83
+21.68	Emetropía

K ZEISS CT LUCIA 221P — OS

- Barrett True-K -
LF: +2.30 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.71
+23.00	-0.36
+22.50	**-0.01**
+22.00	+0.34
+21.50	+0.67
+22.49	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Fáquica	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: RK	Modo LVC: Miope	LVC: RK	Modo LVC: Miope
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD				OS			
AL: 24.83 mm	SD: 6 µm			AL: 24.66 mm	SD: 11 µm		
ACD: 3.39 mm	SD: 7 µm			ACD: 3.38 mm	SD: 7 µm		
LT: 4.30 mm	SD: 10 µm			LT: 4.35 mm	SD: 12 µm		
WTW: 11.8 mm				WTW: 11.9 mm			
SE: 40.50 D	SD: 0.01 D	K1: 40.11 D	@169°	SE: 40.57 D	SD: 0.01 D	K1: 39.72 D	@180°
ΔK: -0.79 D	@169°	K2: 40.90 D	@ 79°	ΔK: -1.74 D	@180°	K2: 41.46 D	@ 90°
TSE: 40.35 D	SD: 0.01 D	TK1: 40.00 D	@163°	TSE: 40.46 D	SD: 0.07 D	TK1: 39.67 D	@ 0°
ΔTK: -0.71 D	@163°	TK2: 40.70 D	@ 73°	ΔTK: -1.62 D	@ 0°	TK2: 41.28 D	@ 90°

K Alcon Clareon CNA0T0 — OD

- Barrett True-K -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.65
+22.00	-0.29
+21.50	**+0.06**
+21.00	+0.41
+20.50	+0.75
+21.59	Emetropía

K Bausch + Lomb enVista — OD

- Barrett True-K -
LF: +1.94 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.82
+22.00	-0.46
+21.50	**-0.10**
+21.00	+0.25
+20.50	+0.60
+21.36	Emetropía

K Alcon Clareon CNA0T0 — OS

- Barrett True-K -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.70
+22.50	-0.34
+22.00	**+0.01**
+21.50	+0.36
+21.00	+0.71
+22.02	Emetropía

K Bausch + Lomb enVista — OS

- Barrett True-K -
LF: +1.94 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.87
+22.50	-0.51
+22.00	**-0.15**
+21.50	+0.21
+21.00	+0.56
+21.79	Emetropía

K PhysIOL Micro F — OD

- Barrett True-K -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.67
+21.50	-0.31
+21.00	**+0.05**
+20.50	+0.40
+20.00	+0.75
+21.07	Emetropía

K HOYA 250 — OD

- Barrett True-K -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.89
+21.50	-0.52
+21.00	**-0.16**
+20.50	+0.20
+20.00	+0.56
+20.78	Emetropía

K PhysIOL Micro F — OS

- Barrett True-K -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.73
+22.00	-0.37
+21.50	**+0.00**
+21.00	+0.35
+20.50	+0.70
+21.50	Emetropía

K HOYA 250 — OS

- Barrett True-K -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.58
+21.50	-0.22
+21.00	**+0.15**
+20.50	+0.50
+20.00	+0.86
+21.20	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	RK	Modo LVC:	Miope
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	24.83 mm	SD:	6 µm				
ACD:	3.39 mm	SD:	7 µm				
LT:	4.30 mm	SD:	10 µm				
WTW:	11.8 mm						
SE:	40.50 D	SD:	0.01 D	K1:	40.11 D	@	169°
ΔK:	-0.79 D	@	169°	K2:	40.90 D	@	79°
TSE:	40.35 D	SD:	0.01 D	TK1:	40.00 D	@	163°
ΔTK:	-0.71 D	@	163°	TK2:	40.70 D	@	73°

K PhysIOL ISOPURE 123

- Barrett True-K -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.61
+22.00	-0.25
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.44
+20.50	+0.79
+21.64	Emetropía

K Alcon AcrySof IQ Vivity DFT01 5

- Barrett True-K -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.83
+22.00	-0.47
+21.50	**-0.11**
+21.00	+0.24
+20.50	+0.59
+21.34	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	RK	Modo LVC:	Miope
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	24.66 mm	SD:	11 µm				
ACD:	3.38 mm	SD:	7 µm				
LT:	4.35 mm	SD:	12 µm				
WTW:	11.9 mm						
SE:	40.57 D	SD:	0.01 D	K1:	39.72 D	@	180°
ΔK:	-1.74 D	@	180°	K2:	41.46 D	@	90°
TSE:	40.46 D	SD:	0.07 D	TK1:	39.67 D	@	0°
ΔTK:	-1.62 D	@	0°	TK2:	41.28 D	@	90°

K PhysIOL ISOPURE 123

- Barrett True-K -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.65
+22.50	-0.30
+22.00	**+0.05**
+21.50	+0.40
+21.00	+0.75
+22.08	Emetropía

K Alcon AcrySof IQ Vivity DFT01 5

- Barrett True-K -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.88
+22.50	-0.52
+22.00	**-0.16**
+21.50	+0.19
+21.00	+0.54
+21.77	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho — Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	RK
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	24.83 mm	SD:	6 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	+0.2 mm
CCT:	573 µm	SD:	4 µm	P:	2.8 mm	Iy:	+0.4 mm
ACD:	3.39 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.2 mm @ 264°
LT:	4.30 mm	SD:	10 µm				

SE:	40.50 D		SD:	0.01 D	TSE:	40.35 D		SD: 0.01 D
K1:	40.11 D	@ 169°	SD:	0.01 D	TK1:	40.00 D	@ 163°	SD: 0.07 D
K2:	40.90 D	@ 79°	SD:	0.01 D	TK2:	40.70 D	@ 73°	SD: 0.06 D
ΔK:	-0.79 D	@ 169°			ΔTK:	-0.71 D	@ 163°	

Scan B — Fijación

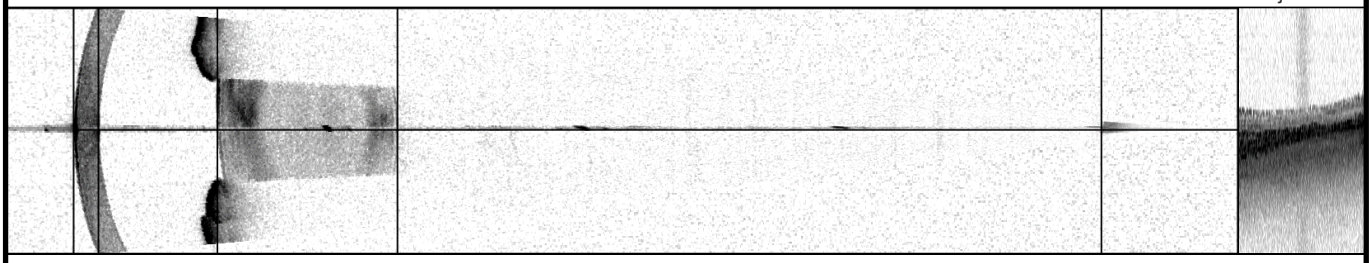

Total Axial Power — Queratometría — Blanco a blanco

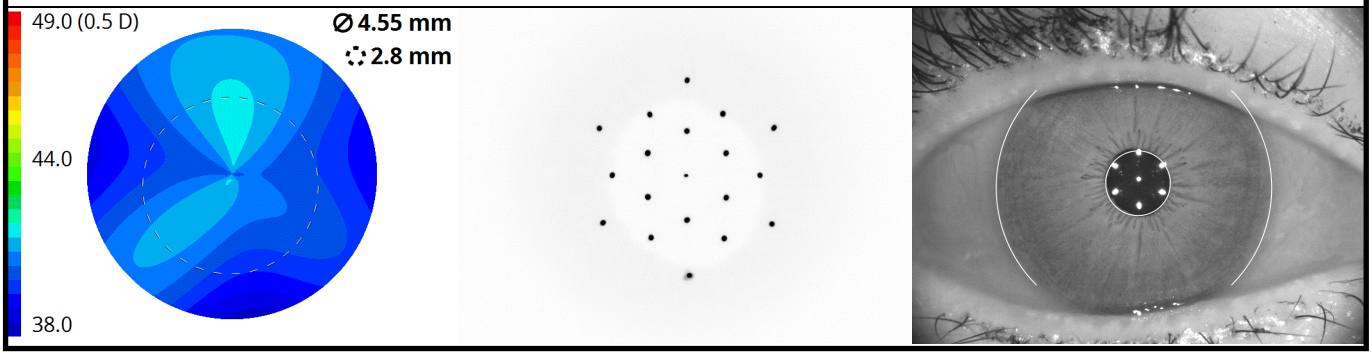

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS:Las mediciones de longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	RK
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	24.66 mm	SD:	11 µm	WTW:	11.9 mm	Ix:	-0.3 mm
CCT:	571 µm	SD:	4 µm	P:	3.1 mm	Iy:	+0.5 mm
ACD:	3.38 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.2 mm @ 274°
LT:	4.35 mm	SD:	12 µm				


SE:	40.57 D			SD:	0.01 D	TSE:	40.46 D			SD:	0.07 D
K1:	39.72 D	@	180°	SD:	0.03 D	TK1:	39.67 D	@	0°	SD:	0.02 D
K2:	41.46 D	@	90°	SD:	0.02 D	TK2:	41.28 D	@	90°	SD:	0.12 D
ΔK:	-1.74 D	@	180°			ΔTK:	-1.62 D	@	0°		


Scan B — Fijación

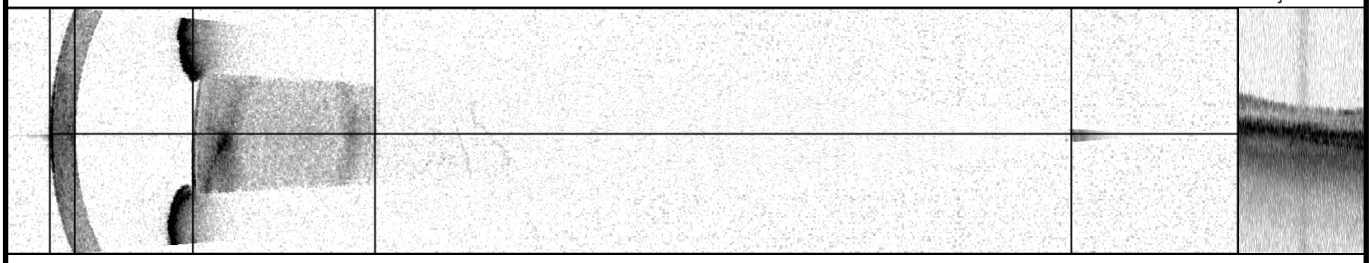

Total Axial Power — Queratometría — Blanco a blanco

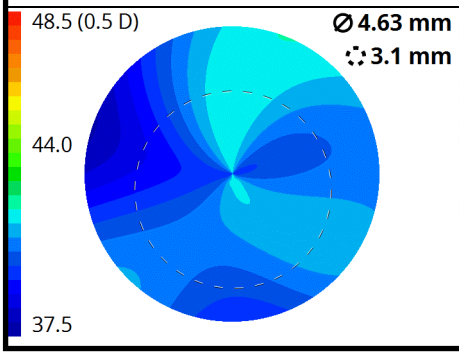

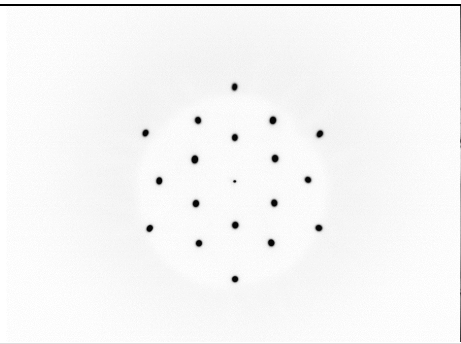

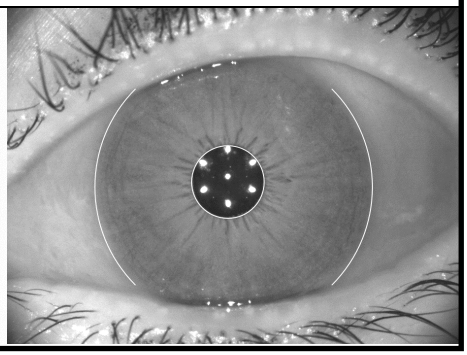

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.
OS:Las mediciones de longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: RK	LVC: RK
Valores biométricos	
AL: **24.83** mm	AL: **24.66** mm
SD: 6 µm	SD: 11 µm
CCT: **573** µm	CCT: **571** µm
SD: 4 µm	SD: 4 µm
ACD: **3.39** mm	ACD: **3.38** mm
SD: 7 µm	SD: 7 µm
LT: **4.30** mm	LT: **4.35** mm
SD: 10 µm	SD: 12 µm

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
24.82 mm	575 µm	3.40 mm	4.29 mm	24.66 mm	575 µm	3.37 mm	4.35 mm
24.83 mm	574 µm	3.40 mm	4.29 mm	24.66 mm	570 µm	3.37 mm	4.35 mm
24.83 mm	567 µm	3.39 mm	4.30 mm	24.66 mm	568 µm	3.38 mm	4.36 mm
24.83 mm	573 µm	3.39 mm	4.32 mm	24.65 mm	568 µm	3.39 mm	4.35 mm
24.83 mm	577 µm	3.39 mm	4.31 mm	24.66 mm	574 µm	3.39 mm	4.35 mm
24.83 mm	575 µm	3.39 mm	4.30 mm	24.66 mm	571 µm	3.38 mm	4.33 mm

OD	OS
Valores de la córnea	
SE: **40.50** D	SE: **40.57** D
K1: **40.11** D @ **169**°	SD: 0.01 D
SD: 0.01 D	K1: **39.72** D @ **180**°
K2: **40.90** D @ **79**°	SD: 0.03 D
SD: 0.01 D	K2: **41.46** D @ **90**°
ΔK: **-0.79** D @ **169**°	SD: 0.02 D
	ΔK: **-1.74** D @ **180**°
SE: 40.49 D ΔK: -0.80 D @ 169°	SE: 40.57 D ΔK: -1.77 D @ 179°
SE: 40.50 D ΔK: -0.79 D @ 168°	SE: 40.57 D ΔK: -1.73 D @ 180°
SE: 40.51 D ΔK: -0.79 D @ 169°	SE: 40.58 D ΔK: -1.71 D @ 180°
TSE: **40.35** D	TSE: **40.46** D
SD: 0.01 D	SD: 0.07 D
TK1: **40.00** D @ **163**°	TK1: **39.67** D @ **0**°
SD: 0.07 D	SD: 0.02 D
TK2: **40.70** D @ **73**°	TK2: **41.28** D @ **90**°
SD: 0.06 D	SD: 0.12 D
ΔTK: **-0.71** D @ **163**°	ΔTK: **-1.62** D @ **0**°
TSE: 40.35 D ΔTK: -0.75 D @ 164°	TSE: 40.50 D ΔTK: -1.71 D @ 179°
TSE: 40.34 D ΔTK: -0.82 D @ 165°	TSE: 40.38 D ΔTK: -1.49 D @ 1°
TSE: 40.35 D ΔTK: -0.56 D @ 160°	TSE: 40.50 D ΔTK: -1.64 D @ 180°
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 11.8 mm Ix: +0.2 mm Iy: +0.4 mm	WTW: 11.9 mm Ix: -0.3 mm Iy: +0.5 mm
P: 2.8 mm CW-chord: 0.2 mm @ 264°	P: 3.1 mm CW-chord: 0.2 mm @ 274°
Se ha guardado la imagen	Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	RK
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	24.83 mm			SE:	40.50 D		
ACD:	3.39 mm			K1:	40.11 D	@	169°
LT:	4.30 mm			K2:	40.90 D	@	79°
WTW:	11.8 mm	Ix:	+0.2 mm	ΔK:	-0.79 D	@	169°
P:	2.8 mm	Iy:	+0.4 mm				
		CW-chord:	0.2 mm @ 264°				

TSE:	40.35 D		
TK1:	40.00 D	@	163°
TK2:	40.70 D	@	73°
ΔTK:	-0.71 D	@	163°

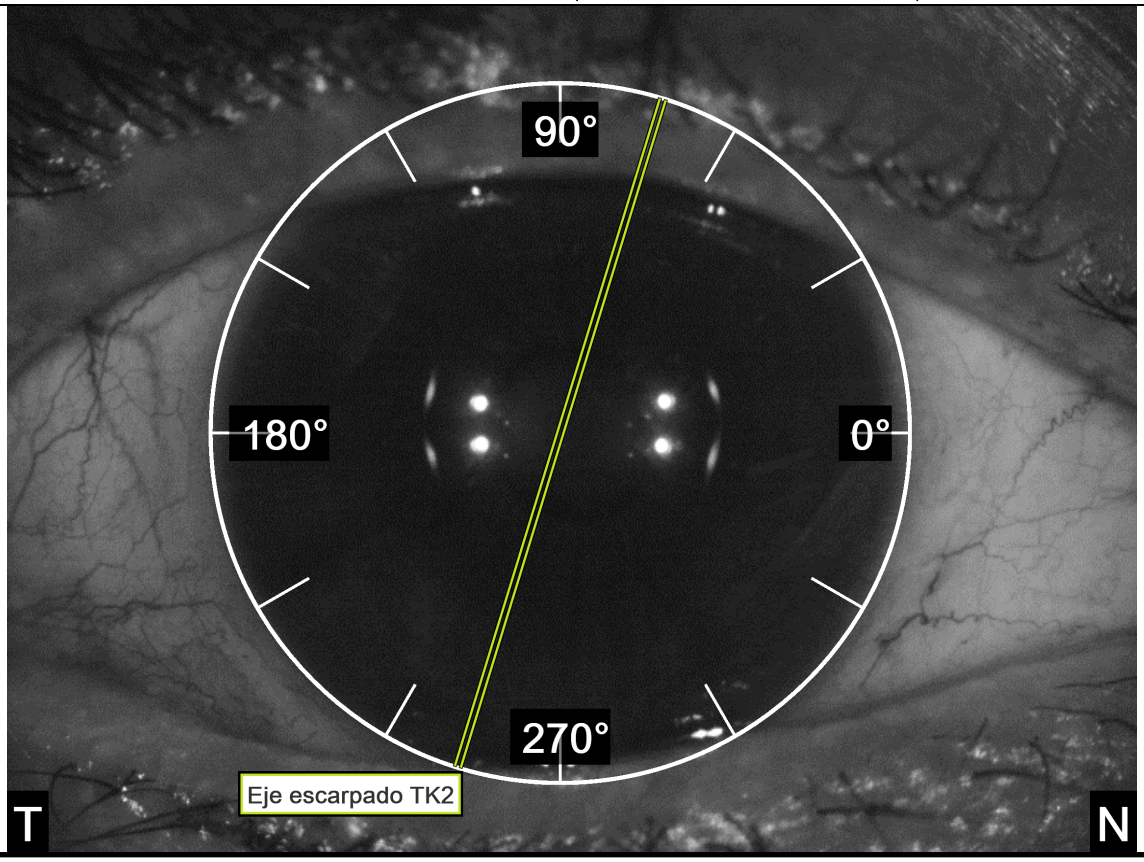

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS:Las mediciones de longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	RK
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	24.66 mm			SE:	40.57 D		
ACD:	3.38 mm			K1:	39.72 D	@	180°
LT:	4.35 mm			K2:	41.46 D	@	90°
WTW:	11.9 mm	Ix:	-0.3 mm	ΔK:	-1.74 D	@	180°
P:	3.1 mm	Iy:	+0.5 mm				
		CW-chord:	0.2 mm @ 274°				

TSE:	40.46 D		
TK1:	39.67 D	@	0°
TK2:	41.28 D	@	90°
ΔTK:	-1.62 D	@	0°

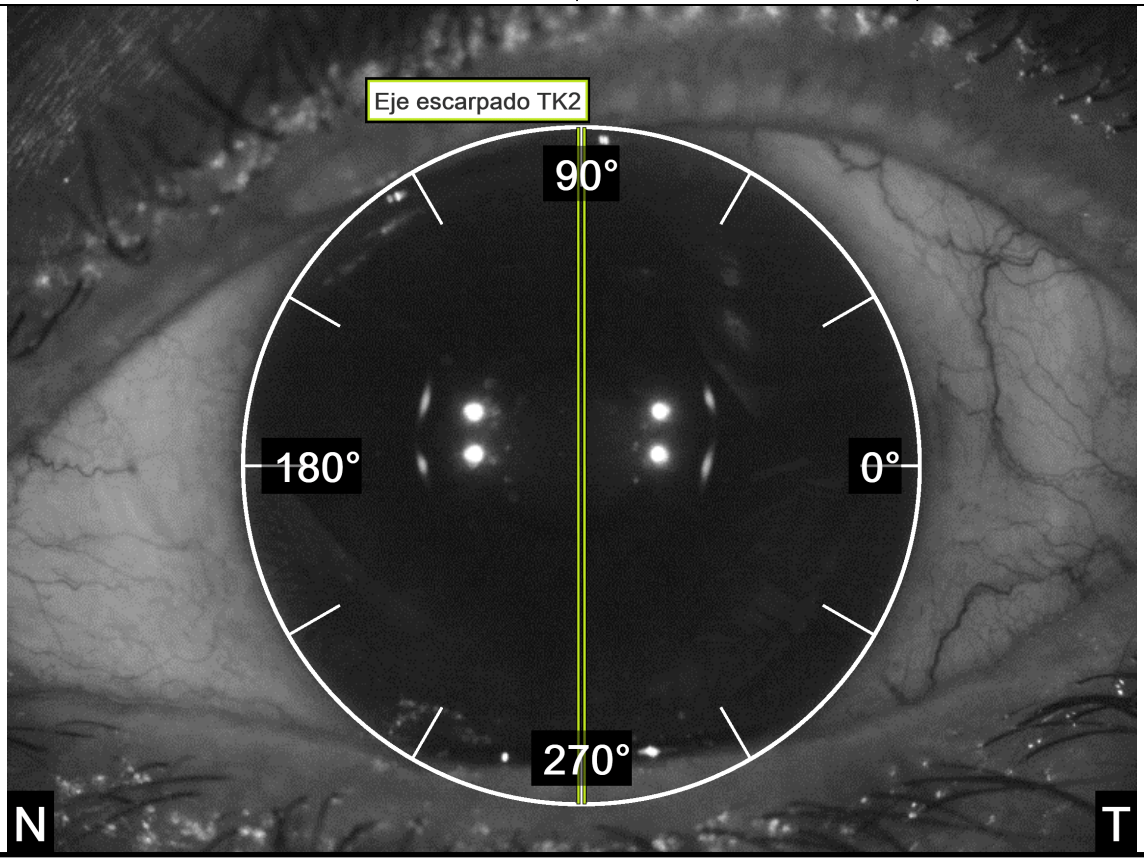

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	NAJERA LOPEZ, BEATRIZ		
Fecha de nacim.	28/abr./1953	Sexo	Femenino
ID del paciente	8070		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	19/nov./2025	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	19/nov./2025	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

Barrett Suite

[OD]

Únicamente válido para tratamientos RK de miopía.

[OS]

Únicamente válido para tratamientos RK de miopía.

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Las mediciones de la longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

[OS]

OS:Las mediciones de longitud axial muestran una ligera inconsistencia. Sírvase verificar la fijación.

Comentarios

ID.CATARATA,POST-QR,DM.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved